

Informações técnicas

Prosonic S FDU91

Tecnologia de medição ultrassônica



Sensor ultrassônico para medição de nível e vazão

Aplicação

- Medição de nível contínua e sem contato de líquidos e sólidos a granel em silos, correias transportadoras, estoques de materiais e trituradores
- Medição de vazão em calhas abertas e açudes de medição
- Faixa máxima de medição: 10 m (33 ft) em líquidos; 5 m (16 ft) em sólidos

Seus benefícios

- Sensor de temperatura integrado para correções time-of-flight (tempo de voo), permitindo a medição precisa mesmo se a temperatura mudar
- Sensor de PVDF hermeticamente soldado para máxima resistência química
- Adequado para condições ambientes adversas graças à instalação separada do transmissor (até 300 m (984 ft))
- O efeito de autolimpeza garante incrustação mínima de depósitos
- Resistente às condições climáticas e à prova de inundações (IP68)
- Certificados internacionais Poeira-Ex e Gás-Ex disponíveis

Sumário

Informações importantes do documento	3	Informações para pedido	14
Convenções de documentos	3	Informações para pedido	14
Função e projeto do sistema	4	Protocolo de linearidade de 5 pontos	14
Medição de nível	4	Escopo de entrega	15
Medição de vazão em calhas ou açudes	4	Acessórios	15
Correção time-of-flight (tempo de voo) dependente da temperatura	5	Extensão de cabo do sensor	15
Entrada	5	Tampa de proteção contra tempo	15
Distância de bloqueio	5	Flange rosqueável FAX50	15
Faixa de medição	5	Braço cantilever para sensores	16
Frequência operacional	6	Suporte de montagem para instalação no teto	19
Fonte de alimentação	6	Unidade de alinhamento FAU40	19
Fonte de alimentação	6	Unidade de fonte de alimentação RNB130 para o aquecedor do sensor	20
Fonte de alimentação ao aquecedor do sensor integrado	6	Invólucro protetor IP66 para unidade de fonte de alimentação RNB130	21
Conexão elétrica	6	Documentação adicional	21
Diagrama de conexão para sensor → FMU90	7	Documentação para transmissor FMU90	21
Diagrama de conexão para sensor → FMU95	7	Documentação para transmissor FMU95	21
Especificações do cabo de extensão	7	Outras documentações	21
Encurtamento do cabo do sensor	8		
Instalação	8		
Condições de instalação para medição de nível contínuo	8		
Condições de instalação para medição de vazão	9		
Opções de instalação (exemplos)	10		
Montagem do bocal	10		
Tubo guia de ultrassom para medições em poços estreitos	11		
Fixação do sensor	11		
Ambiente	11		
Grau de proteção	11		
Resistência contra vibração	11		
Temperatura de armazenamento	11		
Resistência a choque térmico	11		
Compatibilidade eletromagnética	11		
Processo	12		
Temperatura do processo	12		
Pressão de processo	12		
Construção mecânica	12		
Dimensões	12		
Dimensões da contraporca G1"	12		
Peso	12		
Materiais	13		
Materiais do cabo de conexão	13		
Material da contraporca G1"	13		
Certificados e aprovações	13		
Identificação CE	13		
RoHS	13		
Selo de verificação RCM	13		
Aprovação Ex	13		
Outras normas e diretrizes	13		

Informações importantes do documento

Convenções de documentos

Símbolos de segurança

 **PERIGO**

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.

 **ATENÇÃO**

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.

 **CUIDADO**

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.

 **AVISO**

Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

Símbolos elétricos



Conexão de aterramento

Um terminal aterrado que, pelo conhecimento do operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.

Símbolos da ferramenta



Chave de boca

Símbolos para determinados tipos de informação e gráficos

 **Permitido**

Procedimentos, processos ou ações que são permitidos

 **Proibido**

Procedimentos, processos ou ações que são proibidos

 **Dica**

Indica informação adicional



Consulte a documentação

 **1, 2, 3**

Série de etapas

 **1, 2, 3, ...**


Números de itens

 **A, B, C, ...**

Visualizações

Função e projeto do sistema

Medição de nível

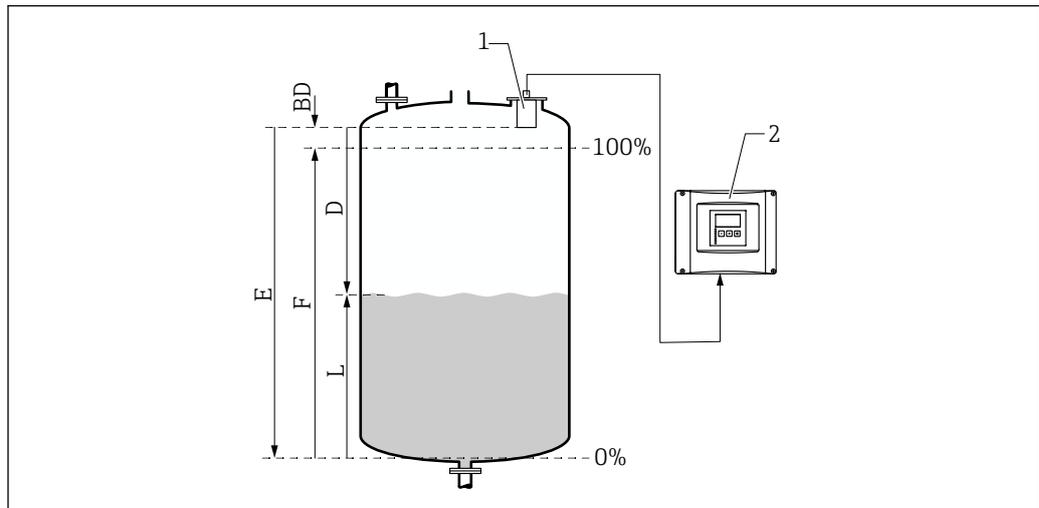

A0034882


- 1 Prosonic S sensor
- 2 Prosonic S transmissor
- BD Distância de bloqueio
- D Distância entre o ponto de referência (membrana do sensor) e superfície do meio
- E Distância vazia
- F Span
- L Nível

O sensor transmite pulsos ultrassônicos na direção da superfície do meio. Ali, eles são refletidos e recebidos novamente pelo sensor. O transmissor mede o tempo t entre a transmissão e a recepção de um pulso. A partir desse tempo, e usando a velocidade sônica c , o transmissor calcula a distância D entre o ponto de referência (membrana do sensor) e a superfície do meio:

$$D = c \cdot t / 2$$

O nível L é derivado de D . Com a linearização, o volume V ou a massa M são derivados de L .

Medição de vazão em calhas ou açudes

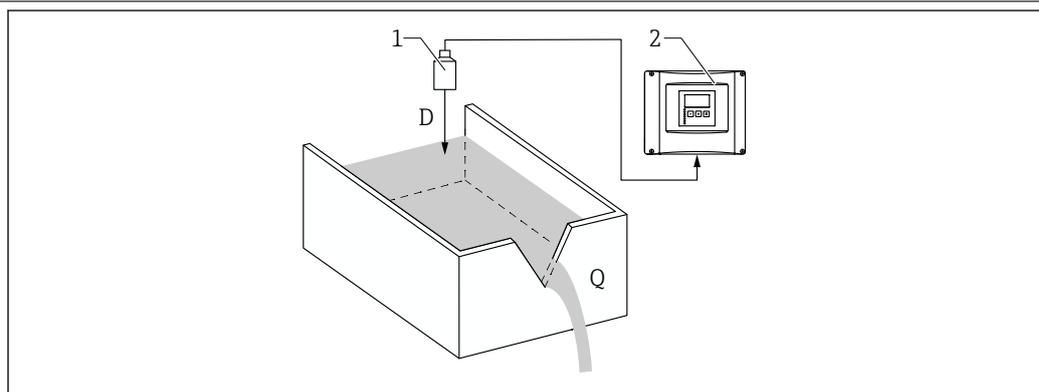

A0035219

- 1 Prosonic S sensor
- 2 Prosonic S transmissor
- D Distância entre a membrana do sensor e a superfície do líquido
- Q Vazão

O sensor transmite pulsos ultrassônicos na direção da superfície do líquido. Ali, eles são refletidos e recebidos novamente pelo sensor. O transmissor mede o tempo t entre a transmissão e a recepção de um pulso. A partir desse tempo, e usando a velocidade sônica c , o transmissor calcula a distância D entre o ponto de referência (membrana do sensor) e a superfície do líquido:

$$D = c \cdot t / 2$$

O nível L é derivado de D . Com a linearização, a vazão Q é derivada de L .


Correção time-of-flight (tempo de voo) dependente da temperatura

Correção time-of-flight (tempo de voo) dependente da temperatura através de sensor de temperatura externo, a ser conectado ao transmissor FMU90.

Entrada

Distância de bloqueio

Sinais dentro da faixa da distância de bloqueio (BD) não podem ser medidos devido à resposta transiente do sensor.



1 Distância de bloqueio do sensor ultrassônico. Unidade de engenharia m (pés)

1 Ponto de referência (membrana do sensor) da medição

Faixa de medição

Estimativa da faixa efetiva do sensor dependendo das condições de operação

1. Some todos os valores de atenuação aplicáveis das listas a seguir.
2. A partir da atenuação total calculada, use o gráfico de alcance abaixo para calcular a faixa do sensor.

Atenuação causada por uma superfície de líquido

- Superfície calma: 0 dB
- Ondas na superfície: 5 para 10 dB
- Superfície muito turbulenta: 10 para 20 dB
- Superfície espumosa: entre em contato com a Endress+Hauser: <http://www.endress.com/contact>

Atenuação devido a superfície de sólidos a granel

- Superfície rígida e irregular (por ex. entulho): 40 dB
- Superfície macia (por ex. turfa, clínquer coberto por poeira): 40 para 60 dB

Atenuação devido à poeira


- Sem formação de poeira: 0 dB
- Pequena formação de poeira: 5 dB
- Formação significativa de poeira: 5 para 20 dB

Atenuação causada por cortina de enchimento na faixa de detecção

- Sem cortina de enchimento: 0 dB
- Pequenos volumes: 5 dB
- Grandes volumes: 5 para 20 dB

Atenuação causada por diferenças de temperatura entre o sensor e a superfície do produto

- Até 20 °C (68 °F): 0 dB
- Até 40 °C (104 °F): 5 para 10 dB
- Até 80 °C (176 °F): 10 para 20 dB



A0039797

2 Gráfico de alcance para sensores ultrassônicos

A Atenuação total em dB

R Faixa em m (pés)

Frequência operacional 43 kHz

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação É fornecida pelo transmissor.

Fonte de alimentação ao aquecedor do sensor integrado

Versões do equipamento com aquecedor do sensor
FDU91-***B*

Dados de conexão

- Tensão de alimentação: $24 V_{DC} \pm 10\%$
- Ondulação residual: $< 100\text{ mV}$
- Consumo de corrente: 250 mA por sensor
- Unidade de fonte de alimentação adequada: RNB130 da Endress+Hauser



- Quando o aquecedor do sensor está ativo, o sensor de temperatura do sensor não pode ser usado. Use um dos seguintes sensores de temperatura externos como alternativa:
 - Pt100
 - Omnigrad S TR61 da Endress+Hauser
- Para informações sobre a conexão de sensores de temperatura externos, consulte as informações técnicas TI00397F.

Conexão elétrica

Informações gerais

AVISO

Sinais de interferência podem causar falhas


- ▶ Não posicione os cabos do sensor em paralelo a linhas de alta tensão elétrica ou perto de conversores de frequência.

AVISO

Blindagens de cabo danificadas podem causar falhas

- ▶ Para cabos pré-terminados: conecte o fio preto (blindagem) ao terminal "BK".
- ▶ Para cabos de extensão: torça a blindagem e conecte ao terminal "BK".


Diagrama de conexão para sensor → FMU90



3 Diagrama de conexão para sensor; YE: amarelo, BK: preto; RD: vermelho; BU: azul; BN: marrom; condutor protetor GNYE: verde/amarelo

- A Sem aquecedor de sensor
- B Com aquecedor de sensor
- 1 Blindagem do cabo do sensor
- 2 Caixa do terminal
- 3 Blindagem do cabo de extensão

Diagrama de conexão para sensor → FMU95

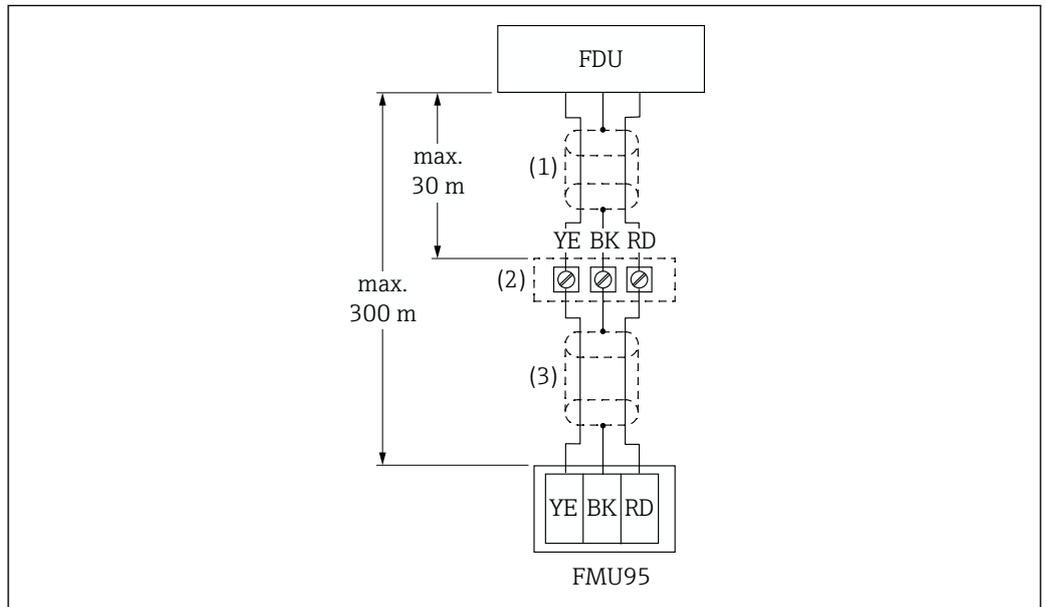

4 Diagrama de conexão para sensor; YE: amarelo, BK: preto; RD: vermelho; BU: azul; BN: marrom; condutor protetor GNYE: verde/amarelo

- 1 Blindagem do cabo do sensor
- 2 Caixa do terminal
- 3 Blindagem do cabo de extensão

Especificações do cabo de extensão

- Comprimento total máximo (cabo sensor + cabo de extensão)
300 m (984 ft)
- Número de fios
Conforme diagrama de conexão
- Blindagem
Uma trança de blindagem para o cabo YE e uma para o cabo RD (sem folha de blindagem)

- **Seção transversal**
0.75 para 2.5 mm² (18 para 14 AWG)
- **Resistência**
Máx. de 8 Ω por fio
- **Capacitância, fio para blindagem**
Máx. 60 nF


 Cabos de extensão adequados estão disponíveis na Endress+Hauser.

Encurtamento do cabo do sensor

O cabo do sensor pode ser encurtado se necessário (consulte as instruções de operação para o transmissor FMU95 ou FMU90).

Instalação

Condições de instalação para medição de nível contínuo



 5 Condições de instalação para medição de nível contínuo

- 1 Distância recomendada da parede do recipiente: 1/6 do diâmetro D do recipiente.
 - 2 Não instale no centro do recipiente.
 - 3 Evite medições através da cortina de enchimento.
 - 4 Não pode haver instalações internas no feixe do sinal.
 - 5 Instalações internas simétricas, em particular, impactam negativamente a medição.
 - 6 Para sólidos a granel: usando a unidade de alinhamento FAU40, alinhe o sensor de forma que ele esteja perpendicular à superfície do produto.
- BD Distância de bloqueio

Ângulo de emissão/feixe

- α (típico) = 9°
- L (máx.) = 10 m (33 ft)
- r (máx.) = 0.79 m (2.6 ft)

Outras condições

- A extremidade inferior do sensor deve estar localizada dentro do recipiente
- O nível máximo não pode penetrar a distância de bloqueio

Diversos sensores em um recipiente


Sensores conectados a um transmissor comum FMU90 ou FMU95 podem ser usados em um recipiente.

Condições de instalação para medição de vazão

Condições

- Instale o sensor do lado a montante acima do nível máximo a montante $H_{m\acute{a}x}$, mais a distância de bloqueio BD
- Posicione o sensor no centro do canal ou açude
- Alinhe o sensor perpendicularmente à superfície da água
- Observe a distância de montagem (folga) especificada para a restrição da calha ou borda do açude
Consulte as instruções de operação para o FMU90 / FMU95
- Proteja o sensor da luz solar e precipitação usando a tampa de proteção contra tempo


Exemplo: Calha Khafagi-Venturi



A0036744

- A Calha Khafagi-Venturi
- b_0 Largura da calha Khafagi-Venturi
- B Lado a montante
- C Lado a jusante
- BD Distância de bloqueio do sensor
- E Calibração vazão (a ser inserida durante o comissionamento)
- $H_{m\acute{a}x}$ Nível máximo a montante
- V Vazão


Exemplo: Açude Triangular



A0036745

- BD Distância de bloqueio do sensor
- E Calibração vazão (a ser inserida durante o comissionamento)
- $H_{m\acute{a}x}$ Nível máximo a montante


Opções de instalação (exemplos)



A0036747

6 Instalação em sistemas

- A Em trilho u ou suporte
 B Com unidade de alinhamento FAU40
 C Com luva de 1" soldada a uma grade

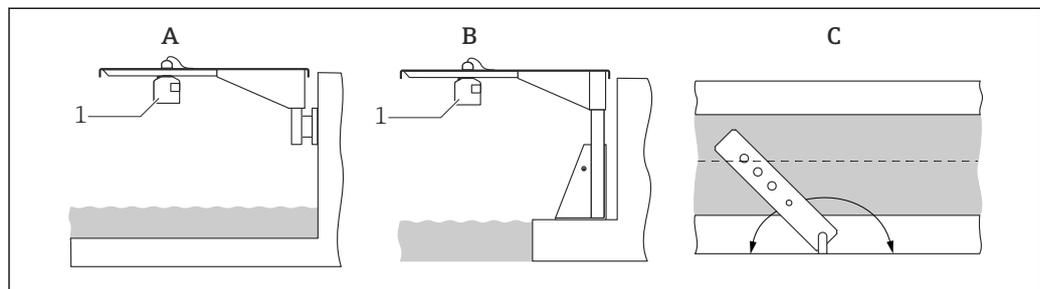


A0036748

7 Instalação com braço cantilever sobre canais ou calhas abertos

- A Braço com suporte da parede
 B Escora com estrutura de instalação
 C O braço pode ser girado (por ex. para posicionar o sensor sobre o centro do canal)

Montagem do bocal

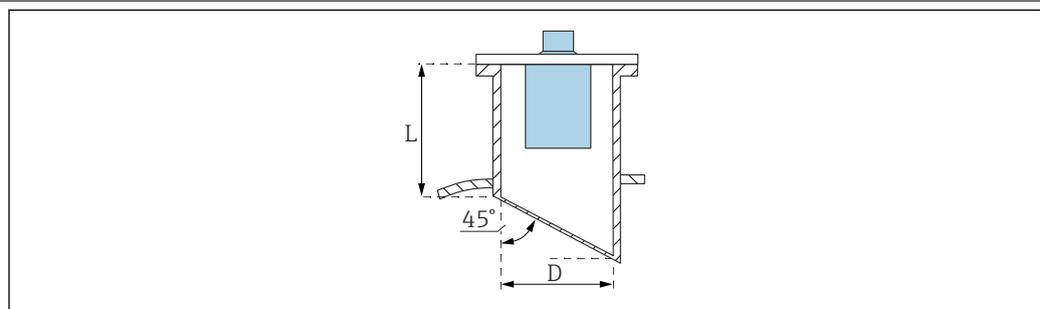

A0039840

- D Diâmetro do bocal
 L Comprimento do bocal


Condições no bocal

- Interior liso, sem extremidades ou soldas
- Sem rebarbas no interior da extremidade do bocal do lado do tanque
- Bocal chanfrado no lado do tanque (de preferência: 45 °)

Comprimento máximo do bocal

- D = DN80/3": $L_{máx.} = 340 \text{ mm (13.4 in)}$
- D = DN100/4": $L_{máx.} = 390 \text{ mm (15.4 in)}$
- D = DN150/6" a DN300/12": $L_{máx.} = 400 \text{ mm (15.7 in)}$

Tubo guia de ultrassom para medições em poços estreitos

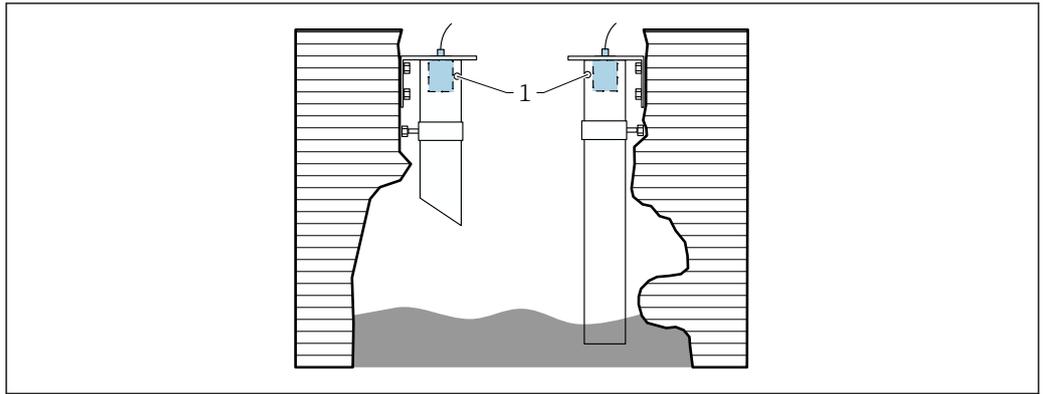

A0036695

1 Abertura de ventilação


- Tubo guia de ultrassom adequado: por ex. tubo de esgoto de PE ou PVC
- Diâmetro mínimo: DN100
- Abertura de ventilação na parte superior
- Sem contaminação por sujeira acumulada (limpe regularmente quando necessário)

Fixação do sensor

AVISO

Risco de danos ao sensor

- ▶ Não utilize o cabo do sensor para fins de suspensão.
- ▶ Não danifique a membrana do sensor ao instalar.

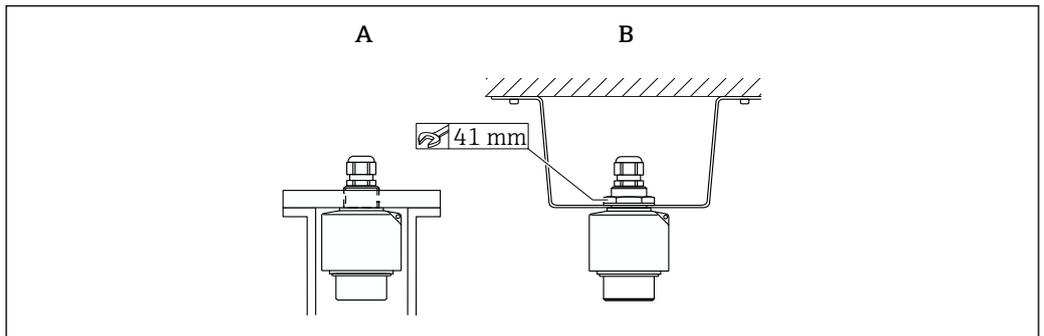

A0039841

8 Fixação do sensor ultrassônico

- A Instalado na rosca traseira
- B Instalado com contraporca

Ambiente


Grau de proteção	Testado conforme IP68/NEMA6P (24 h submersido a 1.83 m (6 ft))
Resistência contra vibração	DIN EN 600068-2-64; 20 para 2 000 Hz; 1 (m/s ²)/Hz; 3x100 min
Temperatura de armazenamento	Idêntico à temperatura do processo
Resistência a choque térmico	Baseado em DIN EN 60068-2-14; teste conforme as temperaturas máx./mín. do processo; 0.5 K/min; 1 000 h
Compatibilidade eletromagnética	Compatibilidade eletromagnética de acordo com todas as especificações relevantes da série EN 61326 e NAMUR Recomendação EMC (NE 21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade. Em relação a emissões de interferência, o equipamento atende aos requisitos da classe A, e foi projetado apenas para uso em "ambiente industrial".

Processo

Temperatura do processo	-40 para +80 °C (-40 para +176 °F) Para evitar o acúmulo de gelo no sensor, os sensores estão disponíveis em uma versão com aquecimento do sensor integrado.
Pressão de processo	0.7 para 4 bar (10.15 para 58 psi)

Construção mecânica


Dimensões



A0036336

9 Dimensões. Unidade de medida mm (in)

Dimensões da contraporca G1"




A0036335

10 Contraporca; dimensões. Unidade de medida mm (in)

- i** A contraporca está incluída na entrega para os seguintes sensores:
FDU91-*G*** (rosca traseira G1)
- A contraporca não é adequada para roscas NPT.

Peso	Peso incluindo cabo 5 m (16 ft) Aprox. 1.1 kg (2.43 lb)
-------------	--

Materiais



A0038715

11 *Materiais*

- 1 Invólucro do sensor: PVDF
- 2 Contraporca: PA6.6
- 3 Prensa-cabo: PA
- 4 Adaptador de tubo: CuZn niquelado
- 5 Anel O-ring: EPDM
- 6 Vedação: EPDM

Materiais do cabo de conexão PVC

Material da contraporca G1"

- Contraporca: PA6.6
- Vedação (incluída na entrega): EPDM

Certificados e aprovações

Identificação CE O sistema de medição atende aos requisitos legais das Diretrizes UE. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade UE correspondente junto com as normas aplicadas.
A Endress+Hauser confirma o teste bem-sucedido do equipamento, fixando-lhe a identificação CE.

RoHS O sistema de medição está em conformidade com as restrições de substância da diretiva Restrição de Certas Substâncias Perigosas 2011/65/EU (RoHS 2).

Selo de verificação RCM O produto fornecido ou os sistemas de medição atendem às demandas do ACMA (Autoridade Australiana de mídia e comunicações) por integridade de rede, interoperabilidade, características de desempenho e regulamentações de saúde e segurança. Nesse ponto, são atendidas especialmente as disposições regulamentares para a compatibilidade eletromagnética. Os produtos são rotulados com o Selo de verificação RCM na placa de identificação.



A0029561

Aprovação Ex Aprovações Ex disponíveis: consulte Configurator do Produto
 Sensores com aprovação Ex podem ser conectados ao transmissor FMU90 sem uma aprovação Ex.

Outras normas e diretrizes

- EN 60529**
Graus de proteção dos gabinetes (código IP)
- Série EN 61326**
Padrão da família de produtos EMC para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório
- NAMUR**
Associação do usuário de tecnologia de automação em indústrias de processo

Informações para pedido

Informações para pedido

Informações de pedido detalhadas estão disponíveis para sua organização de vendas mais próxima www.addresses.endress.com ou no configurador do produto sob www.endress.com

1. Clique em Corporativo
2. Selecione o país
3. Clique em Produtos
4. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa
5. Abra a página do produto

O botão Configuração à direita da imagem do produto abre o Configurador de Produtos.

Configurador de produto - a ferramenta para configuração individual de produto

- Dados de configuração por minuto
- Dependendo do equipamento: entrada direta de ponto de medição - informação específica, como faixa de medição ou idioma de operação
- Verificação automática de critérios de exclusão
- Criação automática do código de pedido e sua separação em formato de saída PDF ou Excel
- Funcionalidade para solicitação direta na loja virtual da Endress+Hauser

Protocolo de linearidade de 5 pontos


Condições para o protocolo de linearidade de 5 pontos

- O protocolo de linearidade de 5 pontos se aplica para todo o sistema de medição, consistindo no sensor e transmissor. Ao fazer o pedido, especifique a entrada de sensor do transmissor onde o sensor será testado.
- O teste de linearização é conduzido sob condições de operação de referência do transmissor.

Posição dos pontos de linearização

- Os 5 pontos do protocolo de linearidade são distribuídos uniformemente sobre o span S.
- Para definir o span, valores para **Calibração vazio** (E) e **Calibração cheio** (F) devem ser especificados ao fazer o pedido.
- Os valores especificados são usados apenas para criar o protocolo de linearidade. **Calibração vazio** e **Calibração cheio** são então redefinidas para os ajustes de fábrica.

Condições para definir o span

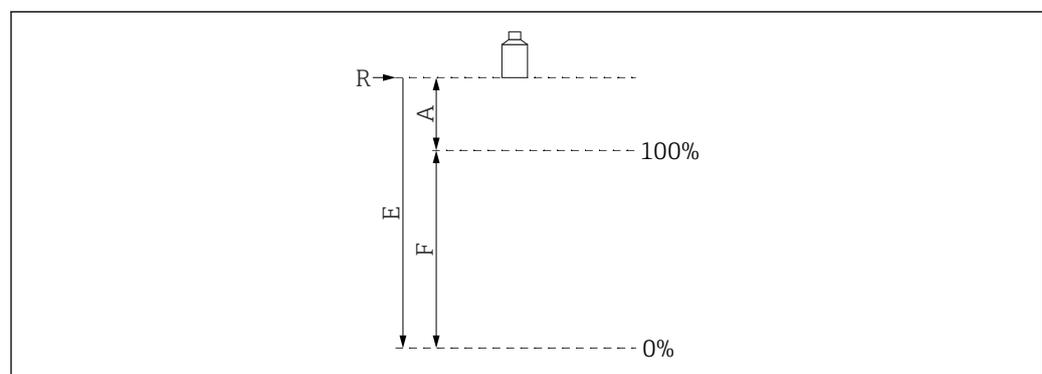

A0019526

12 Variáveis para definir o span

- R Ponto de referência (membrana do sensor)
 E "Calibração vazio" (distância da membrana do sensor ao ponto 0%)
 F "Calibração cheio" (distância do ponto 0% ao ponto 100%)
 A Distância da membrana do sensor ao ponto 100%

- $E \leq 10\,000$ mm (394 in)
- $F = 100$ para 9 700 mm (3.94 para 382 in)
- $A \geq 300$ mm (11.8 in)

Escopo de entrega

- Versão solicitada do sensor
- Para versões certificadas: Instruções de Segurança (XAs)
- Para sensores com aquecedor de sensor: módulo terminal para instalação no invólucro de campo do transmissor FMU90
- Para sensores com conexão de processo G1": contraporca (PA6.6) e vedação (EPDM)

Acessórios

Extensão de cabo do sensor

-  Comprimento total máximo permitido (cabo sensor + cabo de extensão): 300 m (984 ft)
- O cabo do sensor e o cabo de extensão são o mesmo tipo de cabo.


Sensor sem aquecedor de sensor

- Tipo de cabo: LiYCY 2x(0,75)
- Material: PVC
- Temperatura ambiente: -40 para +105 °C (-40 para +221 °F)
- Número de pedido: 71027742

Sensor com aquecedor de sensor

- Tipo de cabo: LiYY 2x(0,75)D+2x0,75
- Material: PVC
- Temperatura ambiente: -40 para +105 °C (-40 para +221 °F)
- Número de pedido: 71027746

Tampa de proteção contra tempo




A0039949

 13 Tampa de proteção contra tempo. Unidade de medida mm (in)

- **Material:** PVDF
- **Número de pedido:** 52025686

Flange rosqueável FAX50




A0044264

-  Instalação na rosca traseira G1 ou NPT1
- Tamanhos de flange disponíveis: consulte o Configurador do Produto
- Diâmetro nominal mínimo: DN80 / NPS 3"

Braço cantilever para sensores

Aplicação



A0019589

14 Montagem do sensor com braço cantilever


- A Instalação em braço com suporte de parede
 B Instalação em braço com estrutura de montagem
 1 Cantilever
 2 Estrutura de montagem
 3 Suporte de parede

Uso dos orifícios

- Orifício de 35 mm (1.4 in)
Sensor com contraporca
- Orifício de 22 mm (0.9 in)
Sensor de temperatura (por ex. Omnigrad TR61 com conexão de processo TA50)

Dimensões

Braço cantilever 500 mm, para todas as conexões traseiras G 1" ou MNPT 1"



A0037806

15 Dimensões. Unidade de medida mm (in)

Peso:

3.0 kg (6.62 lb)

Material

316L (1.4404)

Número de pedido

71452315




- 35 mm (1.38 in) aberturas para todas as conexões traseiras G 1" ou MNPT 1"
- 22 mm (0.87 in) abertura pode ser usada para qualquer sensor adicional
- Parafusos de retenção estão inclusos na entrega

Peso
1.21 kg (2.67 lb)

Material
316L (1.4404)

Número de pedido
71452323

Suporte de montagem para instalação no teto



20 Suporte de montagem para instalação no teto. Unidade de medida mm (in)


- Material: 316 L (1.4404)
- Número do pedido: 71093130

Unidade de alinhamento
FAU40

Uso

- Para alinhar um sensor ultrassônico com a superfície de sólidos a granel
- Área de giro: 15°
- Separação em zonas para áreas com risco de explosão

Dimensões

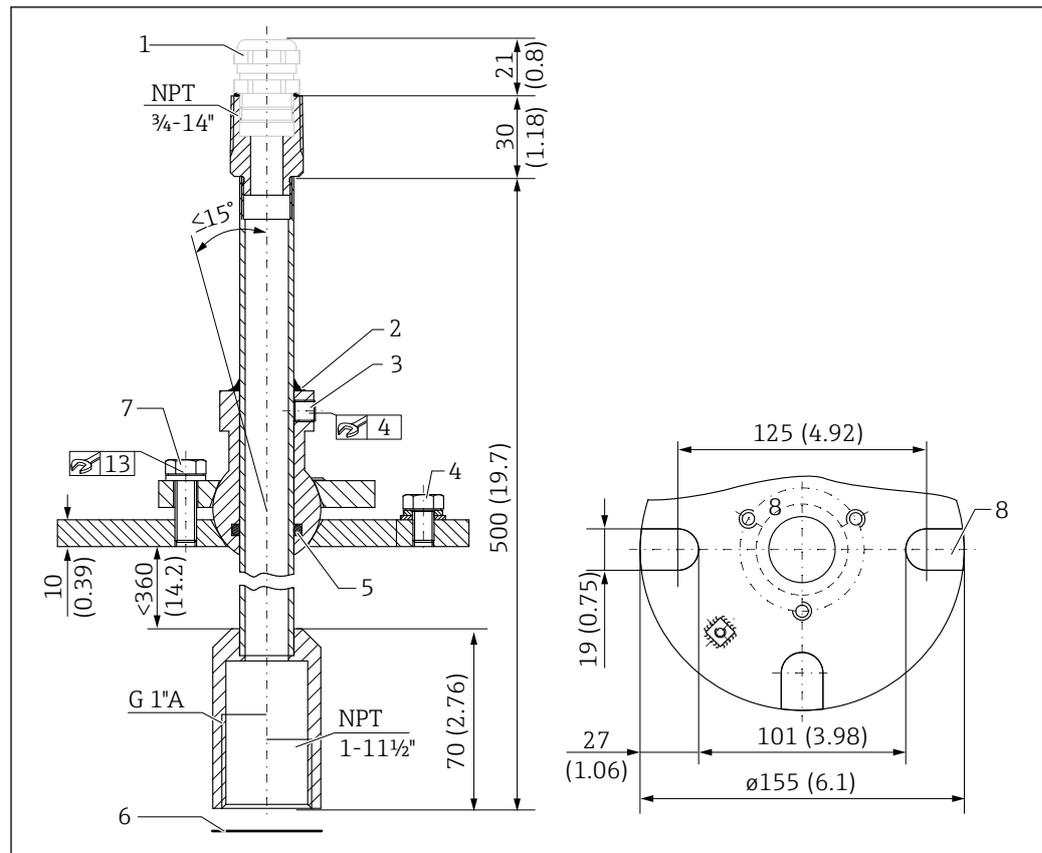

21 Unidade de alinhamento FAU40. Unidade de medida mm (in)

- 1 Prensa cabos M20x1,5 (se selecionado na estrutura do produto)
- 2 Vede aqui
- 3 Duas chaves Allen para ajuste de altura (8 Nm (6 lbf ft)±2 Nm (±1.5 lbf ft))
- 4 Parafuso de aterramento
- 5 O-ring
- 6 Vedação fornecida com o sensor, deve ser usada para aplicações em ATEX zona 20
- 7 Parafuso para ajuste lateral (18 Nm (13.5 lbf ft)±2 Nm (±1.5 lbf ft))
- 8 Encaixes de montagem (na versão com flange UNI)

Informações adicionais

 Informações técnicas TI00179F

Unidade de fonte de alimentação RNB130 para o aquecedor do sensor

Dados técnicos

- **Função:** Fonte de alimentação comutada primária
- **Entrada:** 100 para 240 V_{AC}
- **Saída:** 24 V_{DC}; máx. 30 V em casos de erro

Opções de conexão

- Sistema de alimentação A/C monofásico
- Condutores bifásicos de sistemas de alimentação trifásicos (sistema TN, TT ou IT conforme VDE 0100 T 300/IEC 364-3)

Disponível opcionalmente: invólucro protetor IP66

Informações adicionais

 Informações técnicas TI00120R

Invólucro protetor IP66 para unidade de fonte de alimentação RNB130

- **Número de pedido:** 51002468
- **Informações adicionais:** Informações Técnicas TI00080R

Documentação adicional

Documentação para transmissor FMU90

- Informações técnicas TI00397F
- Instruções de operação:
 - BA00288F (HART, medição de nível)
 - BA00289F (HART, medição de vazão)
 - BA00292F (Profibus DP, medição de nível)
 - BA00293F (Profibus DP, medição de vazão)
- Descrição dos parâmetros do equipamento: GPO1151F

Documentação para transmissor FMU95

- Informações técnicas TI00398F
- Instruções de operação: BA00344F
- Descrição dos parâmetros do equipamento: GPO1152F

Outras documentações



Mais informações e a documentação atualmente disponível podem ser encontradas no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads.





www.addresses.endress.com
