

Çalıştırma Talimatları

TOC Analizör CA79

İz mesafesindeki toplam organik karbonun (TOC) belirlenmesi
Güçlü kompakt cihaz



İçindekiler

1	Bu doküman hakkında	4	10	Hata teşhisи ve arıza giderme	43
1.1	Uyarılar	4	10.1	Hortum sisteminin değiştirilmesi	43
1.2	Semboller	4	10.2	Cihaz yazılımı geçmişi	44
1.3	Cihaz üzerindeki semboller	4			
1.4	Doküman	4			
2	Temel güvenlik talimatları	5	11	Bakım	45
2.1	Personel için gereksinimler	5	11.1	Bakım programı	45
2.2	Kullanım amacı	5	11.2	Bakım işleri	45
2.3	İş yeri güvenliği	5	11.3	Çalışmadan kaldırma	48
2.4	Çalışma güvenliği	5			
2.5	Ürün güvenliği	6			
3	Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması	7	12	Onarım	49
3.1	Teslimatın kabul edilmesi	7	12.1	Yedek parçalar	49
3.2	Ürün tanımlaması	7	12.2	İade	49
3.3	Teslimat kapsamı	8	12.3	İmha	49
4	Ürün açıklaması	9	13	Aksesuarlar	50
4.1	Ürün tasarımı	9	14	Teknik bilgiler	51
4.2	Proses şeması	10	14.1	Giriş	51
4.3	Soket ataması	10	14.2	Çıkış	51
5	Montaj	12	14.3	Akım çıkışları, aktif	51
5.1	Montaj gereksinimleri	12	14.4	Güç beslemesi	52
5.2	Analizörün montajı	13	14.5	Performans özellikleri	52
5.3	Montaj sonrası kontrol	15	14.6	Çevre	52
6	Elektrik bağlantısı	16	14.7	Proses	53
6.1	Bağlantı talimatları	16	14.8	Mekanik yapı	53
6.2	Analizörün bağlanması	16			
6.3	Koruma derecesinin temin edilmesi	16			
6.4	Bağlantı sonrası kontrol	16			
7	Çalıştırma seçenekleri	17	İndeks	54	
7.1	Çalışma seçeneklerine genel bakış	17			
7.2	Çalışma menüsünün yapısı ve fonksiyonu	17			
7.3	Lokal ekranı kullanarak çalışma menüsüne erişim	18			
8	Devreye alma	19			
8.1	Fonksiyon kontrolü	19			
8.2	Oturum açma prosedürü	19			
8.3	Ölçüm cihazının yapılandırılması	19			
9	Çalışma	42			

1 Bu doküman hakkında

1.1 Uyarılar

Bilgilerin yapısı	Anlamı
 TEHLİKE Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşacaktır.
 UYARI Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde ölümcül veya ciddi yaralanmalar oluşabilir.
 DİKKAT Nedenleri (/sonuçları) Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Düzeltme eylemi	Bu işaret, tehlikeli durumları belirtir. Tehlikeli durum engellenmediği takdirde hafif veya daha ciddi yaralanmalar oluşabilir.
 DUYURU Neden/durum Uyulmaması halinde olabilecekler (geçerliyse) ► Eylem/not	Bu işaret, maddi hasara neden olabilecek durumlara karşı uyarır.

1.2 Semboller

-  Ek bilgi, ipucu
-  İzin verilen veya tavsiye edilen
-  İzin verilmeyen veya tavsiye edilmeyen
-  Cihaz dokümantasyonu referansı
-  Sayfa referansı
-  Grafik referansı
-  Adım sonucu

1.3 Cihaz üzerindeki semboller

 Cihaz dokümantasyonu referansı

1.4 Doküman

Bu Kullanım Talimatlarının tamamlayıcısı olan aşağıdaki kılavuzlar, İnternet üzerindeki ürün sayfalarında bulunabilir:

 TOC Analizör CA79 için Teknik Bilgiler, TI01623C

2 Temel güvenlik talimatları

2.1 Personel için gereksinimler

- Ölçüm sisteminin kurulumu, işletilmesi ve bakımı sadece özel eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel, tesis operatörü tarafından belirtilen işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiş olmalıdır.
- Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Teknik personel bu Kullanım Talimatlarını okumuş ve anlamış olmalı ve belirtilen talimatlara uymalıdır.
- Ölçüm noktası arızaları sadece yetkili ve özel eğitimli personel tarafından onarılmalıdır.

 Bu Kullanım Talimatlarında belirtilmeyen onarımlar sadece doğrudan üretici veya servis kuruluşu tarafından yapılmalıdır.

2.2 Kullanım amacı

Analizör aşağıdaki koşulları sağlayan ultra saf su uygulamalarında toplam organik karbonu belirlemek amacıyla tasarlanmıştır:

- İletkenlik < 2 µS/cm
- pH aralığı: nötr

Bu cihazın belirtilenin dışında herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılması can güvenliği ve tüm ölçüm sistemi açısından bir tehlike teşkil etmekte olup, bu şekilde kullanılması yasaktır.

Üretici, yanlış veya amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.

2.3 İş yeri güvenliği

Kullanıcı olarak aşağıdaki güvenlik şartlarına uyma sorumluluğu size aittir:

- Montaj kuralları
- Yerel standartlar ve düzenlemeler

Elektromanyetik uyumluluk

- Ürün, endüstriyel uygulamalarla ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde elektromanyetik uyumluluk açısından test edilmiştir.
- Belirtilen elektromanyetik uyumluluğun sağlanması için ürün bu Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde bağlanmalıdır.

2.4 Çalışma güvenliği

Tüm ölçüm noktasını devreye almadan önce:

1. Tüm bağlantıların doğru olduğunu onaylayın.
2. Elektrik kablolarında ve hortum bağlantılarında hasar bulunmadığından emin olun.
3. Hasarlı ürünler çalıştırmayın ve kaza eseri çalışmalarını engelleyin.
4. Hasarlı ürünler arızalı olarak etiketleyin.

Çalışma sırasında:

- Arızalar giderilemiyorsa:
ürünler kullanımından çıkarılmalıdır ve kaza eseri çalışmalarına karşı korunmalıdır.

2.5 Ürün güvenliği

2.5.1 En güncel teknoloji

Ürün, güvenlik açısından en son teknolojiye göre tasarlanmış olup, test edilmiş ve üretim yerinden kullanım güvenliğini sağlayacak şekilde ayrılmıştır. İlgili tüm düzenlemelere ve uluslararası standartlara uyulmuştur.

2.5.2 IT güvenliği

Cihazın garantisinin geçerli olabilmesi için cihaz, Kullanım Talimatlarında belirtilen şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Cihaz üzerinde ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engelleyen güvenlik mekanizmaları mevcuttur.

Kullanıcı, cihazın ve cihazın veri aktarımının güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış ve şirketinin güvenlik standartlarına uygun Bilişim Teknolojisi (IT) güvenlik önlemlerini alınmasından kendisi sorumludur.

3 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

3.1 Teslimatın kabul edilmesi

1. Paketin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Pakette herhangi bir hasar varsa tedarikçiye uyarın. Sorun çözümlenene kadar hasarlı paketi ellemeyin.
2. Paket içeriğinin hasar görmediğinden emin olun.
 - ↳ Teslimat içeriğinde herhangi bir hasar varsa tedarikçiye uyarın. Sorun çözümlenene kadar hasarlı ürünler dokunmayın.
3. Teslimatın eksiksiz olduğundan ve eksik parça olmadığından emin olun.
 - ↳ Nakliye dokümanlarını siparişiniz ile karşılaştırın.
4. Ürünün saklanması ve depolanmasında kullanılan ambalaj darbelere ve neme karşı koruma sağlamalıdır.
 - ↳ Bu amaçla en iyi korumayı orijinal paket sağlar. İzin verilen ortam koşullarına uyduğunuzdan emin olun.

Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen tedarikçinize veya yerel satış merkezinize başvurun.

3.2 Ürün tanımlaması

3.2.1 İsim plakası

İsim plakası cihazlarındaki şu bilgileri içerir:

- Üretici tanımlaması
- Sipariş kodu (cihaz versiyonu)
- Seri numarası
- Uzun sipariş kodu
- Güç beslemesi
- Koruma derecesi
- (İzin verilen) ortam koşulları

► İsim plakası üzerindeki bilgileri sipariş ile karşılaştırın.

3.2.2 Ürün tanımlaması

Ürün sayfası

www.endress.com/ca79

Sipariş kodunun okunması

Ürününüzün sipariş kodunu ve seri numarasını şu yerlerde bulabilirsiniz:

- İsim plakasında
- Teslimat kağıtlarında

Ürün hakkında bilgi

1. www.endress.com adresine gidin.
2. Sayfada arama (büyüteç simbolü): Geçerli seri numarası girin.
3. Arama yapın (büyüteç).
 - ↳ Ürün yapısı açılan bir popup pencerede görüntülenir.

4. Ürüne genel bakışı tıklayın.

↳ Yeni bir pencere açılır. Burada, ürün dokümantasyonu da dahil olmak üzere cihazınızla ilgili bilgileri doldurun.

3.2.3 Üretici adresi

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

3.3 Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Sipariş edilen konfigürasyonda 1 analizör
 - 1 kurulum kiti
 - 1 kalibrasyon sertifikası
 - 1 sistem uygunluk testi (SST) sertifikası
 - 1 x Kullanım Talimatları
- Herhangi bir sorunuz olması durumunda:
Lütfen tedarikçinizle veya yerel satış merkezi ile irtibata geçin.

4 Ürün açıklaması

4.1 Ürün tasarıımı


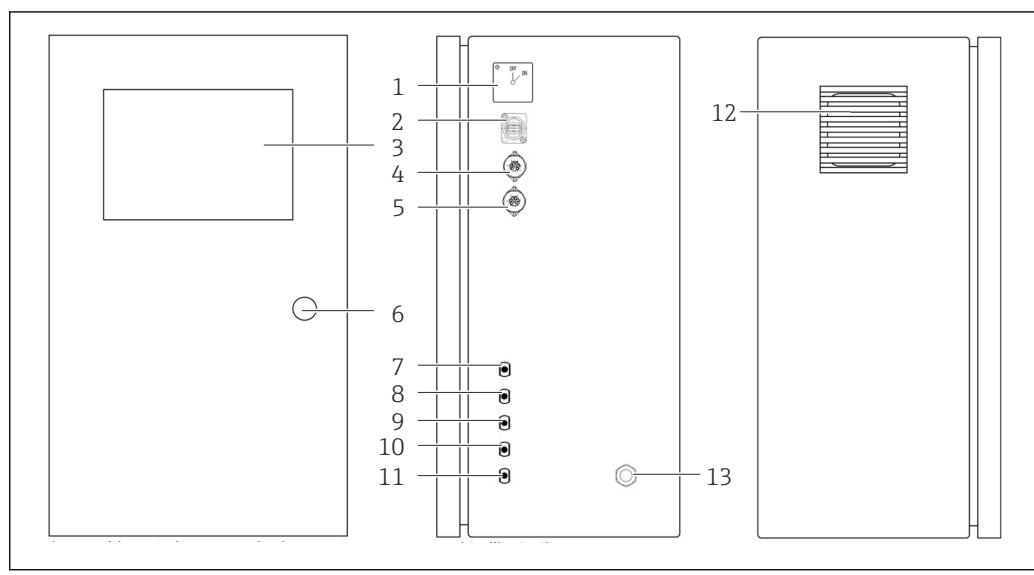


Fig 1 Ürün tasarıımı

- 1 Ana sıvıç
- 2 USB portu
- 3 Ekran
- 4 Analog çıkış 1
- 5 Analog çıkış 2
- 6 Muhafaza kiliti
- 7 Sıvı girişi, numune, UNF ¼ - 28 (sipariş seçeneği)
- 8 Sıvı girişi 1, UNF ¼ - 28
- 9 Sıvı girişi 2, UNF ¼ - 28 (sipariş seçeneği)
- 10 Sıvı girişi 3, UNF ¼ - 28 (sipariş seçeneği)
- 11 Sıvı çıkışlı, atık, UNF ¼ - 28
- 12 Filtre keçesine sahip fan muhafazası
- 13 Güç beslemesi için kablo rakoru

4.2 Proses şeması

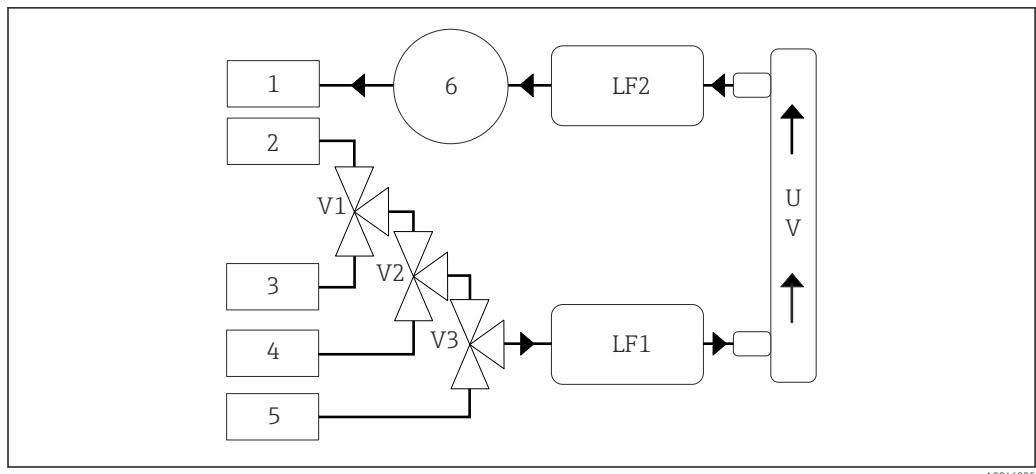

■ 2 Proses şeması

1 Atık

2 Numune

3 Giriş 1

4 Giriş 2

5 Giriş 3

6 Pompa

V1 - Valf 1, valf 2 (sipariş seçeneği) ve valf 3 (sipariş seçeneği)

V3


LF1 -İletkenlik ve sıcaklık sensörleri

LF2

UV UV lambası (12 VDC)

4.3 Soket ataması

4.3.1 Soket ataması (bir bağlantı soketine sahip sistem)

Soket	Uç	Açıklama
 A0046897	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC (0 ile ayarlanan limit arası)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Δ iletkenlik (0 ile ayarlanan limit arası)
	5: Röle 6: Röle	Seçilen seçenekéye bağlı olarak grup hata mesajı veya limit değerinde yukarı yönlü sapma

Pim 1/2: 0 ile limit arasında (**Settings** menüsü, **Options 1** sekmesinden yapılandırılır) ölçülen TOC değeri için 4 ile 20 mA arasında bir analog sinyal verir.

Pim 3/4: 0 ile limit arasında $\mu\text{S}/\text{cm}$ biriminde **Settings** menüsü, **Service 1** sekmesinden yapılandırılır) Δ iletkenlik değeri için 4 ile 20 mA arasında bir analog sinyal verir ¹⁾.


Pim 5/6: "Analog çıkış" seçenekénde yapılandırılan TOC veya iletkenlik limit değerinin aşılması halinde bir NO kontak veya bir güç arızası, bir kaçak tepkisi durumunda grup hata mesajı ile seçenekte, lamba veya basınç sensörü rekaksiyonu ve iki iletkenlik sensöründen birinin aralık dışında olması halinde bir NC kontak olarak görev yapar.

Ölçülen değer her dakika güncellenir. Bir kalibrasyon veya SST sırasında yeni bir ölçüm başlatılana kadar son değer görüntülenir.

1) servis şifresi gereklidir

4.3.2 Soket ataması (iki bağlantı soketine sahip sistem)

Çıkış 1


Soket	Uç	Açıklama
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 1 (0 ile ayarlanan limit arası)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	Δ iletkenlik (0 ile ayarlanan limit arası)
	5: Röle 6: Röle	Seçilen seçenekéye bağlı olarak grup hata mesajı veya limit değerinde yukarı yönlü sapma

Pim 1/2: 0 ile limit arasında (**Settings** menüsü, **Options 1** sekmesinden yapılandırılır) NUMUNEDE ölçülen TOC değeri için 4 ile 20 mA arasında bir analog sinyal verir.

Pim 3/4: 0 ile limit arasında $\mu\text{S}/\text{cm}$ biriminde (**Settings** menüsü, **Service 1** sekmesinden yapılandırılır) Δ iletkenlik değeri için 4 ile 20 mA arasında bir analog sinyal verir.

Pim 5/6: "Analog çıkış" seçenekénde yapılandırılan TOC veya iletkenlik limit değerinin aşılması halinde bir NO kontak veya bir güç arızası, bir kaçak tepkisi durumunda grup hata mesajı ile seçenekte, lamba veya basınç sensörü reaksiyonu ve iki iletkenlik sensöründen birinin aralık dışında olması halinde bir NC kontak olarak görev yapar.

Çıkış 2

Soket	Uç	Açıklama
	1: 4 (0) - 20 mA (GND) 2: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 2 (0 ile ayarlanan limit arası)
	3: 4 (0) - 20 mA (GND) 4: 4 (0) - 20 mA (+)	TOC 3 (0 ile ayarlanan limit arası)
	5: Kontrol Cihazı (GND) 6: Kontrol Cihazı (+)	24 VDC için kontrol cihazı girişi / tetikleme

Pim 1/2: 0 ile limit arasında (**Settings** menüsü, **Options 1** sekmesinden yapılandırılır) GİRİŞ 2'de ölçülen TOC değeri için 4 ile 20 mA arasında bir analog sinyal verir.

Pim 3/4: 0 ile limit arasında (**Settings** menüsü, **Options 1** sekmesinden yapılandırılır) GİRİŞ 3'de ölçülen TOC değeri için 4 ile 20 mA arasında bir analog sinyal verir.


Pim 5/6: Harici kontrol cihazı giriş / tetikleme, voltaj uygulandığında ölçüm aktiftir ve voltaj 0 V değerine düştüğünde durur.

Ölçülen değer her dakika güncellenir. Bir kalibrasyon veya SST sırasında yeni bir ölçüm başlatılana kadar son değer görüntülenir.

5 Montaj

5.1 Montaj gereksinimleri

5.1.1 Boyutlar

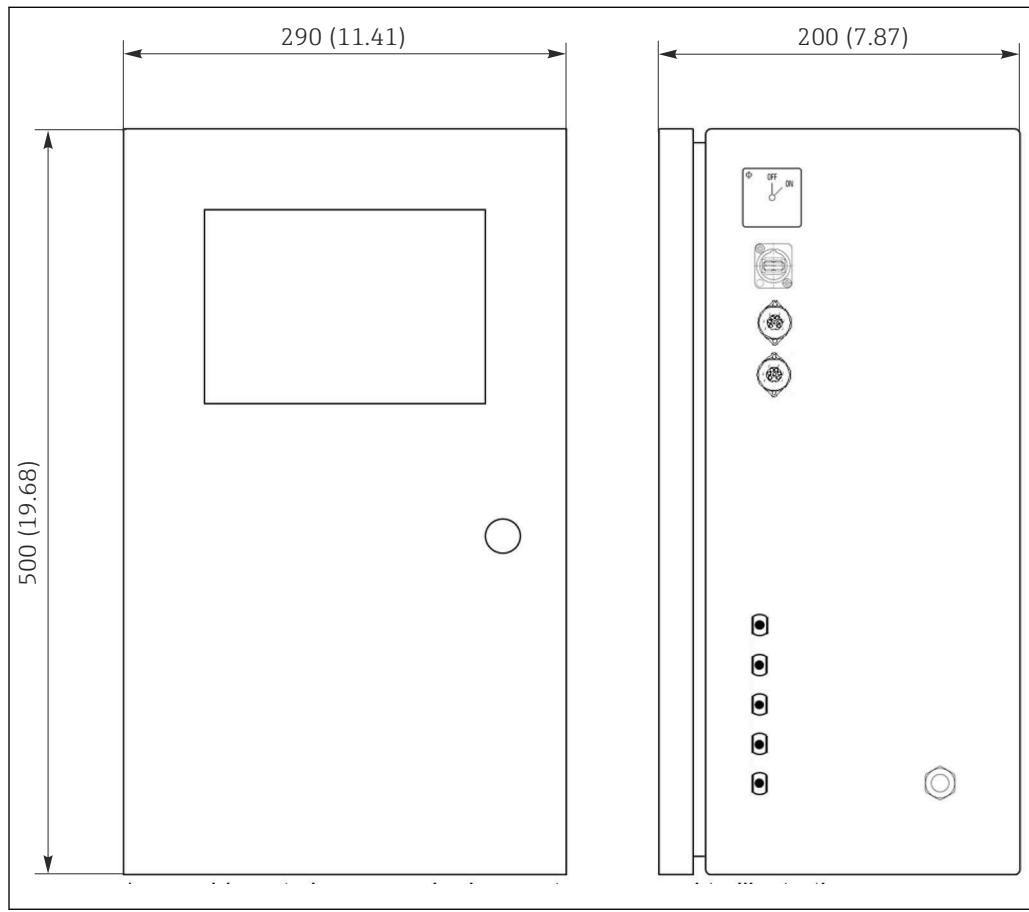


■ 3 Boyutlar, mm (inç)

5.1.2 Montaj seçenekleri

Analizör masa üstüne ve duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

i Aşağıdaki grafik muhafazanın arka tarafındaki kör perçin somunlarının yerini gösterir. Bir montaj çerçevesini sabitlemek için kullanılırlar. Duvara montaj için montaj çerçevesi teslimat kapsamına dahil değildir.

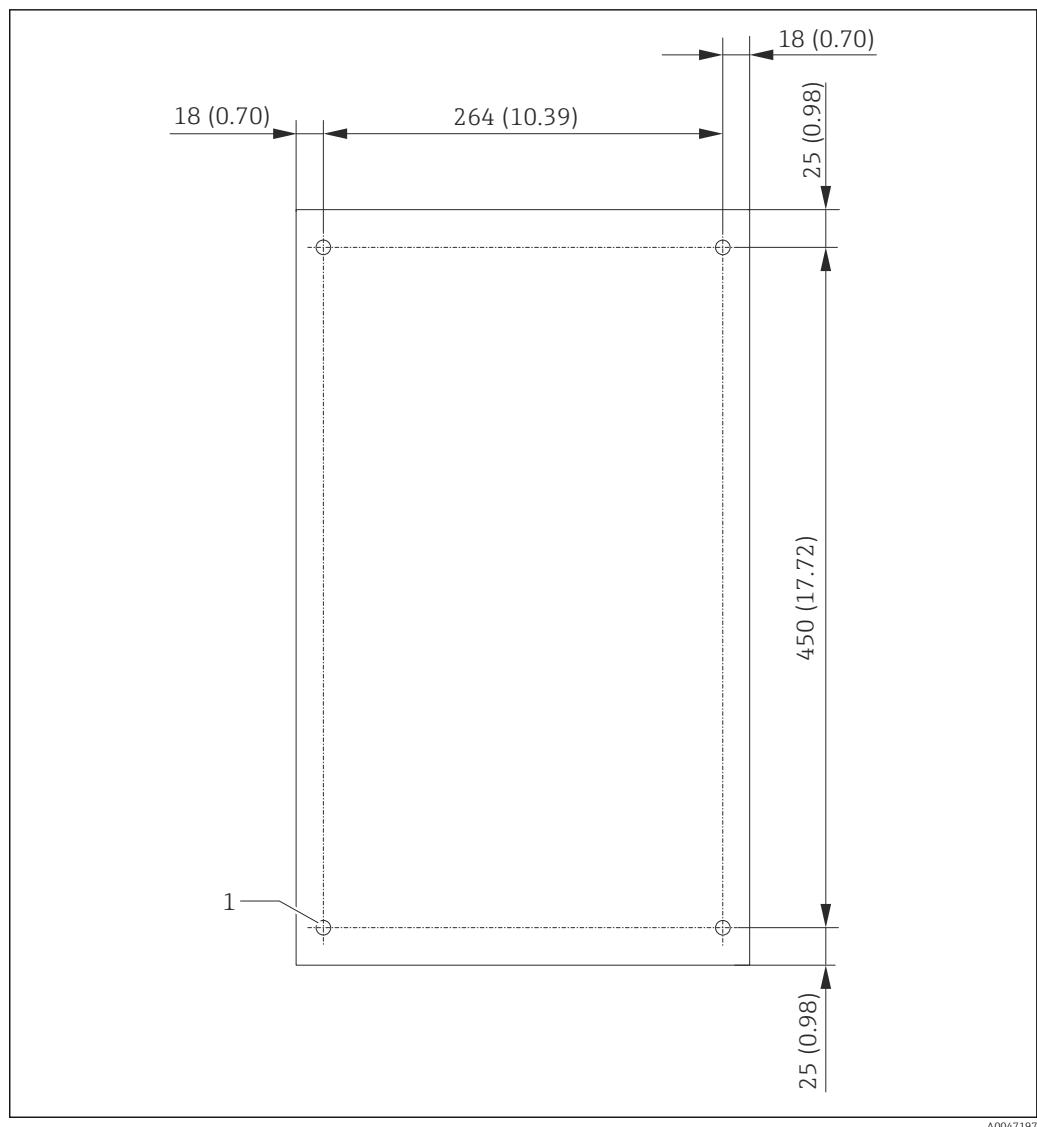

■ 4 Muhabazanın arkası

1 Kör perçin somunu

5.2 Analizörün montajı

⚠ UYARI

Cihazda elektrik vardır!

Elektrik çarpması tehlikesi!

- ▶ Tesisat çalışması tamamlanmadan ve madde bağlanmadan önce analizörü elektrik beslemesine bağlamayın.
- ▶ "Elektrik bağlantıları" bölümündeki talimatları takip edin.

5.2.1 Montaj sıralaması

Masa üstüne montaj

1. Analizörü düz, titreşimsiz bir yüzeye yerleştirin.
2. Muhabazanın ön kapısını açın ve içerisindeki yapıyı görünür hasar işaretlerine karşı kontrol edin.
3. Entegre tüm sıvı bağlantılarının kontrol edin. Hortumlar bükülmüş veya hasarlı olmamalıdır.

4. Sabit bir şekilde yerlerine oturduklarından emin olmak için sıvı kaplinlerinin tümünü kontrol edin (elle sıkıştırın).
5. Gözle kontroller sonrasında TOC sisteminin numune besleme hattının ve atık hattının monte edilmesi için zaman gelmiştir. Hatların mümkün olduğunda kısa tutulması ve kısaltma esnasında bir hortum makası ile dik açıda düz kesilmeleri önemlidir.


Bir duvara montaj

1. Muhofazanın ön kapısını açın ve içerisindeki yapıyı görünür hasar işaretlerine karşı kontrol edin.
2. Entegre tüm sıvı bağlantılarının kontrol edin. Hortumlar bükülmüş veya hasarlı olmamalıdır.
3. Sabit bir şekilde yerlerine oturduklarından emin olmak için sıvı kaplinlerinin tümünü kontrol edin (elle sıkıştırın).
4. Gözle kontroller sonrasında TOC sisteminin numune besleme hattının ve atık hattının monte edilmesi için zaman gelmiştir. Hatların mümkün olduğunda kısa tutulması ve kısaltma esnasında bir hortum makası ile dik açıda düz kesilmeleri önemlidir.
5. Muhofazayı montaj çerçevesine monte edin.
6. Müşteriye özel montaj çerçevesini duvara monte edin.

Elektrik bağlantısı

1. Sinyal çıkışlarını → 10 bağlayın.
2. Şebeke prizini sokete takın (240 V, 50/60 Hz veya opsiyonel olarak 100 V, 50/60 Hz).

5.2.2 Maddenin bağlanması

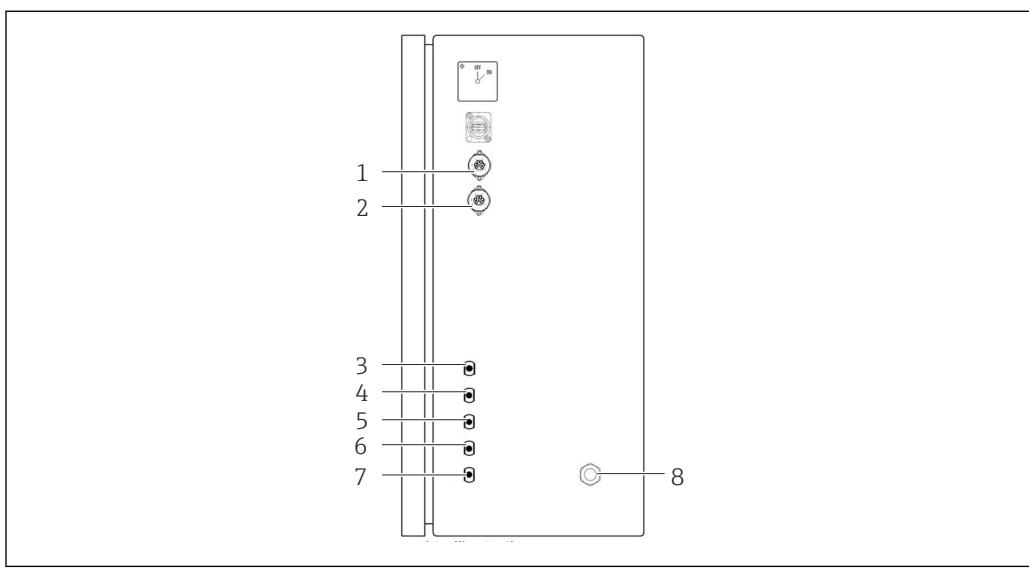

5 Analizör, sağ panel

- | | | |
|------------------|------------------------------|------------------|
| 1 Analog çıkış 1 | 4 Giriş 1 | 7 Atık |
| 2 Analog çıkış 2 | 5 Giriş 2 (sipariş seçeneği) | 8 Güç bağlantısı |
| 3 Numune | 6 Giriş 3 (sipariş seçeneği) | |

Analizör numune çıkışı

Numune bir hortumla boşaltılır (atık numunesi).

- Hortumu ters basınç oluşmayacak şekilde döşeyin.

5.3 Montaj sonrası kontrol

1. Tüm bağlantıların güvenli olduğunu ve kaçak bulunmadığını kontrol edin.
2. Tüm hortumları hasara karşı kontrol edin.
↳ Hasarlı hortumları değiştirin.

6 Elektrik bağlantısı

6.1 Bağlantı talimatları

⚠ UYARI

Cihazda elektrik vardır!

Elektrik çarpması tehlikesi! Hatfiltresi, aşırı voltaj modülü ve ana siviç, ana siviç kapatılmış olsa dahi güç beslemesine halen bağlı durumdadır!

- ▶ Cihazın güç beslemesi ile bağlantısını kesin (şebekе prizini çıkarın).
- ▶ Bağlantı öncesinde şebekе voltajının isim plakasında belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.
- ▶ Analizörün şebekе bağlantısı ile yeterince topraklanmış olduğundan emin olun.
- ▶ Elektrik bağlantısını kurmadan önce, önceden döşenen güç kablosunun yerel ve ulusal elektrik güvenliği spesifikasyonlarına uygun olduğunu doğrulayın.

6.2 Analizörün bağlanması

- ▶ Şebekе prizini sokete takın (240 V, 50/60 Hz veya opsiyonel olarak 100 V, 50/60 Hz).

6.3 Koruma derecesinin temin edilmesi

Gerektiğinde, kullanım amacı doğrultusunda teslim edilen cihaz üzerinde sadece bu talimatlarda açıklanan mekanik ve elektrik bağlantıları yapılabilir.

- ▶ Çalışma sırasında çok dikkatli olun.

Aksi takdirde, bu ürün için üzerinde anlaşılmış olan ayrı koruma tipleri (Giriş Koruması (IP), elektrik güvenliği, EMC parazit koruması) artık garanti edilemez, bunun örnek nedenleri kapakların açık kalması veya gevşek veya yeterince sabitlenmemiş kablo (uçları) olabilir.

6.4 Bağlantı sonrası kontrol


Elektrik bağlantılarını yaptıktan sonra aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:

Cihaz durumu ve teknik özellikler	Notlar
Kabloların dışı hasarsız mı?	Gözle kontrol

Elektrik bağlantısı	Notlar
Bağlı olan transmiterin besleme voltajı isim plakasındaki veriler ile eşleşiyor mu?	240 VAC 50/60 Hz 100 VAC 50/60 Hz
Akım çıkışları korumalı ve bağlanmış mı?	
Bağlanan kablolarada gerginlik azaltması var mı?	
Kablo tipleri birbirlerinden uygun şekilde izole edilmiş mi?	Tüm rota boyunca güç kablosu ve sinyal kablolarnı birbirlerinden ayrı şekilde döşeyin. İdeal olan ayrı kablo kanallarıdır.
Kablolar düğüm ve bükülme olmadan doğru döşendi mi?	
Güç ve sinyal kablolari, kablolama şemasına uygun şekilde düzgün olarak bağlanmış mı?	

7 Çalıştırma seçenekleri

7.1 Çalışma seçeneklerine genel bakış

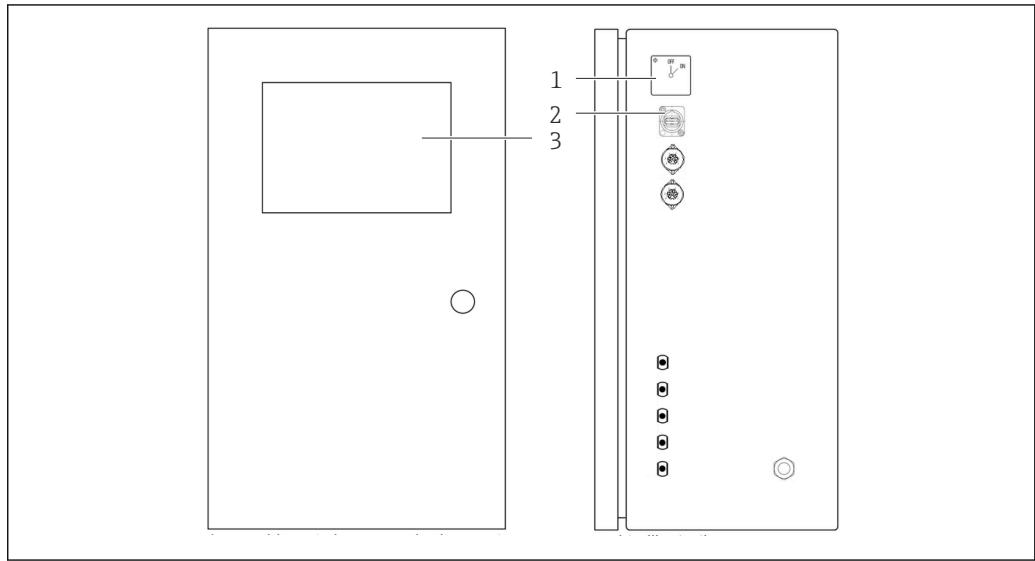


6 Çalıştırma elemanları

- 1 Ana sıvıç
- 2 USB portu
- 3 Dokunmatik ekran

7.2 Çalışma menüsünün yapısı ve fonksiyonu

Analizör aşağıdaki menülere sahiptir:

- Measure online
- Viewer (Geçmiş)
- Qualification (Kalibrasyon, sistem uygunluk testi [SST])
- System (Servis)
- Settings (Gelişmiş ayar ve servis)
- User management

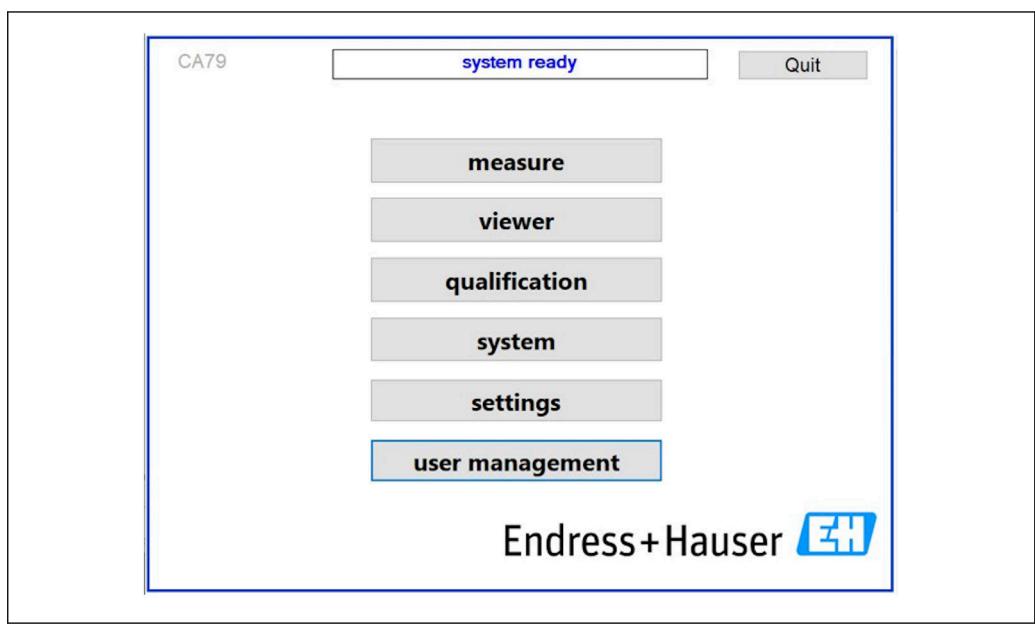

7.3 Lokal ekranı kullanarak çalışma menüsüne erişim

Tuş	Fonksiyon
Measure	► Tuşa basın. ↳ TOC ölçümü başlatıldı.
Viewer	► Tuşa basın. ↳ Viewer menüsü açılır. Ölçülen tüm TOC değerleri bu menüden görüntülenebilir.
Qualification	► Tuşa basın. ↳ Qualification menüsü açılır. Fonksiyonlar bu menüden seçilebilir.
System	► Tuşa basın. ↳ System menüsü açılır. En önemli parçalardaki fonksiyon kontrolleri bu menüden gerçekleştirilebilir.
Settings	► Tuşa basın. ↳ Settings menüsü açılır. Cihaz parametreleri bu menüden yapılandırılabilir.
User management	► Tuşa basın. ↳ User management menüsü açılır. Kullanıcı ayarları bu menüden yapılabılır.

8 Devreye alma

8.1 Fonksiyon kontrolü

Hatalı veya uygun bağlanmamış hortum bağlantıları sıvıların sızmasına ve hasara neden olmasına yol açabilir!

- ▶ Tüm bağlantıları kontrol edin ve doğru yapıldıklarından emin olun.
- ▶ Özellikle, tüm hortum bağlantılarının güvenli olduğunu ve sıvının sızamayacağını kontrol edin.

Hatalı güç beslemesi cihaza zarar verebilir!

- ▶ Besleme voltajının isim plakasında belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.

8.2 Oturum açma prosedürü

Oturum açmak için bir hesap ve bir şifre gereklidir.

1. Kullanıcı ID girin **install**.
2. **Login** tuşuna basın.
3. Şifreyi girin **default**.
4. **Login** tuşuna basın.
 - ↳ Yeni bir şifre girmeniz istenir.
5. Yeni bir şifre girin ve onaylayın.

Kullanıcı yönetimi ile ilgili ek bilgiler için: →  36


8.3 Ölçüm cihazının yapılandırılması

8.3.1 Ölçümün gerçekleştirilemesi

 İlk devreye alma öncesinde en az 30 dakikada bir durulama işlemi (bir ölçüm) yapılmalıdır. Daha büyük safsızlıklar veya kirlenme durumunda durulama (ölçüm) aynı değerleri tutarlı bir şekilde görüntülenene kadar devam etmelidir.

1. Ana menüdeki **Measure** tuşuna basın.
 - ↳ Bir açılır pencere açılır.
2. **Yes** tuşuna basın.
 - ↳ Program TOC ölçümü için hazırlık amacıyla sistemin durulanması ile başlatılır.
3. Zaman aralıklarını değiştirin:
Şema altındaki ilgili tuşa basarak zaman aralığını seçin.
4. Geçmişini görüntüleyin:
Ana menüdeki **Viewer** tuşuna basın.
 - ↳ **Viewer** menüsü açılır ve geçmiş görüntülenir →  22. Bu ölçümü kesintiye uğratmaz.
5. Ölçümü kesin:
Measure menüsünden çıkışın.


Durulama işlemi bittiğinde ölçüm otomatik olarak başlatılır. TOC, iletkenlik ve sıcaklık değerleri ekranda gösterilir. Ölçülen değerler sağ taraftaki şemada gösterilir. Eğer TOC veya iletkenlik değeri yapılandırılmış limit değerini geçerse, değer kırmızı renkte gösterilir. Ek olarak bir analog çıkış ile bir uyarı çıktıları verilir (opsiyonel). Limit şemada bir kırmızı çizgi olarak gösterilebilir.

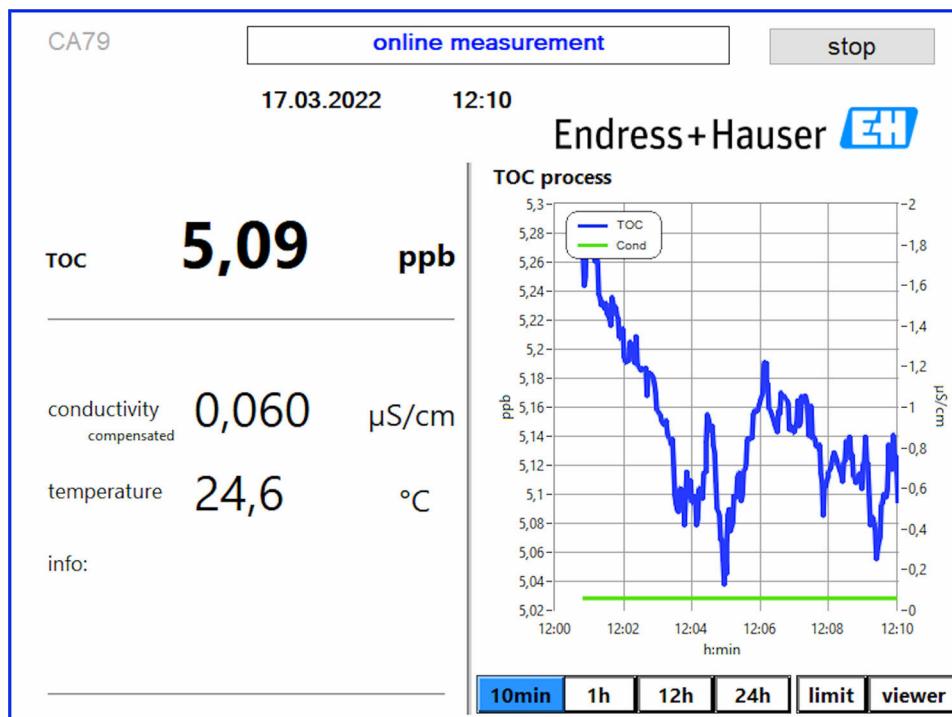

A0050163

Uyarılar

Eğer TOC ve/veya iletkenlik değeri yapılandırılmış limit değerinin üzerindeyse, değer kırmızı basamaklar şeklinde gösterilir. Ek olarak bir dijital çıkış ile bir uyarı çğıtıları verilir (opsiyonel). Limit şemada bir kırmızı çizgi olarak gösterilebilir.

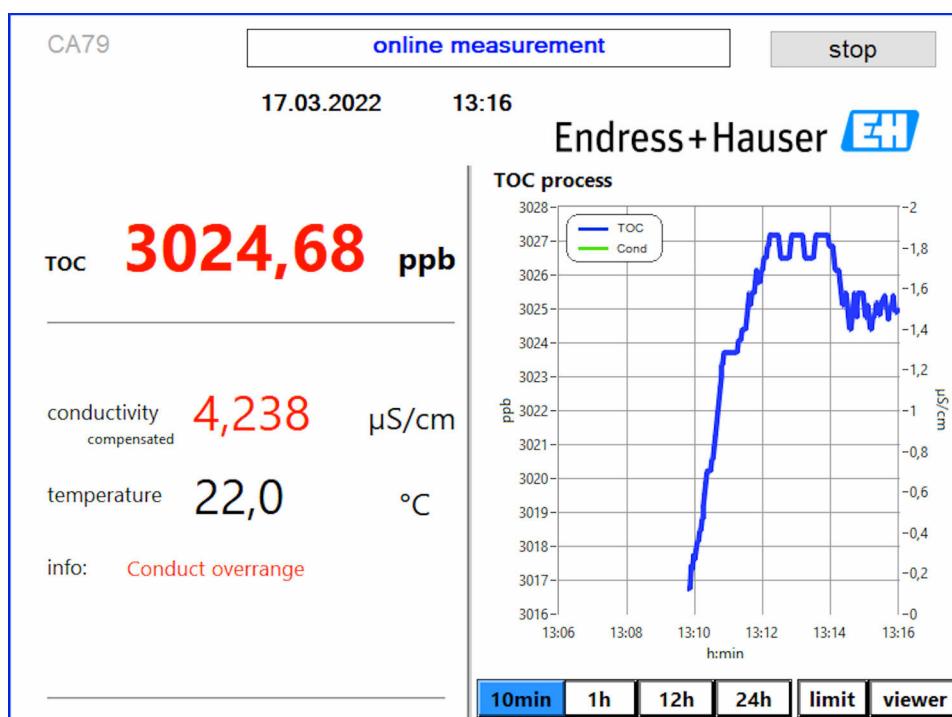


A0050164

■ 7 Ölçüm aralık limitinin üzerinde

Sistemde kaçak

Sistemde bir kaçak mevcutsa, analizör ölçümü otomatik olarak durdurur ve valf 1'i kapatır. Kaçak bulunup düzeltildiğinde, analizör ölçüme yeniden başlar (sadece **Continue after error** seçeneği **Settings** menüsü, **Options 2** sekmesinde etkinleştirilmişse → 29). Sistemdeki kaçak sensörü öncesinde komple kurulmalıdır. Kaçak sensörü sağ tarafta cihazın tabanına yerleştirilmiştir.

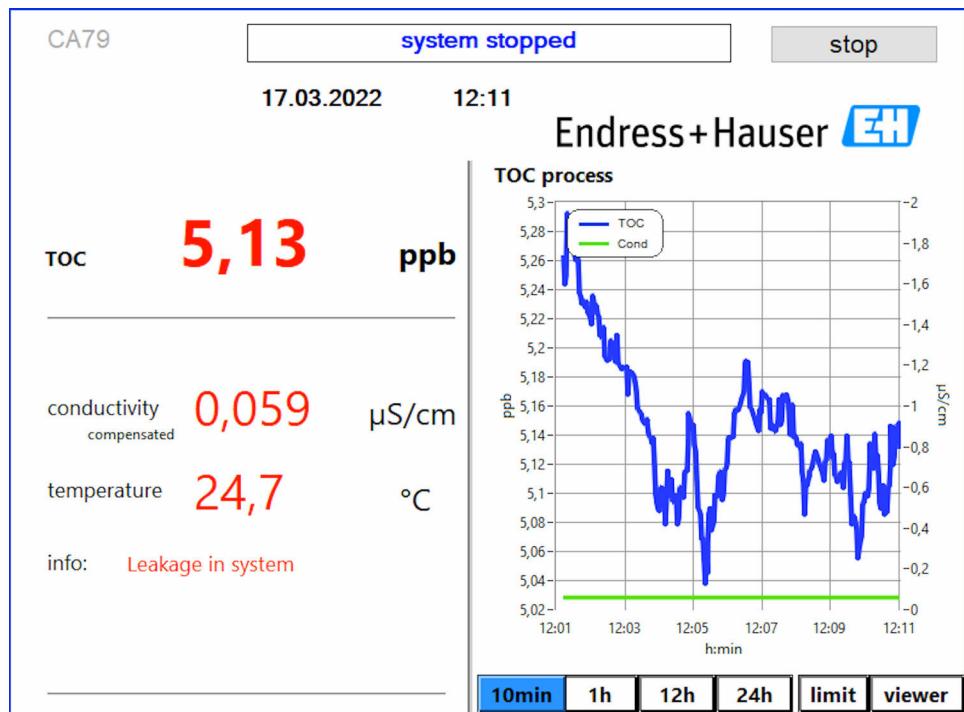

8 Sistemde kaçak

UV yoğunluğu çok düşük


Eğer UV lambanın yoğunluğu çok düşükse veya eğer UV lamba arızalıysa, analizör ölçümü otomatik olarak durdurur ve **UV lamp broken** mesajı görüntülenir. Bu durumda yeni bir UV reaktörü gereklidir.

UYARI

Kısa dalga UV radyasyona sahip radyasyon kaynağı!

Hatalı taşıma gözlerde ve ciltte hasara neden olabilir!

- ▶ Reaktör üzerinde çalışmadan önce her zaman cihazı işletmeden çıkarın ve güç beslemesi ile bağlantısını kesin!
- ▶ Reaktörü her zaman komple bir grup olarak değiştirin!
- ▶ Hasarlı reaktörleri işletmeden çıkarın!
- ▶ Bağımsız bileşenleri değiştirmek için reaktörü kesinlikle açmayın!
- ▶ Reaktör uçlarındaki yalıtımın sağlam kalmasını sağlayın (hasar görmemiş ısı ile büzüşen borular)!

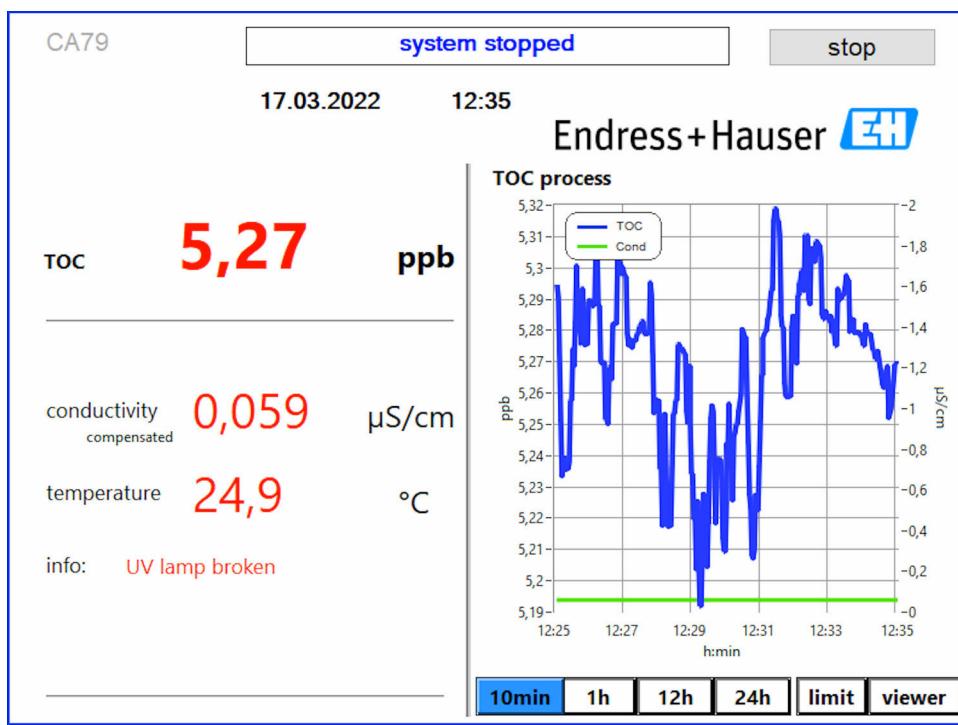

9 UV sensörü hata mesajı


Numune alma esnasında hata

Bu uyarı mesajı sadece **Algılama giriş basıncı numune** sipariş seçeneği ile görüntülenir. Bu mesaj görüntüleniyorsa, sensör kapalı bir giriş tespit etmiştir.

- Maddenin cihaza doğru şekilde beslendiğini kontrol edin.

8.3.2 Viewer

Bu menü ölçülen tüm TOC değerlerini görüntülemenize imkan tanıyacaktır. Veriler tarih tercihi yapılarak seçilir ve görüntülenir.

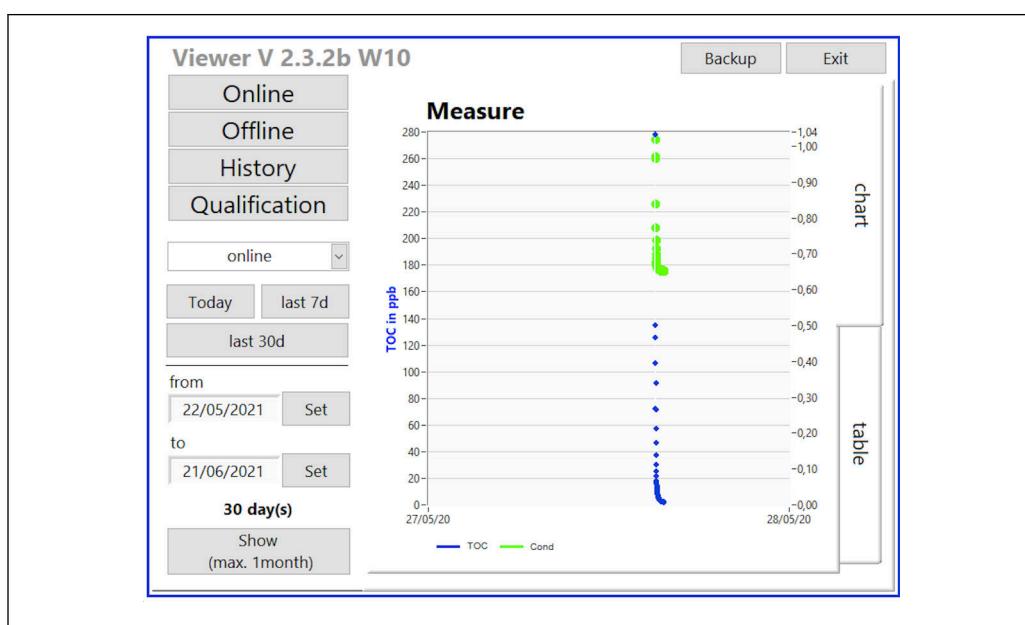

10 Görüntüleme menüsü

Verileri aşağıdaki şekilde seçebilirsiniz:

1. İstenen ön seçimi yapın (örn.: **Online**).
2. **Selected date** altından ilgilendiğiniz tarihi seçin.
3. **Selected data file** altından dosyayı seçin.
 - ↳ Seçilen bilgiler sağ taraftaki şemada gösterilir.
Kullanıcı bilgileri bir şema veya tablo olarak görüntüleme arasında seçim yapmak için **Chart** veya **Table** sekmlerini seçebilir.

Geçmiş dosyası bir günlük kaydı olarak görev yapan sürekli bir listedir ve oturum açma, hatalar ve kalibrasyon sonuçları/sistem uygunluk testi sonuçları ile ilgili tüm bilgileri içerir (başarılı/başarılı değil).

Ek olarak bu menü ile verileri dışa alabilir ve bastırabilirsiniz (WINDOWS® altında bir yazıcı kurulu ise).


8.3.3 Qualification

Bu menü ile aşağıdaki iki fonksiyonu seçebilirsiniz:

- Calibration
- SST (sistem uygunluk testi)

Seçim açılır menü ile yapılır.


Çok sayıda bildirim ve mesaj sizi bağımsız fonksiyonlar arasında yönlendirir.

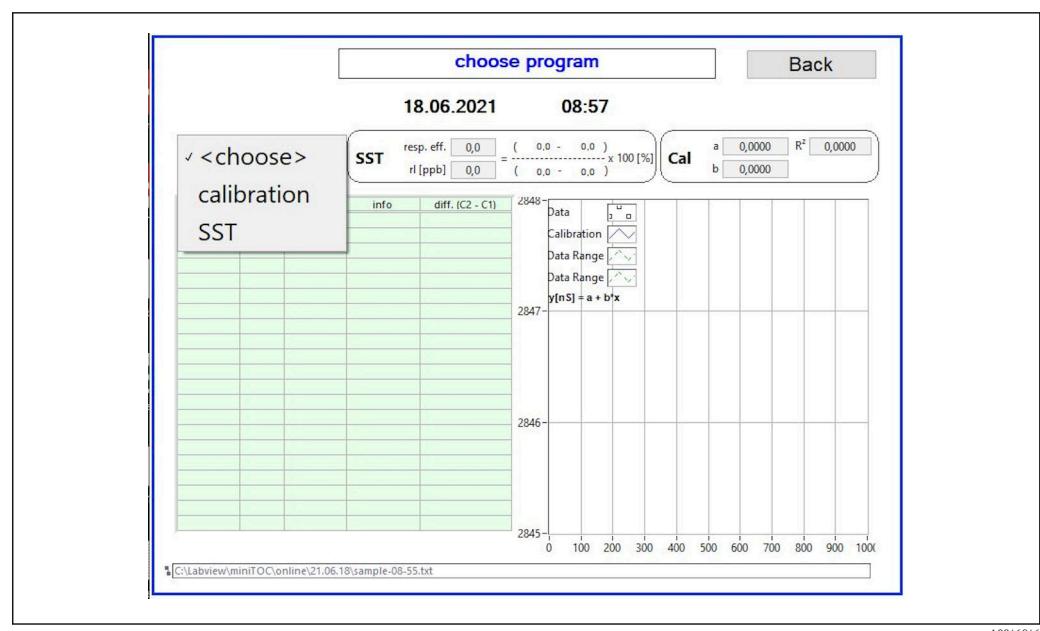

11 Qualification menüsü

Kalibrasyon ve ayar

Ölçüm kalibrasyonu gerçekleştirmek için durdurulmalıdır. Sistem kullanıcılarından solüsyonları beslemelerini ister. Solüsyon konsantrasyonu **Settings** → 29 menüsünde tanımlanır.

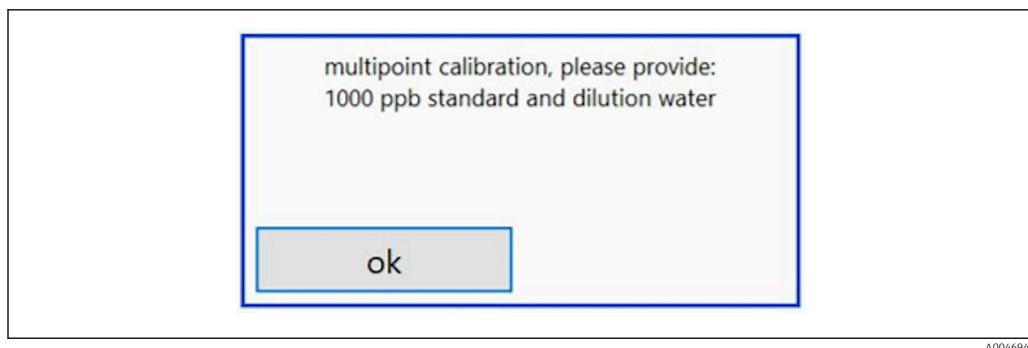


■ 12 "Provide solution" mesajı

i Sistem kalibrasyon başlamadan bir saat önce açılmalıdır, bu sayede uygun bir çalışma sıcaklığına ulaşılabilir. Kalibrasyon solüsyonları öncesinde en azından oda sıcaklığına ısıtılmalıdır. Eğer ölçümün başlangıcında 18 °C altında değerler görüntüleniyorsa, ölçüm solüsyonlar en azından oda sıcaklığına ulaşana kadar dardurulmalıdır. Kalibrasyon için başlangıç sıcaklığı olarak 20 ile 25 °C arası optimum sıcaklık aralığıdır.

"Sistem uygunluk testi, manuel" sipariş seçeneğine sahip bir cihazda kalibrasyon gerçekleştirilemesi

1. Gereken sakaroz konsantrasyonuna sahip bir kalibrasyon solüsyonu GİRİŞ 1'e bağlayın.
 - ↳ **Settings** → ■ 29 menüsünden gelen yapılandırılmış tüm parametreler ile kalibrasyon yarı otomatik olarak gerçekleştirilir. Sakaroz solüsyonunun tekrarlı ölçümlü sonrasında sistem durur ve operatörün su solüsyonunu GİRİŞ 1'e bağlanması isteyen bir açılır pencere gösterilir.
2. Su solüsyonunu GİRİŞ 1'e bağlayın.
3. **OK** tuşuna basarak açılır pencereyi kapatın.
 - ↳ Kalibrasyon sonuçlarını içeren bir açılır pencere görüntülenir.

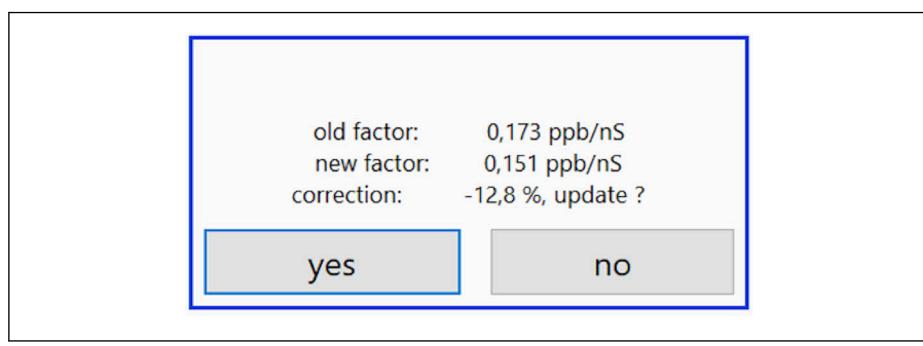

■ 13 Kalibrasyon faktörü açılır pencere


4. Sonucu onaylamak için **Yes** tuşuna basın.
 - ↳ Eğer kullanıcı yeni kalibrasyon faktörünü kullanmamayı seferse, eski kalibrasyon faktörü kullanılmaya devam edecektir. Kalibrasyon faktörü 0,11 - 0,21 ppb/nS aralığında olmalıdır. Herhangi bir sapma %2 altında olmalıdır.

"Sistem uygunluk testi, otomatik" sipariş seçeneğine sahip bir cihazda kalibrasyon gerçekleştirilemesi

1. Gereken sakaroz konsantrasyonuna sahip bir kalibrasyon solüsyonu GİRİŞ 2'ye bağlayın (siyah bağlantı).

2. Su solüsyonunu GİRİŞ 3'e bağlayın (mavi bağlantı).


↳ **Setting** → 29 menüsünden gelen yapılandırılmış tüm parametreler ile kalibrasyon otomatik olarak gerçekleştirilir.
Tüm ölçümler tekrar edildiğinde sistem durur.
Kalibrasyon sonuçlarını içeren bir açılır pencere görüntülenir.

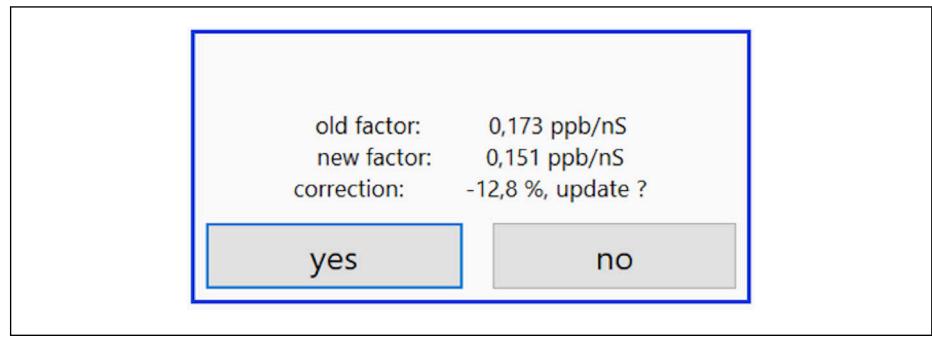

■ 14 Kalibrasyon faktörü açılır pencere

3. Sonucu onaylamak için Yes tuşuna basın.

↳ Eğer kullanıcı yeni kalibrasyon faktörünü kullanmamayı seçerse, eski kalibrasyon faktörü kullanılmaya devam edecektir.

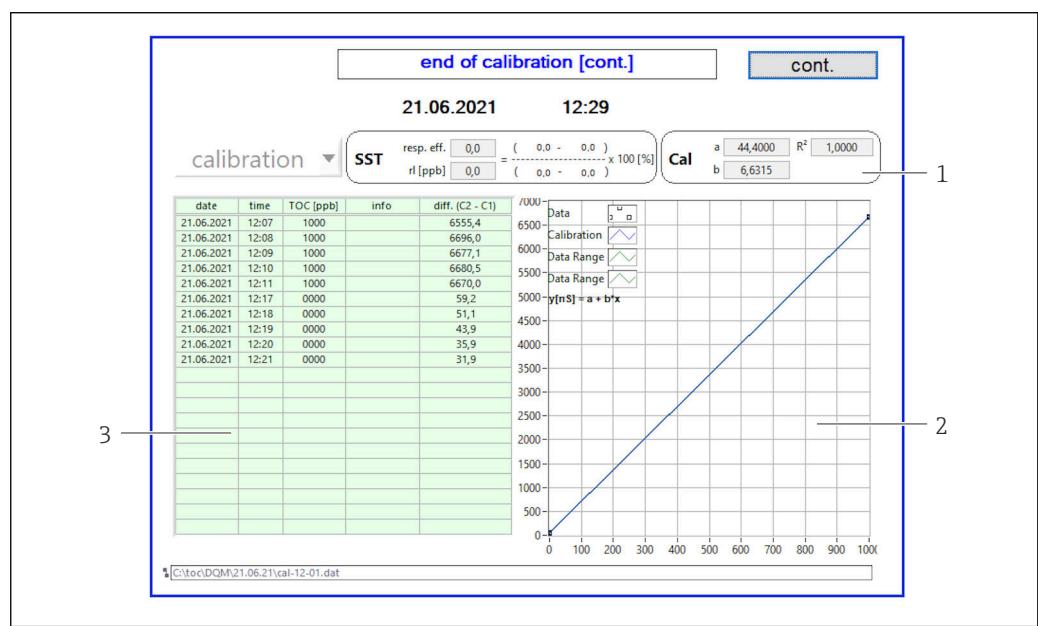


■ 15 Kalibrasyon eğrisi

- 1 Faktörler ve R^2
2 Kalibrasyon eğrisi
3 Ölçülen değerlerin listesi

i Ölçüm serilerinin üç kez tekrar edilmesi tavsiye edilir. Kullanılan standart hacimler 500 ml'dir ve çok sayıda ölçüm için yeterlidir. Ölçüm sonuçları bu ölçüm serileri içerisinde sabit ve birbirlerine yakın olmalıdır.

Sistem uygunluk testi (SST)

Ölçüm sistem uygunluk testi (SST) için durdurulmalıdır.

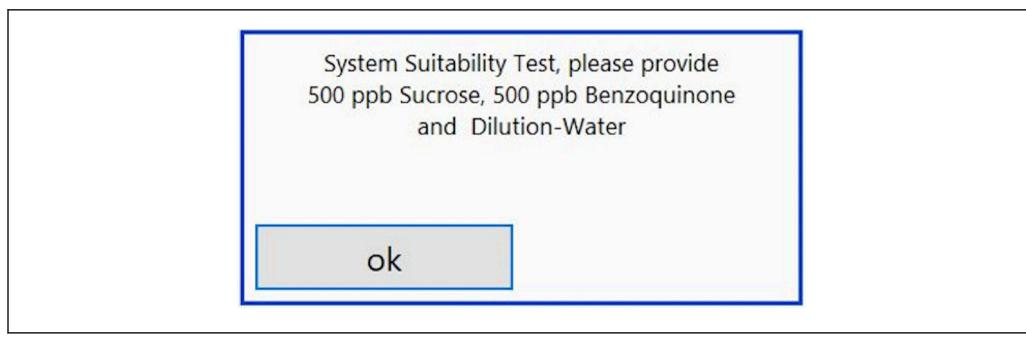

A0046957

■ 16 "SST solüsyonu besleyin" mesajı

i Sistem SST başlamadan bir saat önce açılmalıdır, bu sayede uygun bir çalışma sıcaklığına ulaşılabilir. SST solüsyonları öncesinde en azından oda sıcaklığına ısıtılmalıdır. Eğer ölçümün başlangıcında 18 °C altında değerler görüntüleniyorsa, ölçüm SST solüsyonları en azından oda sıcaklığına ulaşana kadar durdurulmalıdır. SST ölçümü için başlangıç sıcaklığı olarak 20 °C ile 25 °C arası optimum sıcaklık aralığıdır.

"**Sistem uygunluk testi, manuel**" sipariş seçeneğine sahip bir cihazda sistem uygunluk testi gerçekleştirilmesi

1. Gereken sakaroz konsantrasyonuna sahip bir SST solüsyonunu GİRİŞ 1'e bağlayın.
 - ↳ **Settings** → 29 menüsünden gelen yapılandırılmış tüm parametreler ile SST yarı otomatik olarak gerçekleştirilir.
Tekrarlı ölçüm sonrasında sistem durur ve operatörün benzokinon solüsyonunu GİRİŞ 1'e bağlanması isteyen bir açılır pencere gösterilir.
2. Benzokinon solüsyonunu GİRİŞ 1'e bağlayın.
3. **OK** tuşuna basarak açılır pencereyi kapatın.
 - ↳ İşlem su solüsyonu için tekrar edilmelidir.

"**Sistem uygunluk testi, otomatik**" sipariş seçeneğine sahip bir cihazda sistem uygunluk testi gerçekleştirilmesi

1. Gereken benzokinon solüsyonu konsantrasyonuna sahip bir SST solüsyonunu GİRİŞ 1'e bağlayın (kirmizi bağlantı).
2. Sakaroz solüsyonunu GİRİŞ 2'e bağlayın (siyah bağlantı).
3. Suyu GİRİŞ 3'e bağlayın (mavi bağlantı).
 - ↳ SST otomatik gerçekleştirilir.
Tüm ölçümler tekrar edildiğinde sistem durur.
SST sonucu görüntülenir ve kullanıcı tarafından onaylanması gereklidir.

4. Sonucu onaylamak için **Yes** tuşuna basın.

↳ Açılan pencere sistem uygunluk testinin sonucunu gösterir (başarılı/başarısız).



17 Testin sonucunun görüntülenmesi

SST testi başarısız olmuşsa (başarısız), kalibrasyon veya SST solüsyonları kontrol edilmeli ve SST tekrar edilmelidir.


i Ölçüm serilerinin üç kez tekrar edilmesi tavsiye edilir. Kullanılan standart hacimler 500 ml'dir ve çok sayıda ölçüm için yeterlidir. Ölçüm sonuçları bu ölçüm serileri içerisinde sabit ve birbirlerine yakın olmalıdır.

8.3.4 Sistem

Aşağıdaki bileşenlerde bir fonksiyon kontrolü bu menüden gerçekleştirilebilir:

- Pompanın başlatılması (normal < veya hızlı <<<)
- Valflerin değiştirilmesi
- UV reaktörünün açılması
- UV sensörü (UV lambasının yoğunluğunun tespiti)
- Sensör sinyallerinin kontrolü (C1/C2)
- Statik basıncın kontrolü (seçenek)²⁾
- Kaçak sensörü
- Çalışma saatinin sıfırlanması (pompa)
- Çalışma saatinin sıfırlanması (UV lamba)
- Analog çıkışların kontrolü
- Dijital çıkışların kontrolü

2) Kurulmuşsa ve Settings menüsünden etkinleştirilmişse, aksi durumda boş bir alan görüntülenir.

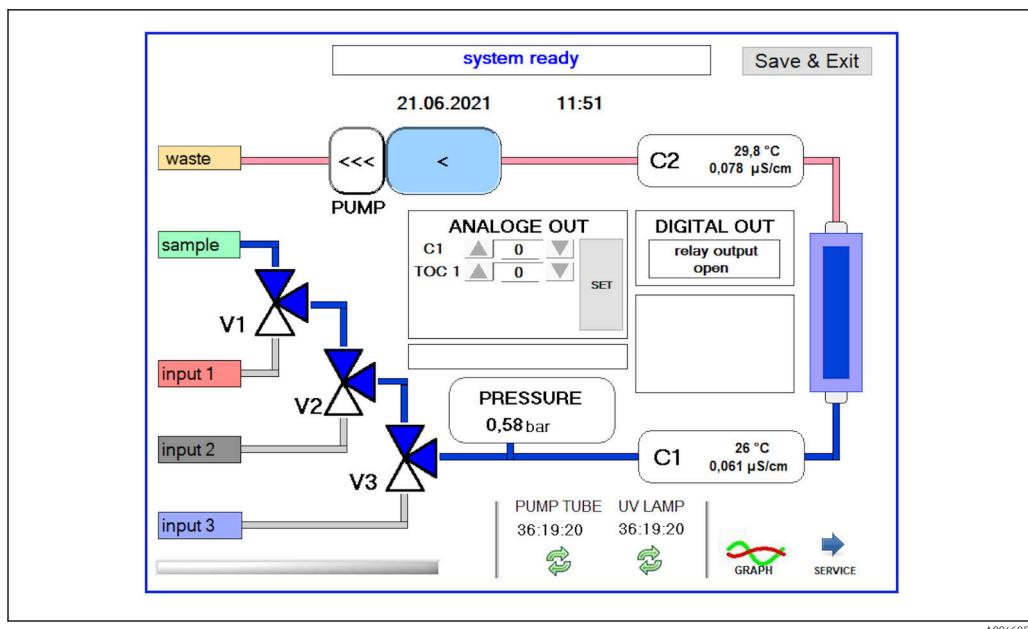

18 System menüsü

Pompa, valfler (V1, V2, V3) ve UV lambasının durumunu değiştirmek kullanıcının karşılık gelen sembole basması gereklidir.

Graph tuşuna bastığınızda aşağıdaki değerlere sahip bir şema görüntülenir → 27:


- Ölçülen değerler C1 ve C2
- C1 ve C2 arasındaki fark
- Sıcaklıklar T1 ve T2

Servis alanına erişim **Service** tuşu iledir. Bu alan şifre ile korunmaktadır (servis şifresi sadece servis teknisyenleri için).

Ana menüye değiştirin

1. **Save & Exit** tuşuna basın.
↳ Bir açılır pencere gösterilir.
2. Açılan penceredeki karşılık gelen tuşa basın.
3. Eğer pompa hortumu veya UV reaktörü değiştirilmişse:
Yes tuşuna basın.
↳ Çalışma saatı şimdilik sıfırlanır.

Bir menü kapatıldığında bir açılır pencere gösterilir. Analizörün tüm ayarları kaydetmesi birkaç saniye sürer.

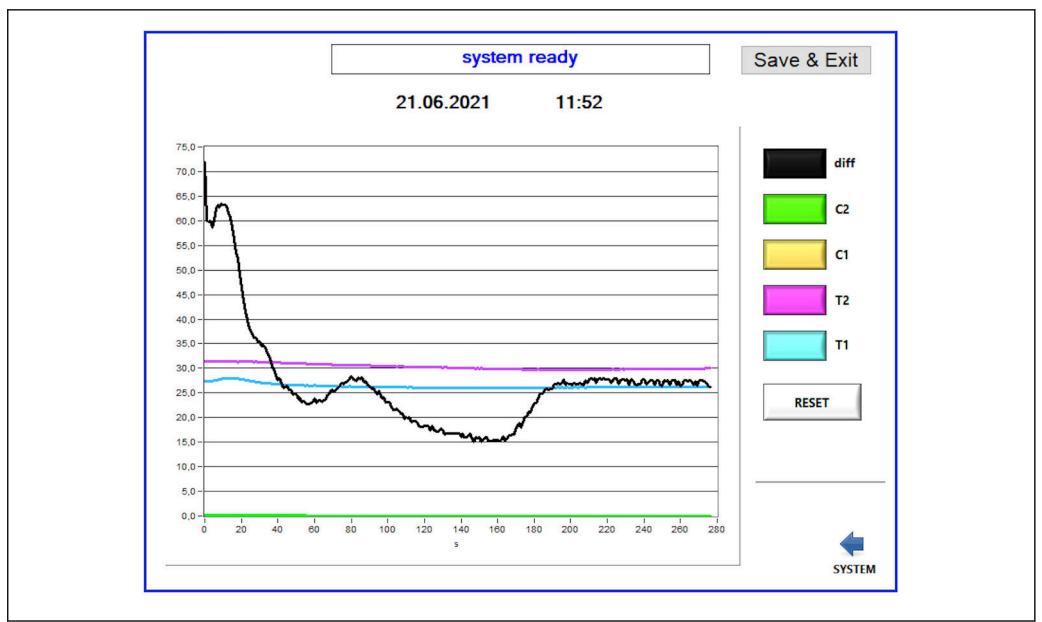

A0046960

19 Şema


i Her değerin şema eğrisi ayrı renkli tuşlar ile açılabilir veya kapatılabilir.
Reset tuşuna basılması tüm şema eğrilerini sıfırlar.

8.3.5 Settings

Cihaz parametrelerini bu menüden yapılandırabilirsiniz.

Lisans: Lisans seçeneklerini etkinleştirin. Sadece bayiler/satış ortakları için.

Servis: Yetkilendirilmiş personel için ek seçenekleri etkinleştirir (Servis 1-3).

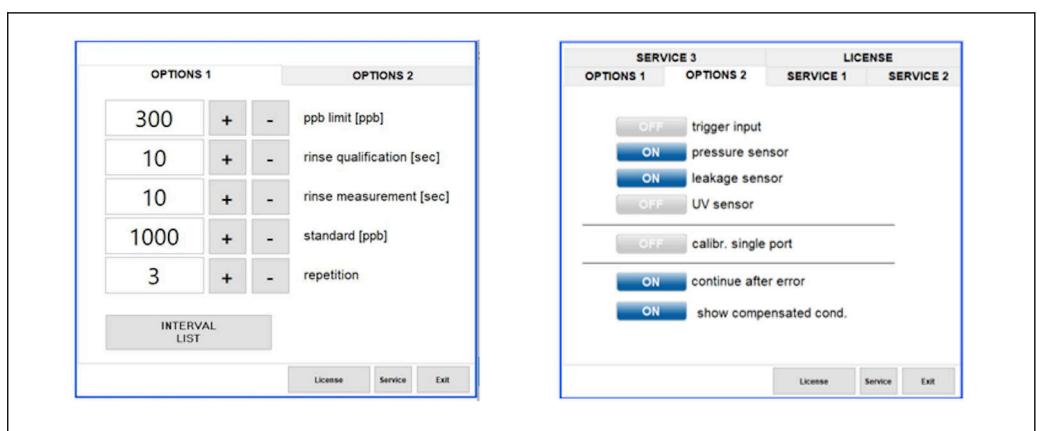

A0046963

20 Settings menüsü

Aşağıdaki ayarlar **Options 1** sekmesi ile değiştirilebilir:

Ayarlama	Açıklama
ppb limit (ppb)	Bu limit, tespit limit değeri için çıkış sinyalinde anahtarlama yapılan maksimum değeri gösterir. 4-20 mA çıkışların ölçeklendirilmesi için de maksimum değer burada gösterilir. Gösterilen değer bu nedenle 20 mA'ya karşılık gelir.
Rinse qualification (sec)	Bu değer bir SST veya kalibrasyon sırasında numunenin verildiği zamandaki durulama süresini (saniye olarak) gösterir (tavsiye edilen değer: 300 saniye).

Ayarlama	Açıklama
Rinse measurement (sec)	Bu değer bir ölçümün başlangıcında numunenin verildiği zamandaki durulama süresini (saniye olarak) gösterir (tavsiye edilen değer: 300 saniye).
Standard (ppb)	Bu değer bir kalibrasyon için varsayılan değer olarak kullanılacak TOC değerini tanımlamak için kullanılabilir (tavsiye edilen değer: 1000 ppb).
Repetition	Bu değer bir SST veya kalibrasyon sırasında gerçekleştirilecek olan tekrar sayısını gösterir (tavsiye edilen değer: 5 tekrar).
Interval List	Aralık modu düzenleyici bu tuş ile açılabılır (seçenek) →  33

Options 2 sekmesi ile aşağıdaki donanım parçalarının etkinleştirilmesi veya devreden çıkarılması mümkündür:

Ayarlama	Açıklama
Trigger input [ON/OFF]	Tetikleme girişi bu seçenek ile etkinleştirilir. Tetikleme girişi sistemin harici bir kontak ile başlatılmasını ve durdurulmasını sağlar. Kontak kapalı olduğu sürece analizör aktif kalır (sipariş seçeneği).
Pressure sensor	Analizör basınç sensörü ile seçilen opsiyonun basıncını izler. Bir vakum tespit edilirse, ölçüm durdurulur. Sonrasında yeterli bir numune basıncı tespit edilirse, ölçüme devam edilebilir (Continue after error fonksiyonu açık şekilde). Kullanılan limit değerler Service 1 sekmesinden yapılandırılabilir ("Algılama giriş basıncı numune" sipariş seçeneği için mevcuttur).
Leakage sensor	Bu seçenek ile kaçak sensörü açılır ve kapatılır.
UV sensor	Bu seçenek ile UV reaktörüne kurulan sensör açılır ve kapatılır.
Calibr. single port	Eğer standart bir analizör kullanılıyorsa veya SST ve kalibrasyon için ayrılmış olan girişler ayarlanan aralık modu nedeniyle kullanılabilir durumda değilse, sadece bir girişte yeterlilik için bu seçenek kullanılabilir (giriş 1). Sonrasında yeterlilik işleme sıra halindedir ve operatörün talebine göredir.
Continue after error	Ölçüm sırasında bir hata meydana gelirse, aktif ölçüm kesintiye uğrar. Hata düzeltildikten sonra (örn. ölçüm hattında vakum), ölçüm bu seçenek ile otomatik devam edebilir. Öncesinde cihaz yeniden durulanır.
Show compensated cond.	Ölçüm görünümündeki iletkenlik değeri sıcaklık ile telafi edilen değerlerden telafi edilmeyen değerlere değiştirilebilir.

Aşağıdaki parametreler **Service 1** sekmesinden ayarlanabilir:

Ayarlama	Açıklama
Temperature-Offset C1 [°C]	Bu değer sıcaklık sensörü C1 için ofseti gösterir.
Temperature-Offset C2 [°C]	Bu değer sıcaklık sensörü C2 için ofseti gösterir.
Temperature limit [°C]	Bu değer sıcaklık limitini gösterir; bu limitin aşılması durumunda bir uyarı verilir.
Fast pump speed	Bu değer durulamanın gerçekleştirildiği hızı gösterir.
Record pause (pulse x2 = delaytime	Bu değer günlük dosyasında ölçülen değerlerin kaydedilmesi için aralığı gösterir. 1 değeri 2 saniyeye karşılık gelir.
Max. limit conductivity [μS]	Bu değer iletkenlik limitini gösterir; bu limitin aşılması durumunda bir uyarı verilir.
Accuracy TOC value	Bu değer, TOC değerini görüntülemek için kullanılan ondalık sayısını gösterir.

Ayarlama	Açıklama
Underpressure limit [bar]	Bu değer basınç sensörü seçeneği için gereklidir. Bir hatanın görüntüleneceği giriş basıncını gösterir.
Underpressure restart [bar]	Bu değer basınç sensörü seçeneği için gereklidir. Vakum kapatıldıktan sonra ölçümün başlatılması gereken basıncı gösterir.

Aşağıdaki parametreler **Service 2** sekmesinden ayarlanabilir:


Ayarlama	Açıklama
Use analog output [ON / OFF]	Analog çıkış buradan açılıp kapatılabilir.
4 Channels(analog output)	Eğer sistemde bir Aralık seçeneği ve 4 analog çıkış mevcutsa, TOC 2 ve TOC 3 için analog çıkışlar ek bağlantı için buradan etkinleştirilebilir.
0-20 mA (analog output)	Eğer sistemde 0-20 mA seçeneği varsa, buradan yapılandırılmalıdır. Aksi takdirde TOC değerleri ölçeklendirilirken hatalı analog sinyaller oluşabilir. Sistem özellikleri ile ilgili bilgiler son test raporunda bulunur.
Idle analog output value (only with 0-20 mA option)	0-20 mA seçeneği ile, bir ölçüm gerçekleşmezse sistem herhangi bir değer uyarlayabilir. Namur NE43'e göre tavsiye edilen değer 3,7 mA'dır.
Hold the last analog output value	Eğer değerler aralık modunda ölçülyorsa bu seçenek, herhangi bir ölçüm aktif olmasa dahi ölçüm girdileri değiştiğinde analog çıkış sinyallerinin her zaman ölçülen son değerde kalmasını gerektiğini tanımlamak amacıyla kullanılabilir.

Aşağıdaki parametreler **Service 3** sekmesinden ayarlanabilir:

Ayarlama	Açıklama
UV-Limit	Bu değer, UV lambasının çalışma süresinin bu limiti geçmesi halinde bir uyarı verilmeden önce geçmesi gereken maksimum süreyi gösterir.
Pump limit	Bu değer, pompa hortumunun çalışma süresinin bu limiti geçmesi halinde bir uyarı verilmeden önce geçmesi gereken maksimum süreyi gösterir.
Valves	Bu değer analizörün sahip olduğu valf sayısını gösterir. Bu değer buradan doğru şekilde ayarlanmalıdır. Aksi takdirde, kalibrasyon ve aralık modunda girişlerin seçimi sırasında arızalar meydana gelebilir.
Universal digital output	Eğer analizörde universal bir dijital çıkış bulunuyorsa, bu seçenek çıkışın anahtarlama yapmasına neden olabilecek sistem olaylarını yapılandırmak için kullanılabilir. Hata - Çıkış ölçüm sırasında kapanır ve bekleme sırasında veya bir hata olduğunda açılır Limit - TOC veya iletkenlik için limit değer aşıldığında çıktı deejisir Hata+limit - Çıkış ölçüm sırasında kapanır ve bekleme sırasında veya bir hata olduğunda ya da TOC veya iletkenlik limit değeri aşıldığında açılır.
Automatic report	Günün sonunda (gece yarısı), sistemde standart yazıcı olarak kurulmuş olan yazıcıdan otomatik bir çıktı alır.

8.3.6 Otomatik başlatma

Sistemin bir ölçüm sırasında kesintiye uğraması durumunda (örneğin bir elektrik kesintisi nedeniyle), sistem yeniden başlatıldığında **Autostart** penceresi gösterilir. Kullanıcının **Deactivate autostart** tuşu ile otomatik başlatmayı durdurması halinde, kesintiye uğrayan ölçüm yeniden başlatılır.

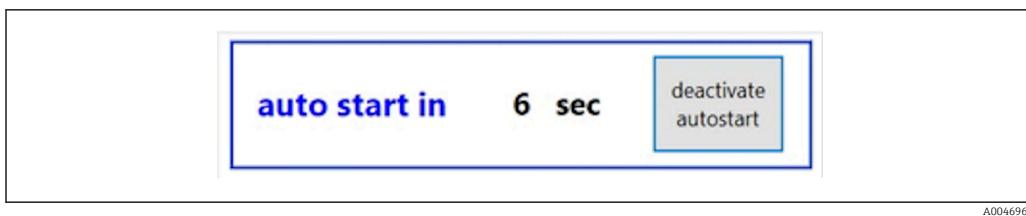

■ 21 Autostart penceresi


Otomatik başlatmanın kapatılması/etkinleştirilmesi

1. **Settings** menüsünü açın.
2. **Options 2** sekmesini seçin.
3. **Continue after error** ayarı ile otomatik başlatmayı kapatın/etkinleştirin → ■ 29.

i Tetikleme ile birlikte sistem sadece karşılık gelen giriş sinyalinin de mevcut olması halinde ölçüyü başlatır.

8.3.7 Kapatma prosedürü

1. Ana menüyü açma.

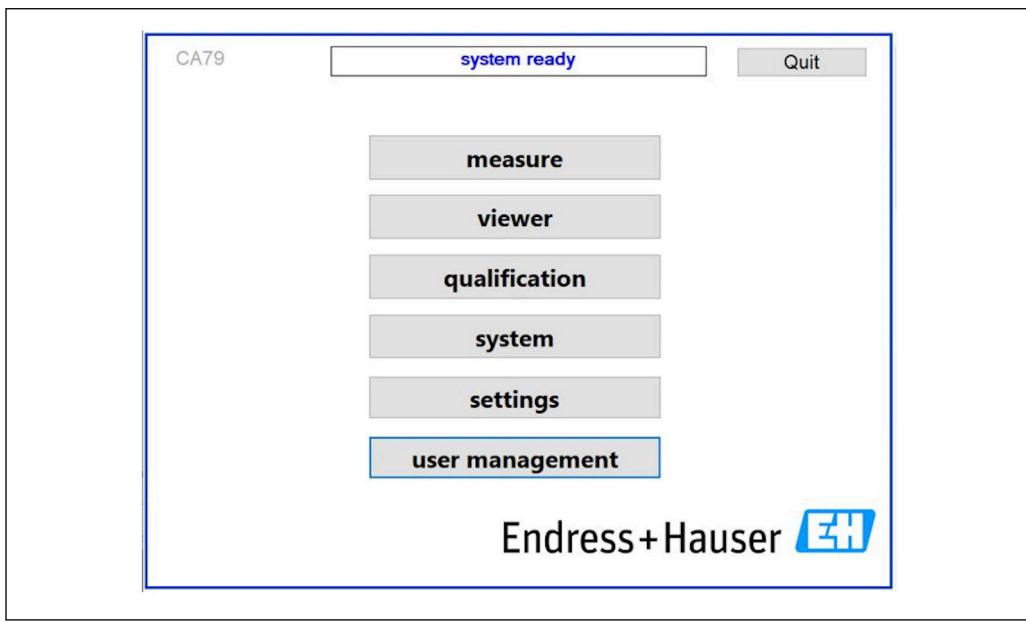

■ 22 Ana menü

2. **Quit** tuşuna basın.
 - ↳ Yetkilendirme için bir pencere görüntülenir. Kapatma prosedürü için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gereklidir (sadece servis ID ile mümkündür).
3. Kullanıcı tanımlı şifreyi girin.
4. Oturum açma penceresinde OK üzerine basın.

i Bağlı olan bir klavyede Enter karakterine basılması veya farenin bir sonraki satıra getirilmesi bir oturum açma hatasına sebep olacaktır.

Çok sayıda sayfa kapatıldığında bir açılır pencere gösterilir. Tüm verilerin kaydedilmesini sağlamak için yak. 30 saniye bekleyin.

Yazılım programını ve Windows'u kapatığınızda cihazı şebeke şalterinden kapatabilirsiniz.

8.3.8 Ölçülen değerlerin kaydedilmesi

Ölçülen veriler düzenli aralıklar yedeklenmelidir. Yedekleme için en az 4 girişe sahip olan bir USB ağı, bir fare, bir klavye ve en az 8 GB alana sahip bir USB bellek gereklidir.


1. Sistemi tamamen kapatır .
↳ Ana menü görüntülenir.
2. **Viewer** menüsünü açın.
3. Online veriyi seçmek için **Online** tuşuna basın.
4. **Table** sekmesini seçin.
5. **Export csv** tuşuna basın.
↳ Dosya yöneticisi açılır.
6. Kaydedilecek olan klasörü seçin ve bunu bağlı olan USB belleğe kaydedin.

8.3.9 Mevcut seçenekler

Aralık modu düzenleyici (sipariş seçeneği)

Numune, giriş 2 ve giriş 3 arasında 8 adede kadar port giriş sırası bu düzenleyici ile oluşturulabilir.

Aralık düzenleyici **Interval list** tuşu ile açılabilir (**Settings** menüsü -> **Options 1** sekmesi).

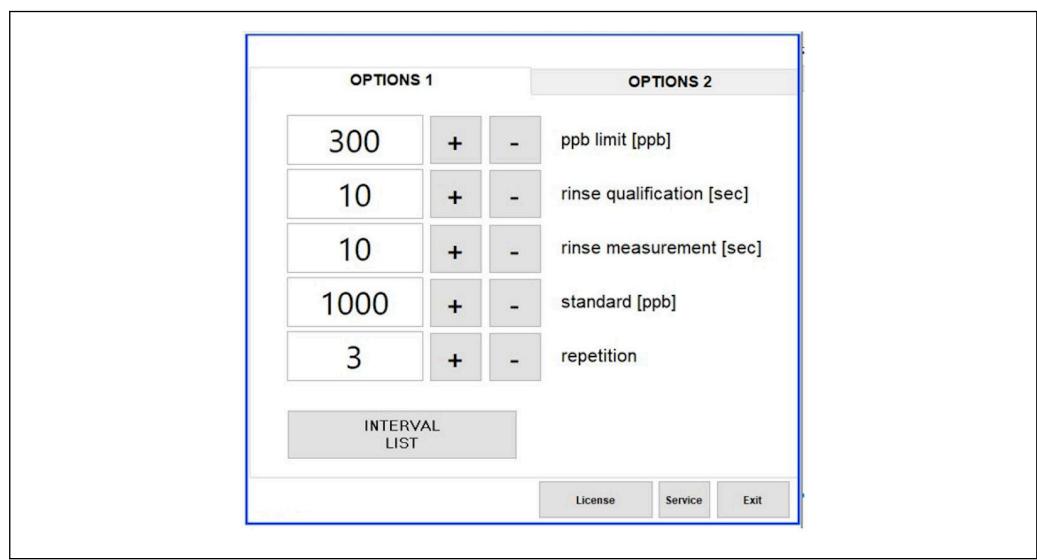

A0046973

23 Settings menüsü, Options 1 sekmesi

i Eğer **Calibr. single port** seçeneği seçilirse, kabloların ayrılmamasına gerek kalmadan giriş 1 kalibrasyon veya SST için kullanılabilir.

1. Aralık düzenleyiciyi açmak için **Interval list** tuşuna basın.
↳ Aralık sırası **Interval list** tuşuna bastığınızda düzenlenlenebilir.

	Port	Time		
STEP 1	Sample	60	+	-
STEP 2	NA	1	+	-
STEP 3	NA	1	+	-
STEP 4	NA	1	+	-
STEP 5	NA	1	+	-
STEP 6	NA	1	+	-
STEP 7	NA	1	+	-
STEP 8	NA	1	+	-

OK

A0046974

 24 Düzenleyici

i Süre, durulama süresi dakika olacak şekilde ölçüm süresidir.

Eğer bir adımda bir giriş için **NA** seçilmişse veya liste tamamen doluya, sıra ölçüm modunda yeniden adım 1'den başlar ve bu sayede numuneler sürekli izlenebilir.


Her adım sonrasında sistem yeni bir veri dosyası oluşturur. Bu bir aralığa sahip olmayan sürekli moda göre farklılık gösterir, sürekli modda ölçüm prosesinin kesintiye uğramaması halinde en geç 24 saat sonrasında yeni bir dosya oluşturulur.

Birinci satır bir numune ve süreye sahip olmalıdır.


CFR 21 Kısım 11'e uyarlanmış yazılım

CFR 21 Kısım 11 Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA)'nın elektronik kayıtlar ve elektronik imzalar (ERES) ile ilgili kurallarını içeren Federal Düzenleme Kanunu Bölüm 21'in bir parçasıdır. Genel olarak bilinen şekilde Kısım 11, elektronik kayıtların ve elektronik imzaların basılı kayıtlara eşdeğer güvenilirliğe sahip olduğu değerlendirilen kriterleri belirler (Başlık 21 CFR Bölüm 11 Kısım 11.1 (a)).

Kısım 11 için analizör yazılımını kişiselleştirmek amacıyla yeni bir kullanıcı yönetimi fonksiyonu sunulmuştur. CRF 21 Bölüm 11'i baz alan yazılım programında **User management** menüsü ana menü olarak görüntülenir.

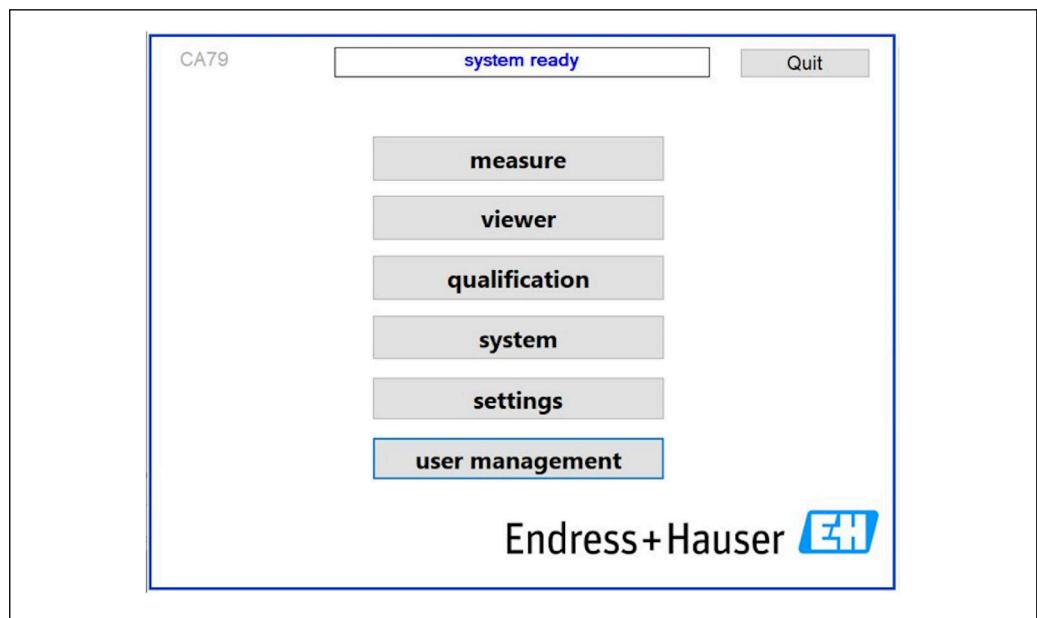

25 Kullanıcı yönetimine sahip ana menü

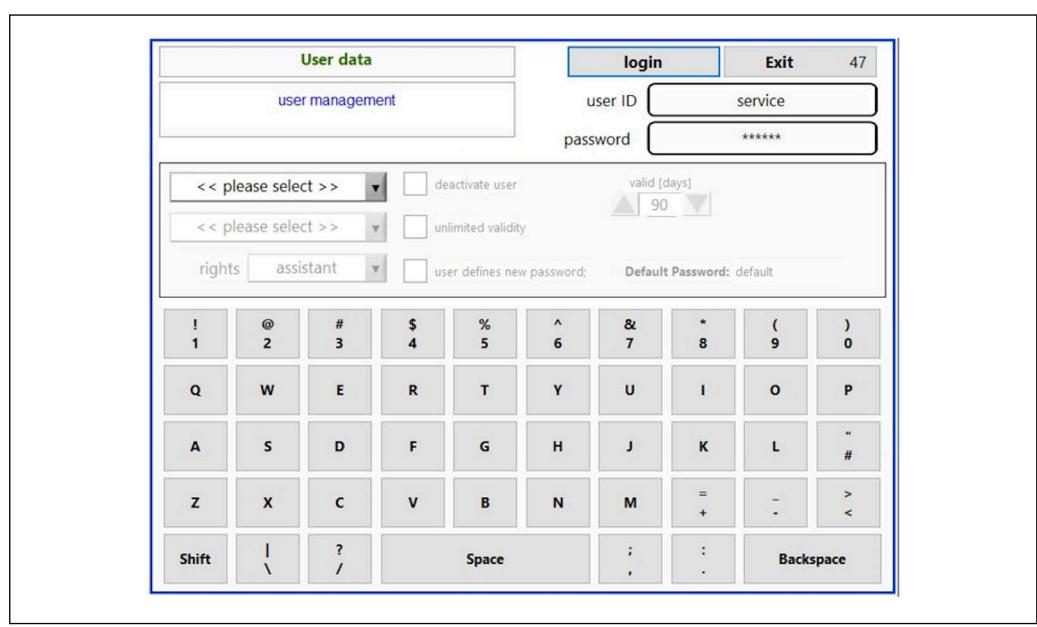


26 User management menüsü

Oturum açmak için bir yönetici hesabı ve bir şifre gereklidir.

İlk devreye alma sırasında **Kurulum** hesabına sahip menü açılır. Menü açıldığında kullanıcının varsayılan şifreyi yeni bir şifre ile değiştirmesi istenir.


1. Kullanıcı ID girin **install**.
2. **Login** tuşuna basın.
3. Şifreyi girin **default**.
4. **Login** tuşuna basın.
↳ Kullanıcının yeni şifreyi girmesi istenir.
5. Yeni bir şifre girin ve onaylayın.
6. Açılan menüden yeni bir kullanıcının eklenip eklenmeyeceğini (**Add user**) veya kullanıcı özelliklerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini (**User properties**) seçin.

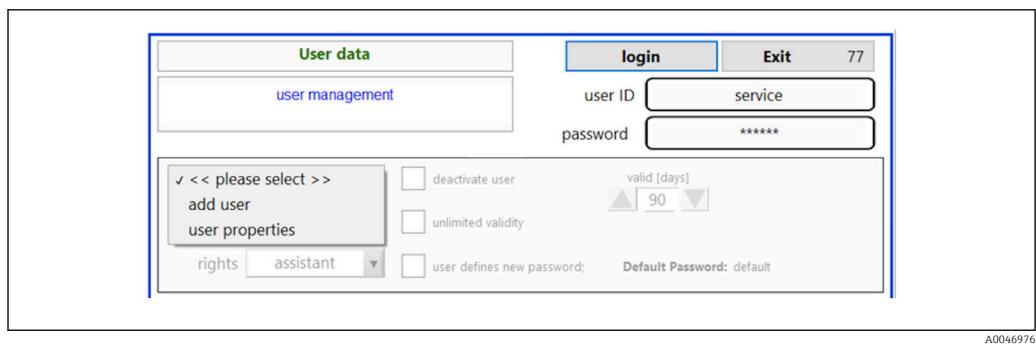


■ 27 Açılan menü

Yeni bir kullanıcı eklenmesi


1. Çekilen menüden **Add user** girişini seçin.
↳ Bir kullanıcı sadece aynı yetkilendirme seviyesine sahip kullanıcılar oluşturabilir (örn. bir asistan sadece bir asistan oluşturabilir).
2. **User ID** alanına kullanıcı ID girin.

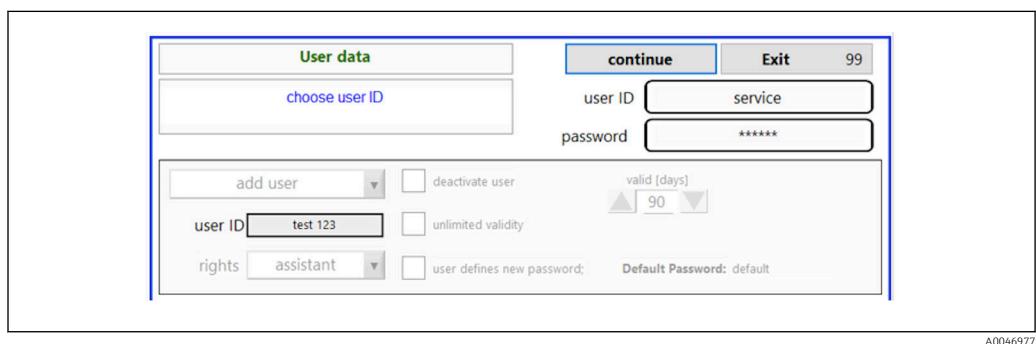

3. **Rights** açılır listesinden karşılık gelen hakları seçin.

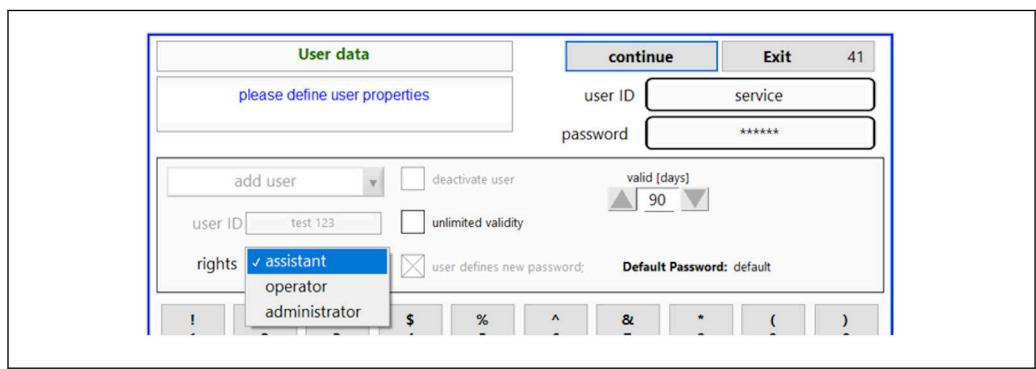


4. Kullanıcının devreden çıkarılması gerektiğini, şifrenin ne kadar geçerli olacağını ve yeni bir şifre tanımlanması gerekip gerekmediğini tanımlayın.
↳ Varsayılan şifre her zaman varsayılanaya ayarlanmıştır.
5. **Continue** tuşuna basın.
↳ Sonraki ekran bir mesaj ile açılır. Burada, kullanıcı, kullanıcı verilerinin güncellenmesi gerekip gerekmediğini onaylar.

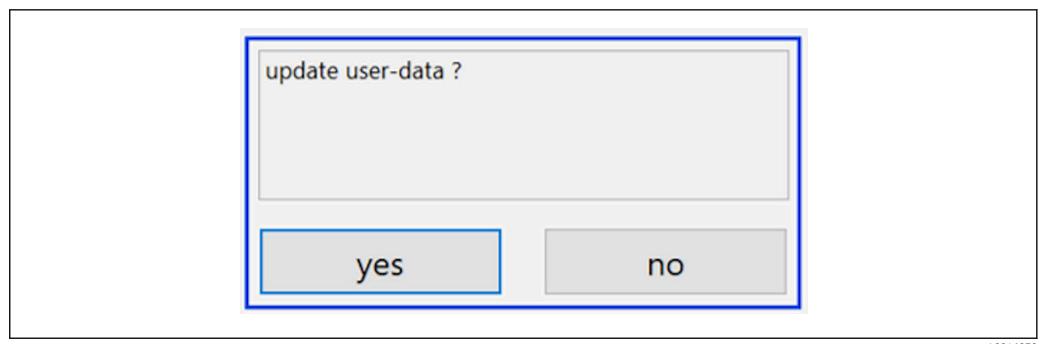


6. Yes tuşuna basın.

Kullanıcı özelliklerinin değiştirilmesi

1. Ana menüdeki **User management** tuşuna basın.
2. Açılan listeden özelliklerini değiştirecek olan kullanıcıyı seçin.

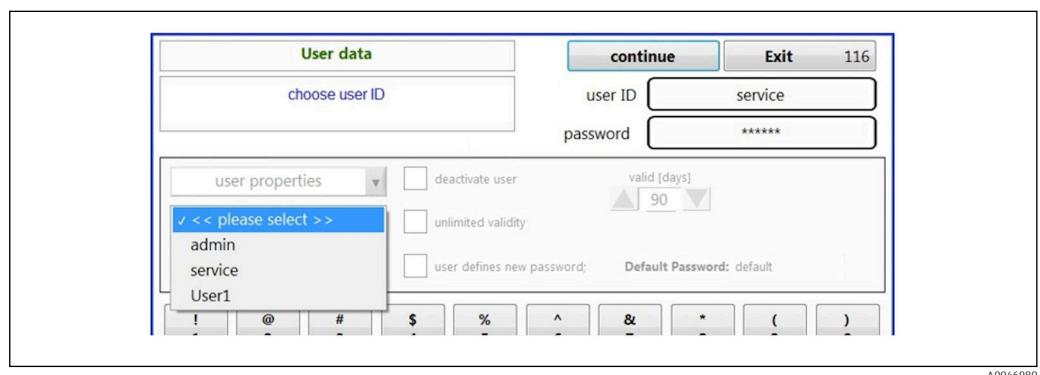

3. İstenen şekilde kullanıcı özelliklerini değiştirin (haklar (1), devreden çıkışma (2), şifre geçerliliği (3) veya şifre sıfırlama (4)).

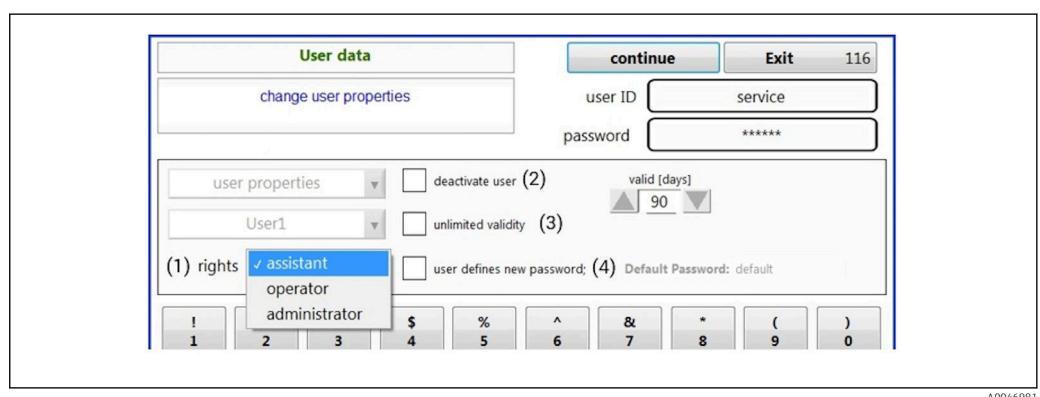

- Değişiklikleri onaylamak için **Yes** tuşuna basın.




A0046982

Yeni bir şifre tanımlanması

Kullanıcı varsayılan erişim hakları ile ilk kez oturum açar. Oturum açma sonrasında, kullanıcının yeni şifre belirlemesi istenir. **Rights** menüsünde, yönetici temel ayarlardan biri olarak ID ve şifre için minimum karakter sayısını belirleyebilir → 39.


1. Kullanıcı ID girin **install**.
2. **Login** tuşuna basın.
3. Şifreyi girin **default**.
4. **Login** tuşuna basın.
↳ Kullanıcının yeni şifreyi girmesi istenir.
5. **Password** alanına yeni şifreyi girin.

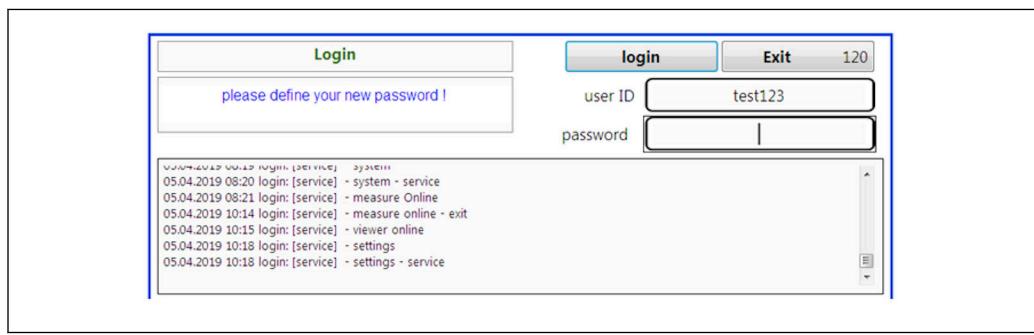

A0046983

28 Yeni bir şifre tanımlanması


6. **Password** alanına yeni şifreyi yeniden girin.

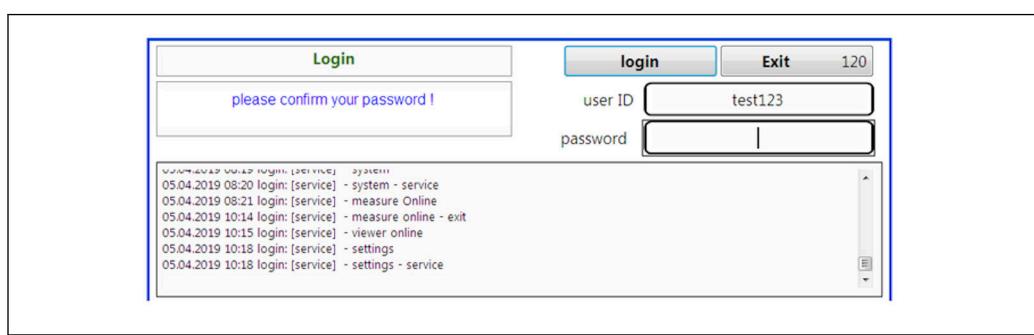

A0046984

29 Şifrenin onaylanması

7. Şifreyi onaylamak için tuşuna basın.

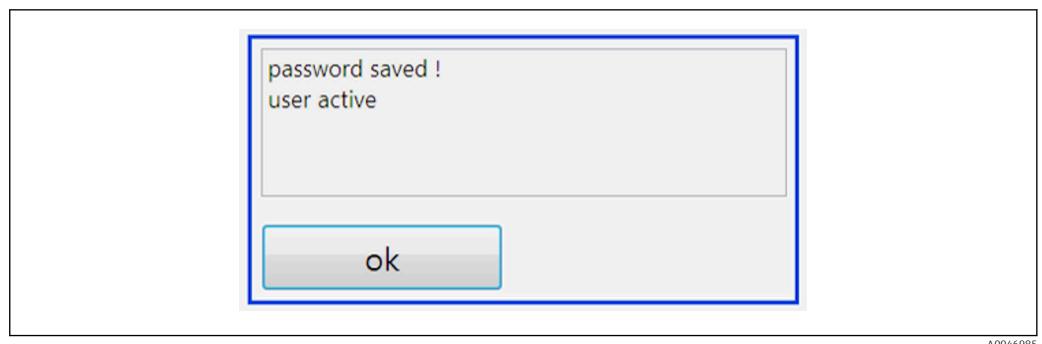


A0046985

Hakların yönetimi

Kullanıcı gruplarına farklı haklar vermek ve haklar yönetimi altından ek temel ayarlar oluşturmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

1. **Settings** menüsünü açın.
2. **Rights management** tuşuna basın.
 - ↳ Hak yönetimi fonksiyonundan hakların tümünü değiştirebilmek için kullanıcı bir yönetici olarak oturum açmalıdır (operatörler sadece asistanlar için hakları değiştirebilirler).

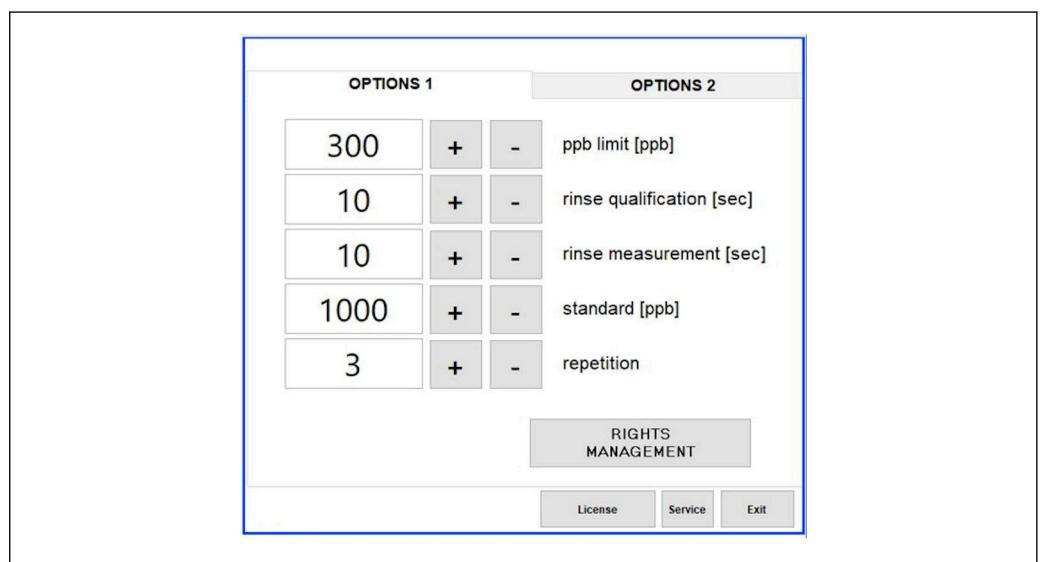


A0046986

30 Settings menüsü, Options 1 sekmesi

Farklı hakların atanmasına ek olarak yönetici bazı temel ayarları da oluşturabilir:

- ID için minimum karakter sayısı (**min. characters ID**)
- Şifre için minimum karakter sayısı (**min. characters passw.**)
- Şifrenin geçerliliği
- Maksimum şifre denemesi sayısı (**max. password tries**)
- Saniye cinsinden oturum kapatma süresi

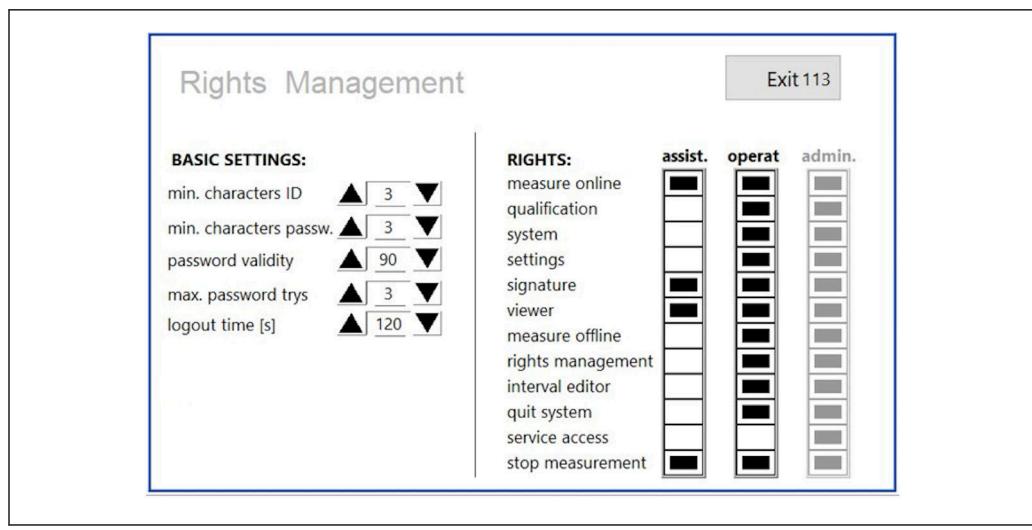

A0046987

31 Rights management menüsü

Kullanıcı ve kullanıcıya atanın haklar analizördeki her işlemin kaydedilmesine ve izlenmesine imkan tanır. Bu veriler denetim izinden izlenebilir ve değiştirilemez veya kurcalanamaz. Kullanıcı her ölçüm veya parametre değişimi için iletişim kutusuna bir yorum girmelidir.

A0046988

32 Yorum fonksiyonu

Hatalı şifre veya yetkisiz kullanıcı

Oturum açma sırasında hatalı bir şifre girilirse aşağıdaki pencere gösterilir:



A0046989

■ 33 "wrong password" gösteren ekran

Oturum açma için kalan deneme sayısı bu pencerede gösterilir. Şifrenin üç kez hatalı girilmesi durumunda kullanıcı kilitlenir. Yönetici şifreyi sıfırlayabilir → ■ 37.


Yetkisiz bir kişi tarafından yapılan giriş aşağıdaki şekilde gösterilir:



A0046990

■ 34 "unauthorized user" gösteren ekran

Eğer yeterli erişim hakkına sahip olmayan bir kullanıcı oturum açmayı denerse aşağıdaki mesaj görüntülenir.

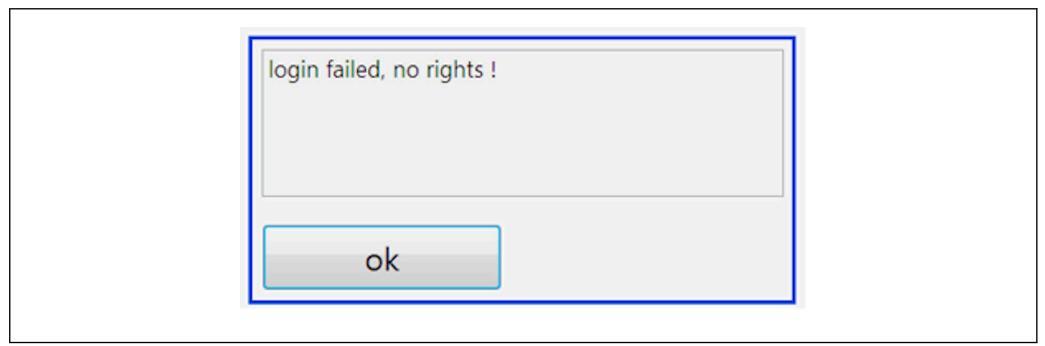

A0046991


■ 35 "no rights" gösteren ekran

9 Çalışma

Ölçülen değerlerin okunması

Analizörün ölçüm ekranında aşağıdaki ölçülen değerler görüntülenir:

- TOC, ppb
- İletkenlik (bir seçenek olarak ekran gizlenebilir)
- Sıcaklık
- Yük eğrisi: TOC, iletkenlik

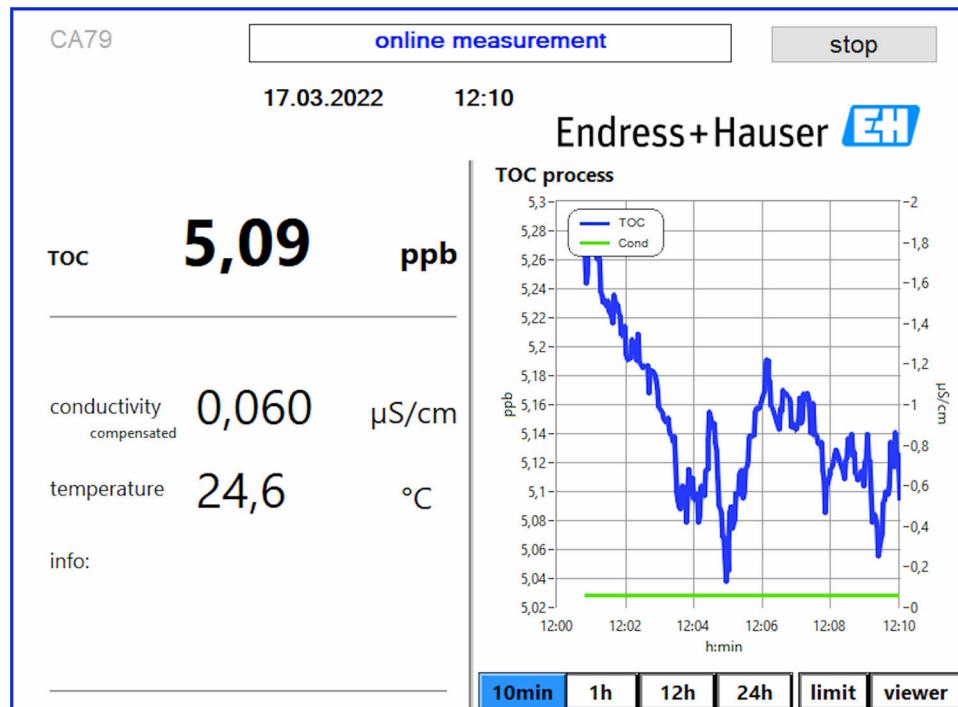

A0050163

10 Hata teşhis ve arıza giderme

10.1 Hortum sisteminin değiştirilmesi

i Hortum bağlantı parçalarının doğru oturduğundan emin olmak için hortum uçlarının deform olmasını engellemek amacıyla düz bir kesim yüzeyi elde etmek için özel bir hortum makası ile kesilmesi önerilir.

Bir hortum sisteminin değiştirilmesi prosedürü aşağıda açıklanmıştır. Kullanılan hortumlar FEP malzemeden yapılmıştır ve bu nedenle saf ve ultra saf su aralığında olan sıvı maddeden etkilenir sistemdeki TOCa önemli derecede katkı yapmaz.


Bu hortum sistemlerinin, sisteme önemli miktarda kir girmesi halinde veya sistemin uygun olmayan maddeler ile kullanılması durumunda değiştirilmesi gerekebilir. Ek olarak, sistemde kaçaklar oluşması halinde hortum sisteminin bazı kısımlarının değiştirilmesi de (hortum alt kısımları) değiştirilmesi gerekir. Bu tipte kaçaklarorneğin uygun olmayan proses basıncı kullanılan durumlarda meydana gelebilir.

Kromatografide kullanılan UNF bağlantı parçaları da burada bağlantı parçası olarak kullanılabilir. Bu bağlantı parçaları uygun bir yüksük ve PEEK'den yapılmış uygun bir vidalı konnektörden (aşağıda adı soket olarak geçmektedir).

Yüksükler kurulum esnasında kalıcı mekanik deformasyona maruz kalır ve yeni bir muhafaza ile değiştirilmeleri gerekir. Hasarlı değilse soket yeniden kullanılabilir.

Bir hortum alt kısmının değiştirilmesi için aşağıdaki malzemeler gereklidir:

- 2 x yüksük (1/8" hortum için uygun, sarı renk kodu)
- 2 x 1/4-28 UNF bağlantı parçaları
- 1 x 1/8" FEP hortum, yeterli uzunlukta
- Kapiler borular için hortum makası

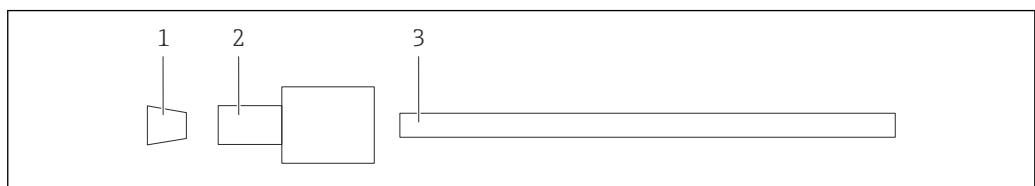


A0047336

36 Hortum alt kısmı

- 1 Yüksük
- 2 Vidalı bağlantı (soket)
- 3 Hortum


1. Hortum alt kısmı üzerindeki bağlantı parçalarını gevsetmek amacıyla saatin tersi yönde döndürün.
2. Hortumun ilgili kısmını muhafazadan çıkarın ve hortumun toplam uzunluğunu belirleyin.
↳ Uzunluk yüksükten yüksüğe ölçülür.
3. Doğru uzunluk belirlendikten sonra yeni hortumu istenen uzunlukta kesin ve hortum makası ile her iki ucu da dik açıda düz bir şekilde kesin.
4. Birinci yüksüğü hortumun bir ucuna takın ve soketi hortum üzerinden kaydırın.

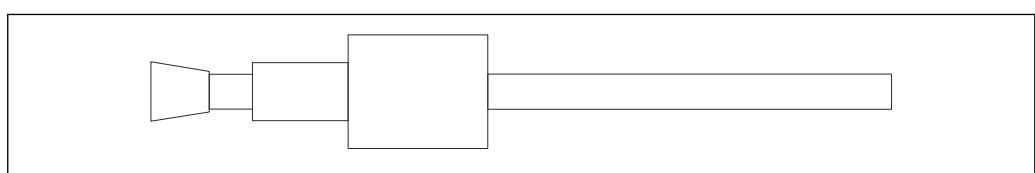

A0047337

37 Yüksüğün ve hortumun yerine takılması


5. Sonrasında bağlantı parçasını (yukarıda açıklanan şekilde hazırlanmış olan) kapline (1) takın.

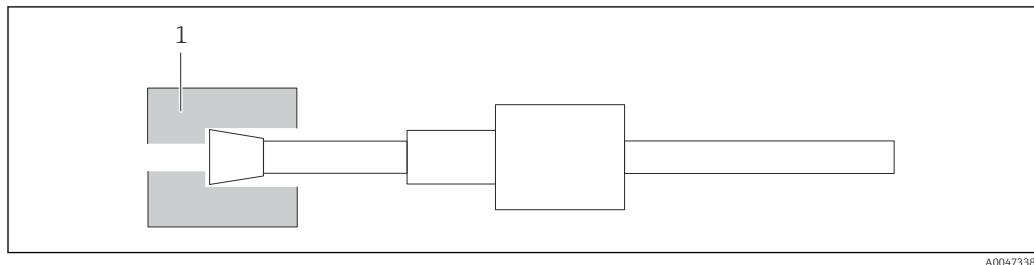

A0047338

■ 38 Kaplin

6. Soketi kapline vidalayın ve elle sıkıştırın

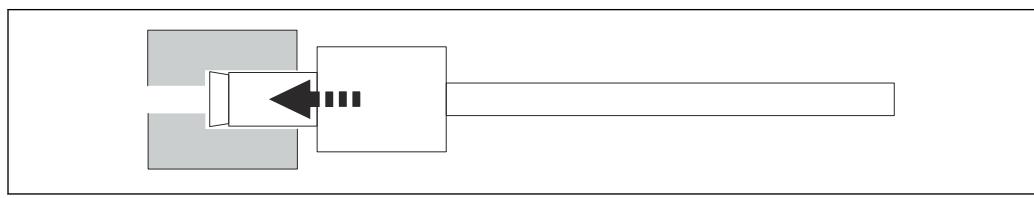

A0047339

■ 39 Soketin vidalanması

10.2 Cihaz yazılımı geçmişi

Tarih	Versiyon	Değişiklikler	Önceki versiyon ile uyumluluk
01.05.2022	1.217b	Endress+Hauser semoblik işaret güncellendi	Evet
22.11.2021	1.209	Cihazın açılması ile cihaz yazılımı	Evet

11 Bakım

Hatalı bakım hatalı çalışmaya neden olabilir ve bir güvenlik tehlikesi oluşturur!

- ▶ Bu bölümde bahsedilen tüm bakım işlemleri yetkin bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▶ Her bakım çalışması öncesinde: Uzman personel prosesin tamamına hakim ve ilgili tüm adımları mükemmel bir şekilde anlamış olmalıdır.

11.1 Bakım programı

Düzenli bakım analizörün etkin bir şekilde çalışmasını garanti eder.

Aralık	Bakım çalışması
Her kalibrasyon öncesinde	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kalibrasyon solüsyonunu değiştirin
Her 6 ayda bir	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pompa hortumunu değiştirin
Her 6 ayda bir	<ul style="list-style-type: none"> ▶ UV reaktörünü değiştirin
Her 24 - 36 ayda bir	<ul style="list-style-type: none"> ▶ UV reaktörü için balastı değiştirin <p> Sadece Endress+Hauser tarafından belirlenen servis birimi tarafından değiştirilmelidir!</p>
Her 36 - 48 ayda bir	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pompa başlığını değiştirin <p> Sadece Endress+Hauser tarafından belirlenen servis birimi tarafından değiştirilmelidir!</p>

Bakım aralıkları büyük oranda uygulama ile alakalıdır. Bu nedenle bakım aralıklarının ihtiyaçlara göre uyarlanması gereklidir. Ancak, bakım işlerinin her zaman düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması önemlidir!

11.2 Bakım işleri

UYARI


Cihazda elektrik vardır!

Hatalı bağlantı yaralanmaya veya ölüme neden olabilir!

- ▶ Bakım işlerine başlamadan ÖNCE herhangi bir kabloda voltaj bulunmadığından emin olun.
- ▶ Cihazın güç beslemesi ile bağlantısını kesin, şebeke prizini çıkarın.

11.2.1 Peristaltik pompa

Peristaltik pompanın hortumunu her 6 ayda bir değiştirin. Cihaz yazılımı bir hatırlatma görüntüleyecektir.

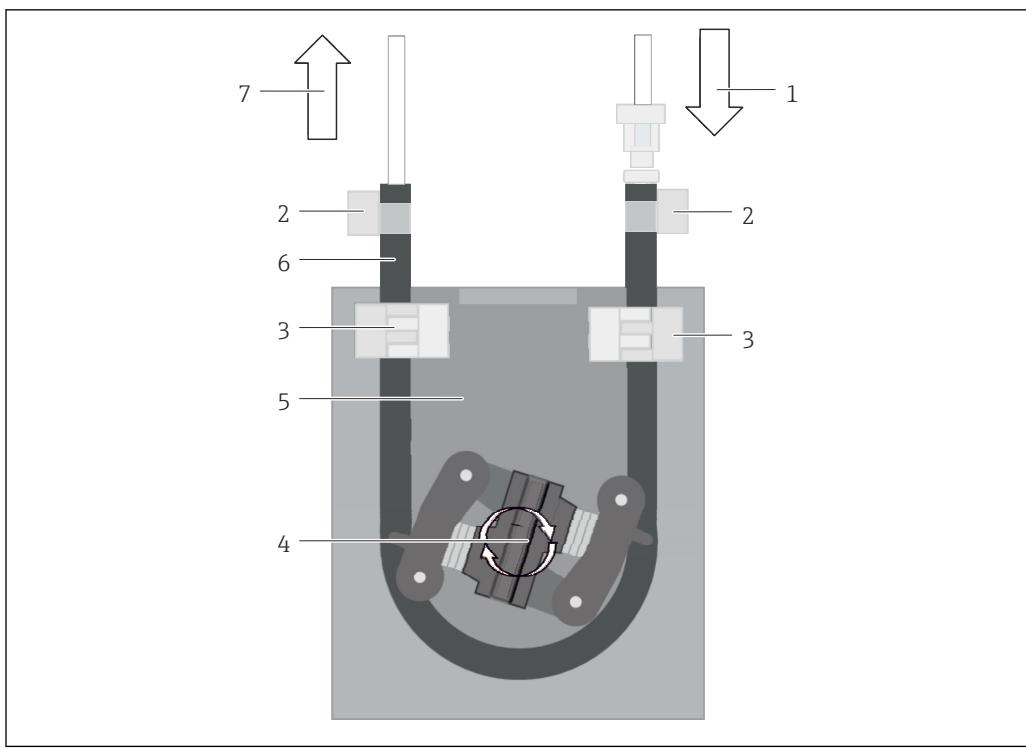

40 Peristaltik pompa

- 1 Hortum sistemi
- 2 Pompa girişi
- 3 Luer adaptörü
- 4 Hortum klipsleri
- 5 Pompanın hortum bağlantıları
- 6 Pompa başlığı
- 7 Pompa muhafazası
- 8 Pompa hortumu
- 9 Pompa çıkışı

Pompa hortumunu değiştirmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Numune akışını tamamen durdurun.
2. Sistemi kapatın → 32.
3. Cihazı şebeke şalterinden kapatın.
4. Cihazın şebeke prizini çıkarın.
5. Cihazı açın.
6. Pompa muhafazası (7) içerisindeki hortum bağlantılarını (5) açın ve pompa bağlantısındaki pompa hortumunu (8) çıkarın.
7. Hortum uçlarındaki hortum klipslerini (4) açın ve hortumu (1) çıkarın.
8. Eski pompa hortumunu bir ucundan pompa muhafazasından (7) dışarı çekerken pompa başlığını (6) çevirin.
9. Pompa başlığını çevirerek (6) pompa hortumunu takın ve muhafaza üzerine sabitleyin.
10. Pompa hortumunu (8) pompa muhafazasının (7) merkezine yerleştirin ve hortum bağlantılarını (5) kapatın.
11. Hortumu (1) yeni pompa hortumundaki luer adaptörüne (3) takın ve hortum klipsi (4) ile yerine sabitleyin.
12. **System** menüsünden pompa çalışma saatini sıfırlayın.

11.2.2 UV lambasına sahip reaktör


⚠ UYARI

Kısa dalga UV radyasyona sahip radyasyon kaynağı!

Hatalı taşıma gözlerde ve ciltte hasara neden olabilir!

- ▶ Reaktör üzerinde çalışmadan önce her zaman cihazı işletmeden çıkarın ve güç beslemesi ile bağlantısını kesin!
- ▶ Reaktörü her zaman komple bir grup olarak değiştirin!
- ▶ Hasarlı reaktörleri işletmeden çıkarın!
- ▶ Bağımsız bileşenleri değiştirmek için reaktörü kesinlikle açmayın!
- ▶ Reaktörü kesinlikle demonte veya korumasız bir durumda çalıştırmayın!
- ▶ Reaktör uçlarındaki yalıtımın sağlam kalmasını sağlayın (hasar görmemiş ısı ile büzüsen borular)!
- ▶ Kırılmış veya arızalı UV lambaları cıva içeren tehlikeli maddelere uygun şekilde imha edin.

Reaktör içerisindeki UV lambası sadece oksidasyon enerji kaynağı olarak kullanılır. Lambanın radyasyon yoğunluğu sensör tetiklenene kadar uzun çalışma saatleri sonrasında azalır ve bu etki ile ilgili bilgi ekranda gösterilir. Sensör kapatıldığında ölçüm noktası halen kısa süre çalışmaya devam eder. Yoğunluk önemli oranda düşük olacağı için sistemin yeniden kalibre edilmesi de gerekebilir. En geç 12 ay içerisinde reaktörü değiştirin.

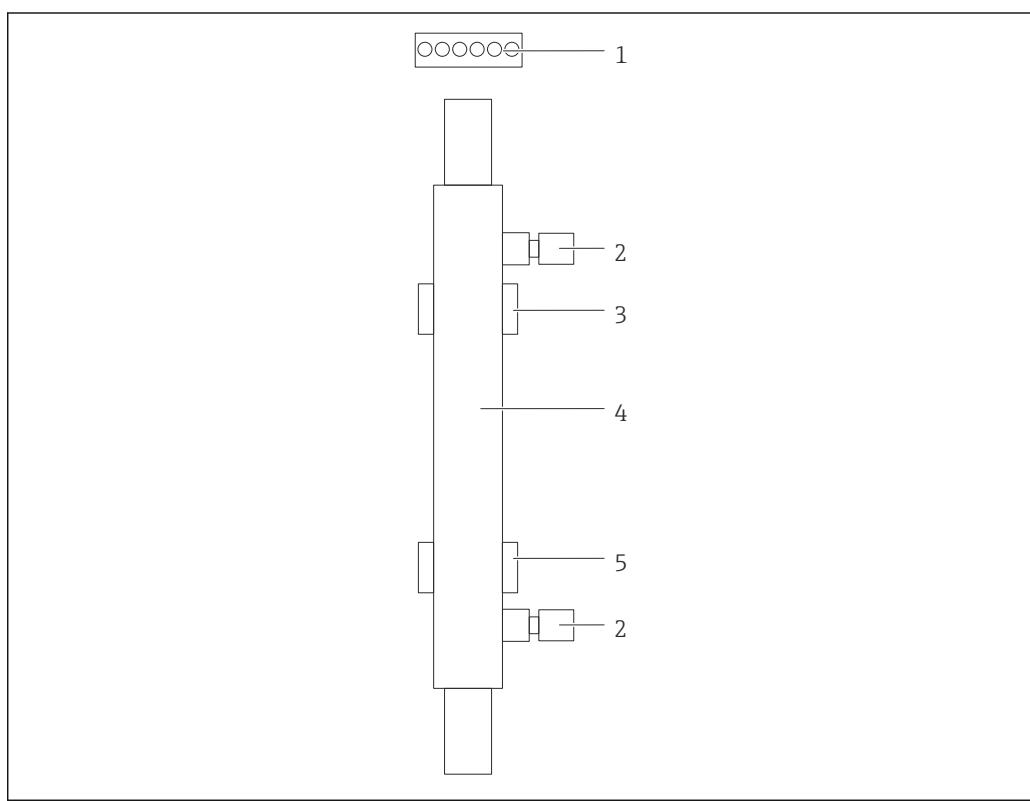

A0047340

41 Reaktör

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Bağlantı fişi |
| 2 | Sıvı bağlantıları |
| 3 | Üst tutucu |
| 4 | Reaktör |
| 5 | Alt tutucu |

Reaktörü değiştirmek için aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:

1. Numune akışını tamamen durdurun.
2. Sistemi kapatın → 32.

3. Reaktörden (4) sıvı bağlantılarını (2) çıkarın.
↳ Burada az miktarda sıvı dışarı sızabilir (reaktörde kalan sıvı).
4. Bağlantı fişini (1) elektronik balasta serbest bırakın.
5. Reaktörü metal muhafazanın tutucularından çıkarın. Bu amaçla reaktör ilk olarak üst tutucudan (3) ve sonrasında alt tutucudan (5) çıkarılmalıdır.
↳ Lütfen hem eski hem de yeni reaktörün cam uçlarına dokunulmadığından emin olun.
6. Yeni reaktörü sisteme takın. Burada, reaktör ilk olarak alt tutucuya ve sonrasında da üst tutucuya takılmalıdır.
↳ Reaktörü takarken fişe giden elektronik kabloların hasar görmemesi için özen gösterilmeli ve reaktörün arkasında bu amaçla verilmiş olan kanala takılmalarına dikkat edilmelidir.
7. Elektronik balasta ve sıvı bağlantılarına elektronik bağlantısını yeniden kurun.
8. Sistemi yeniden başlatın.
↳ Sistem modu reaktörün hata olmadan doğru çalışmasını sağlamak için reaktörü kontrol eder.
9. Kontrolün tamamlanması sonrasında reaktörün çalışma saati sayacını sıfırlayın.
↳ Bu yeni reaktörün kurulumunu tamamlar.

i Bir reaktör değişiminin takiben yeni reaktör normal pompa hızında ve lamba açılmış şekilde en az 20 dakika sistem modunda çalıştırılmalıdır. Bu safsızlıklar ve kirlenmeleri temizler. Ek olarak yeni UV reaktörünün kalibre edilmesi de gereklidir.

11.3 Çalışmadan kaldırma

⚠ DİKKAT

Analizörün çalışması sırasındaki aktiviteler

Madde veya nedeniyle yaralanma veya enfeksiyon riski!

- ▶ Hortumları çıkarmadan önce, örneğin numunenin pompalanması gibi hiçbir işlemin o sırada çalışmadığından veya yakında çalışmaya başlamayacağından emin olunuz.
- ▶ Koruyucu kıyafet, gözlük ve eldiven takın veya kendinizi korumak için başka önlemler alın.
- ▶ Saçılıan reaktifleri tek kullanımlık bir bez kullanarak silin ve temiz su ile durulayın. Sonrasında temizlenen alanları bir bez ile kurulayın.

DUYURU

Öncesinde "işletmeden kaldır" gerçekleştirilmeden 3 günden uzun süre kesintiye uğrayan çalışma

Cihaza hasar verebilir!

- ▶ Analizörü açıklanan şekilde çalışmadan kaldırın.

Çalışmadan kaldırmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Numune akışını tamamen durdurun.
2. Analizörü ultra saf su ile durulayın.
3. Hortumları tamamen boşaltın.
4. Bağlantı başlıklarını kör tapa ile sızdırmaz hale getirin.
5. Tüm giriş ve çıkışlara kör tapa takın.

12 Onarım

12.1 Yedek parçalar

Teslimata hazır olan cihaz yedek parçaları web sitesinde bulunmaktadır:

www.endress.com/device-viewer

- ▶ Yedek parça siparişi verirken cihazın seri numarası bilgisini de girin.

12.2 İade

Onarım veya bir fabrika kalibrasyonu gerekiyorsa ya da yanlış bir ürün sipariş veya teslim edilmişse ürün iade edilmelidir. Bir ISO sertifikalı şirket ve aynı zamanda kanuni düzenlemeler nedeniyle, Endress+Hauser madde ile temas etmiş olan iade ürün işlemlerinde belirli prosedürlere uymak zorundadır.

Cihazın hızlı, güvenli ve profesyonel şekilde iadesini sağlamak için:

- ▶ Cihazların iadesi ile ilgili prosedür ve şartlar hakkında bilgi için www.endress.com/support/return-material web sitesine bakın.

12.3 İmha

12.3.1 Analizörün imha edilmesi

DİKKAT

Standart solüsyonun hatalı imha edilmesi halinde yaralanma riski!

- ▶ İmha sırasında kullanılan kimyasallar için güvenlik veri sayfalarındaki talimatları takip edin.
- ▶ Atık imhası konusunda yerel düzenlemelere uyulmalıdır.



Elektrik ve elektronik ekipmanlarındaki 2012/19/EU Direktifi (WEEE) gerektiriyorsa, WEEE'nin ayrılmamış kentsel atık olarak imha edilmesini en azı indirmek için ürünler, gösterilen sembolle işaretlenmiştir. Bu işaretin taşıyan ürünler sınıflandırılmamış genel atık şeklinde imha etmeyin. Bunun yerine, uygun koşullar altında imha edilmesi için üreticiye iade edin.

13 Aksesuarlar

Aşağıdakiler bu dokümantasyonun yayınıldığı zamanda mevcut olan en önemli aksesuarlardır.

- ▶ Burada listelenmemiş olan aksesuarlar için lütfen Servis ve Satış Merkezi ile irtibata geçin.

CA78/79 basınç azaltma kiti

Besleme basıncı: maks. 10 bar (145 psi), ayarlanabilir çıkış basıncı
Sipariş No. 71543593

CA78/79 ısı eşanjörü kiti

Sıcaklık: maksimum 90 °C (194 °F) sıcaklığı kadar kullanılabilir
Sipariş No. 71543592

14 Teknik bilgiler

14.1 Giriş

Ölçülen değişken	TOC	
Ölçüm aralığı	0,5 ... 1000 µg/l (ppb)	
Giriş sinyali	<p>Kontrol cihazı girişi 24 V (sipariş seçeneği)</p> <p>Kontrol cihazı girişi bir ölçümü başlatır. Fonksiyon sadece 1 kanallı cihazlarda kullanılabilir.</p>	
<h2>14.2 çıkış</h2>		
Çıkış sinyali	<p>Ölçüm kanalları 1</p> <p>0/4-20 mA, galvanik olarak izole</p> <p>Ölçüm kanalı 2 (opsiyonel)</p> <p>0/4-20 mA, galvanik olarak izole</p>	
Alarmda sinyal	Atık için 1 giriş UNF ¼ - 28	
Yük	Maks. 500 Ω	
İletim davranışları	Ayarlanabilir, ölçüm aralığı 4 ... 20 mA	

14.3 Alum cikularu altif

Überprüfung der S-20-A-Normen-Nutzung

14.4 Güç beslemesi

Besleme voltajı 100/240 V AC, 47 - 63 Hz

Güç tüketimi Maks. 60 W

Güç beslemesi kablosu 2 m, Tip E+F şebeke prizi önceden takılmış

14.5 Performans özelliklerı

Ölçüm aralığı TOC (toplam organik karbon)

Maksimum ölçülen hata +/- 0,5 µg/l (ppb) veya %1, her durumda daha yüksek değer geçerlidir

Tespit limiti (LOD) 0,1 µg/l (ppb)

Cevap süresi t₉₀ 50 s

Ölçüm kanalı sayısı 1 ile 3 arası, sipariş versiyonuna bağlı olarak

Numune gereksinimi ~ 14 ml/dak.

UV reaktörü Sürekli fonksiyon izlemeye sahip UV reaktörü

Kalibrasyon aralığı Cihaz teslimatta kalibre edilmiştir. Pompa hortumu veya UV reaktörü gibi proses ile temas halinde olan parçalar değiştirildikten sonra yeni bir kalibrasyon yapılması tavsiye edilir.

Bakım aralığı

- Kalibrasyon solüsyonu değişimi - her kalibrasyon öncesinde
- Pompa hortumunun değiştirilmesi - her 6 ayda bir
- UV reaktörünün değiştirilmesi - her 6 ayda bir
- UV reaktör balastının değiştirilmesi - her 24 - 36 ayda bir
- Pompa başlığının değiştirilmesi - her 36 - 48 ayda bir

Bakım çalışması Ayda 1 saat

14.6 Çevre

Ortam sıcaklığı 10 ile 45 °C arası (50 ile 113 °F arası)

Saklama sıcaklığı 2 ... 55 °C (35 ... 131 °F)

Bağıl nem %10 ile %90 arası, yoğuşmasız

Koruma derecesi	IP 42 (standart cihaz), IP54 (sipariş seçeneği)
Elektromanyetik uyumluluk ³⁾	Endüstri için EN 61326-1:2013, Sınıf A'ya uygun parazit emisyonu ve parazit dayanıklılığı
Elektrik güvenliği	EN/IEC 61010-1:2010'a uygun şekilde, Sınıf 1 ekipman Düşük voltaj: Aşırı voltaj kategorisi II Deniz seviyesinden en fazla 3 000 m (9 800 ft) yüksekte kurulumlar için
Kirlilik derecesi	2

14.7 Proses

Numune sıcaklığı	< 50 °C (122 °F)
Proses basıncı	Maks. 0,5 bar (7,25 psi); tavsiye edilen 0,25 bar (3,62 psi)
Numune çıkışı	Basıncı alınmış
Numune kalitesi	Partikülsüz
Numunedeki maksimum iletkenlik	2 µS/cm
Numune beslemesi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Numune için 1 ağız: sistem uygunluk testi için 1 giriş, manuel ■ Sipariş seçeneği 1: numune için 1 giriş, sistem uygunluk testi için 3 giriş, otomatik ■ Sipariş seçeneği 2: numune için 3 giriş, sistem uygunluk testi için 1 giriş, manuel

14.8 Mekanik yapı

Tasarım, boyutlar	→  12
Ağırlık	Yakl. 14 kg (30,86 lb)
Malzemeler	Paslanmaz çelik muhafaza
Hortum teknik özellikleri	Numune hortumu 1/8 inç, 3,2 mm dış çap bağlantı kitine dahildir. Diğer cihazlara mesafe 50 cm. 2 metre numune besleme hattı ve 1 metre yükseklik farkı değerlerini geçmeyin.

3) Ürünü amaçlanan şekilde çalıştmak için yeterli şebeke kalitesi gereklidir.

İndeks

A

Ağırlık	53
Akim çıkışları	
Aktif	51
Aksesuarlar	50
Alarmda sinyal	51
Analizör	
Montaj	13
Analizörün imha edilmesi	49
Analizörün montajı	13
Aralık modu düzenleyici	33
Arıza giderme	43

B

Bağlantı sonrası kontrol	16
Bağlantı talimatları	16
Bağlantının yapılması	16
Bakım	45
Bakım aralığı	52
Bakım çalışması	52
Bakım işleri	45
Bakım programı	45
Besleme voltajı	52
Boyutlar	12, 53

C

Cihaz yazılımı geçmişi	44
----------------------------------	----

Ç

Çalışma	42
Çalışma güvenliği	5
Çalışma menüsünün yapısı ve fonksiyonu	17
Çalışma seçeneklerine genel bakış	17
Çalıştırma seçenekleri	17
Çevre	52
Çıkış	51
Çıkış sinyali	51

D

Devreye alma	19
Doküman	4

E

Elektrik bağlantısı	16
Elektrik güvenliği	53
Elektromanyetik uyumluluk	53
En güncel teknoloji	6

F

Fonksiyon kontrolü	19
------------------------------	----

G

Giriş	51
Giriş sinyali	51
Güç beslemesi	52
Güç beslemesi kablosu	52
Güç tüketimi	52

Güvenlik

IT	6
Güvenlik talimatları	5

H

Hata teşhis	43
Hortum sistemi	
Değişim	43
Hortum teknik özellikleri	53
Hortumun değiştirilmesi (peristaltik pompa)	45

I

İade	49
İletim davranışı	51
İmha	49
İsim plakası	7
İş yerı güvenliği	5

K

Kalibrasyon aralığı	52
Kalibrasyon ve ayar	23
Kapanıyor	32
Kirlilik derecesi	53
Konfigürasyon	19
Koruma derecesi	16, 53
Kullanım amacı	5
Kurulum kontrolü	19

L

Lokal ekrana erişim	18
-------------------------------	----

M

Maddenin bağlanması	14
Malzemeler	53
Montaj gereksinimleri	12
Montaj seçenekleri	12
Montaj sıralaması	13
Montaj sonrası kontrol	15

N

Nem	52
Numune beslemesi	53
Numune çıkışı	53
Numune gereksinimi	52
Numune kalitesi	53
Numune sıcaklığı	53
Numunedeki maksimum iletkenlik	53

O

Onarım	49
Ortam sıcaklığı	52
Otomatik başlatma	31
Oturum açma prosedürü	19

Ö

Ölçülen değerlerin kaydedilmesi	33
Ölçülen değişken	51

Ölçülen hata	52
Ölçüm	19
Ölçüm aralığı	51, 52
Ölçüm kanalı sayısı	52

P

Performans özellikleri	52
Personel için gereksinimler	5
Proses	53
Proses basıncı	53
Proses şeması	10

Q

Qualification	23
-------------------------	----

R

Reaktörün değiştirilmesi	47
------------------------------------	----

S

Saklama sıcaklığı	52
Seçenekler	33
Semboller	4
Settings	29
Sinyal girişleri	51
Sipariş kodu	7
Sistem	27
Sistem uygunluk testi	25

T

Teknik bilgiler	51
Teslimat kapsamı	8
Teslimatın kabul edilmesi	7

U

Uyarılar	4, 20
--------------------	-------

Ü

Üretici adresi	8
Ürün açıklaması	9
Ürün güvenliği	6
Ürün sayfası	7
Ürün tanımlaması	7
Ürün tasarıımı	9

V

Viewer	22
------------------	----

Y

Yanıt süresi	52
Yazılım uyarlaması	34
Yedek parçalar	49
Yük	51



71583657

www.addresses.endress.com
