

Instrucțiuni succinte de utilizare

Liquisys M CLM253

Transmițător pentru conductivitate



Cuprins

1	Despre acest document	3
1.1	Avertismente	3
1.2	Simbolurile utilizate	3
1.3	Simboluri de pe dispozitiv	3
2	Instrucțiuni de siguranță de bază	4
2.1	Cerințe privind personalul	4
2.2	Utilizarea prevăzută	4
2.3	Siguranța la locul de muncă	4
2.4	Siguranța operațională	5
2.5	Siguranța produsului	5
3	Recepția la livrare și identificarea produsului	5
3.1	Recepția la livrare	5
3.2	Conținutul pachetului livrat	6
3.3	Identificarea produsului	6
4	Instalare	7
4.1	Cerințe privind instalarea	7
4.2	Instalarea dispozitivului	9
4.3	Verificarea post-instalare	11
5	Conexiune electrică	11
5.1	Conectarea dispozitivului	12
5.2	Contact de alarmă	17
5.3	Verificare post-conectare	17
6	Opțiuni de operare	18
6.1	Prezentare generală a opțiunilor de operare	18
6.2	Afișaj și elemente de operare	18
6.3	Accesul la meniul de operare prin intermediul afișajului local	23
7	Punerea în funcțiune	26
7.1	Verificarea funcțiilor	26
7.2	Pornirea dispozitivului	26
7.3	Ghid de pornire rapidă	27

1 Despre acest document

1.1 Avertismente

Structura informațiilor	Semnificație
 PERICOL Cauze (/consecințe) Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică) ► Acțiune corectivă	Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea situației periculoase va avea ca rezultat o vătămare corporală fatală sau gravă.
 AVERTISMENT Cauze (/consecințe) Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică) ► Acțiune corectivă	Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea situației periculoase poate avea ca rezultat o vătămare corporală fatală sau gravă.
 PRECAUȚIE Cauze (/consecințe) Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică) ► Acțiune corectivă	Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat o vătămare corporală minoră sau mai gravă.
 NOTĂ Cauză/situație Dacă este necesar, consecințe ale nerespectării (dacă se aplică) ► Acțiune/notă	Acest simbol vă avertizează asupra situațiilor care pot avea ca rezultat daune materiale.

1.2 Simbolurile utilizate

	Informații suplimentare, sfaturi
	Permis
	Recomandat
	Nepermise sau nerecomandate
	Referire la documentația dispozitivului
	Trimitere la pagină
	Trimitere la grafic
	Rezultatul unei etape individuale

1.3 Simboluri de pe dispozitiv

	Referire la documentația dispozitivului
	Nu eliminați produsele care poartă acest marcaj ca deșeuri municipale nesortate. În schimb, returnați-le la producător pentru eliminare în conformitate cu condițiile aplicabile.

2 Instrucțiuni de siguranță de bază

2.1 Cerințe privind personalul

- Instalarea, darea în exploatare, utilizarea și întreținerea sistemului de măsurare pot fi efectuate numai de către personal tehnic special instruit.
- Personalul tehnic trebuie autorizat de către operatorul uzinei pentru a efectua activitățile specificate.
- Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un tehnician electrician.
- Personalul tehnic trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni de utilizare și trebuie să urmeze instrucțiunile pe care le conțin.
- Defectele de la punctul de măsurare pot fi remediate numai de personal autorizat și special instruit.



Reparațiile care nu sunt descrise în instrucțiunile de utilizare furnizate pot fi efectuate numai direct la sediul producătorului sau de către departamentul de service.

2.2 Utilizarea prevăzută

Transmițătorul Liquisys M este utilizat pentru a determina conductivitatea și rezistivitatea mediilor fluide.

Transmițătorul este deosebit de adecvat pentru utilizarea în următoarele domenii:

- Apă ultrapură
- Tratarea apei
- Desalinizarea apei de răcire
- tratarea condensului
- Stații de tratare a apelor reziduale municipale
- Industria chimică
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică

Orice altă utilizare decât cea preconizată presupune riscuri pentru persoane și sistemul de măsurare. De aceea, orice altă utilizare este interzisă.

Producătorul declină orice răspundere pentru prejudiciile rezultate în urma utilizării incorecte sau în alt scop decât cel prevăzut în prezentul manual.

2.3 Siguranța la locul de muncă

Operatorul este responsabil pentru a garanta conformitatea cu următoarele reguli de siguranță:

- Instrucțiuni de instalare
- Standarde și reglementări locale

Compatibilitate electromagnetică

- Produsul a fost testat pentru compatibilitate electromagnetică în conformitate cu standardele internaționale aplicabile aplicațiilor industriale.
- Compatibilitatea electromagnetică indicată se aplică numai unui produs care a fost conectat în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare.

2.4 Siguranța operațională

Înainte de punerea în funcțiune a întregului punct de măsurare:

1. Verificați dacă toate conexiunile sunt corecte.
2. Asigurați-vă că nu sunt deteriorate cablurile electrice și racordurile de furtun.

Procedura pentru produse deteriorate:

1. Nu utilizați produse deteriorate și protejați-le împotriva utilizării accidentale.
2. Etichetați produsele deteriorate ca defecte.

În timpul funcționării:

- Dacă erorile nu pot fi remediate,
scoateți produsele din uz și protejați-le împotriva operării neintenționate.

2.5 Siguranța produsului

2.5.1 Nivelul de dezvoltare

Produsul este conceput în conformitate cu buna practică tehnologică, pentru a respecta cele mai moderne cerințe de siguranță; acesta a fost testat și a părăsit fabrica într-o stare care asigură funcționarea în condiții de siguranță. Reglementările relevante și standardele internaționale au fost respectate.

2.5.2 Securitate IT

Furnizăm o garanție numai dacă dispozitivul este instalat și utilizat conform descrierii din instrucțiunile de operare. Dispozitivul este echipat cu mecanisme de securitate pentru protecție împotriva oricăror modificări accidentale ale setărilor dispozitivului.

Măsurile de securitate IT în conformitate cu standardele de securitate ale operatorilor și concepute pentru a asigura protecție suplimentară pentru dispozitiv și transferul datelor de pe dispozitiv trebuie să fie implementate direct de către operatori.

3 Recepția la livrare și identificarea produsului

3.1 Recepția la livrare

La recepția livrării:

1. Verificați ambalajul pentru a depista eventualele deteriorări.
 - ↳ Raportați imediat producătorului orice deteriorare.
Nu instalați componente deteriorate.
2. Verificați conținutul pachetului livrat folosind nota de livrare.
3. Comparați datele de pe plăcuța de identificare cu informațiile din comandă de pe nota de livrare.

4. Verificați documentația tehnică și toate celelalte documente necesare, de exemplu, certificate, pentru a vă asigura că sunt complete.

 Dacă nu se îndeplinește una dintre aceste condiții, contactați producătorul.

3.2 Conținutul pachetului livrat

- 1 transmițător CLM253
- 1 bornă cu șurub de conectare, 3 pini
- 1 presgarnitură de cablu Pg 7
- 1 presgarnitură de cablu Pg 16 redusă
- 2 presgarnituri de cablu Pg 13,5
- 1 set de instrucțiuni de operare
- Pentru versiunile cu comunicație HART:
 - 1 set de instrucțiuni de operare: Comunicație pe teren cu HART
- Pentru versiuni cu interfață PROFIBUS:
 - 1 set de instrucțiuni de operare: Comunicație pe teren cu PROFIBUS PA/DP

3.3 Identificarea produsului

3.3.1 Adresa producătorului

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Germania

Interpretarea codului de comandă

Codul de comandă și numărul de serie ale produsului dumneavoastră pot fi găsite în următoarele locații:

- Pe plăcuța de identificare
- În documentația de livrare

Obținerea informațiilor despre produs

1. Accesați www.endress.com.
2. Căutare pe pagină (simbol de lupă): Introduceți un număr de serie valid.
3. Căutare (lupă).
 - ↳ Structura produsului este afișată într-o fereastră pop-up.
4. Faceți clic pe prezentarea generală a produsului.
 - ↳ Se deschide o nouă fereastră. Aici veți găsi informații referitoare la dispozitivul dumneavoastră, inclusiv documentația produsului.

3.3.2 Pagina de produs

www.endress.com/CLM253

3.3.3 Plăcuța de identificare

Următoarele informații despre dispozitiv pot fi găsite pe plăcuța de identificare:

- Identificare producător
- Cod de comandă
- Cod de comandă extins
- Număr de serie
- Condiții ambientale și de proces
- Valori de intrare și de ieșire
- Informații privind siguranța și avertismente

► Comparați informațiile de pe plăcuța de identificare cu comanda.

3.3.4 Identificarea produsului

Codul de comandă și numărul de serie ale produsului dumneavoastră pot fi găsite în următoarele locații:


- Pe plăcuța de identificare
- În documentația de livrare

Obținerea informațiilor despre produs

1. Accesați www.endress.com.
2. Căutare pe pagină (simbol de lupă): Introduceți un număr de serie valid.
3. Căutare (lupă).
 - ↳ Structura produsului este afișată într-o fereastră pop-up.
4. Faceți clic pe prezentarea generală a produsului.
 - ↳ Se deschide o nouă fereastră. Aici veți găsi informații referitoare la dispozitivul dumneavoastră, inclusiv documentația produsului.


4 Instalare

4.1 Cerințe privind instalarea

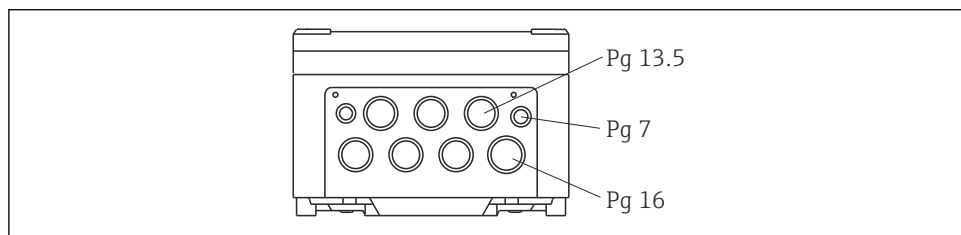

A0059136


1 Filet pentru presgarnituri de cablu

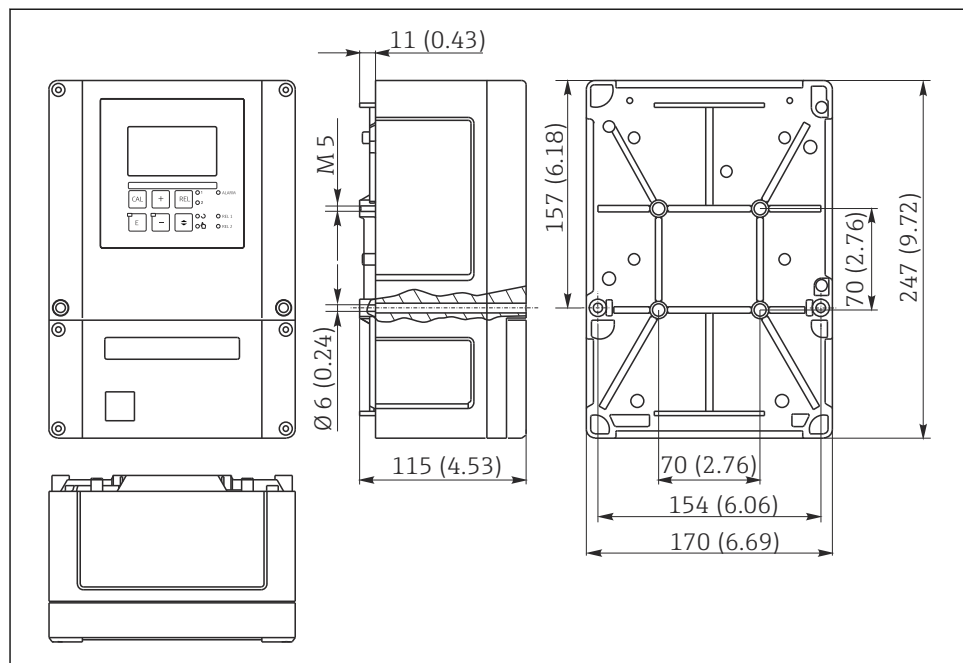

A0059137

2 Dimensiuni

i Există un orificiu în perforație pentru intrarea cablului (conectarea tensiunii de alimentare). Servește la echilibrarea presiunii în timpul transportului aerian. Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în interiorul carcasei înainte de instalarea cablului. Carcasa este complet etanșă după instalarea cablului.

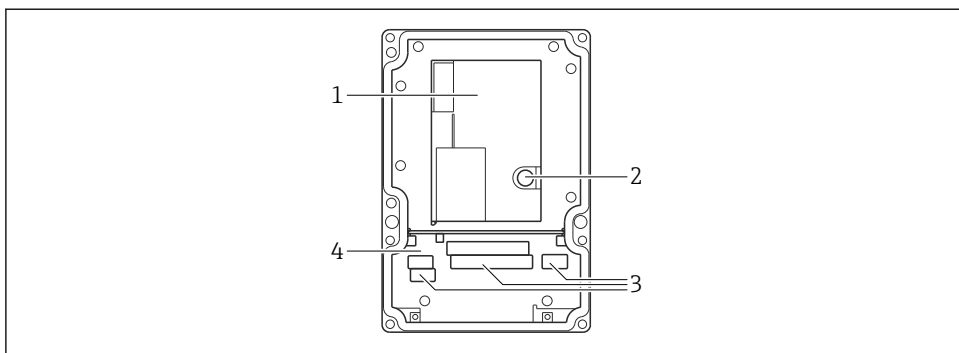

A0059154

3 Vizualizare în carcasa de teren

- 1 Cutie cu componente electronice amovibilă
- 2 Siguranță
- 3 Borne
- 4 Placă de partiție

4.2 Instalarea dispozitivului

Opțiuni pentru fixarea carcasei de teren:

- Montarea pe perete cu șuruburi de fixare
- Montarea stâlpului pe conducte cilindrice
- Montarea stâlpului pe un pilon de fixare pătrat


NOTĂ

Efectul condițiilor climatice (ploaie, zăpadă, lumină solară directă)

Funcționare afectată datorită deteriorării complete a transmițătorului

- La instalarea dispozitivului în exterior, utilizați întotdeauna carcasa de protecție împotriva intemperiilor (accesoriu).

4.2.1 Montare pe perete

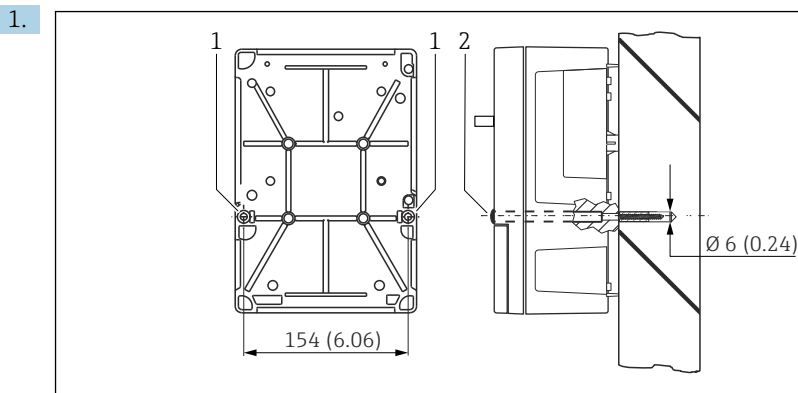

A0059157

4 Montare pe perete

- 1 Orificii alezate de fixare
- 2 Capace din plastic


Realizați orificiile alezate conform ilustrației din .

2. Introduceți două șuruburi de fixare prin orificiile alezate de fixare (1) din față.
3. Montați transmîțătorul pe perete conform indicațiilor.
4. Acoperiți alezajele cu capace din plastic (2).

4.2.2 Montarea pe stâlpi



Este necesar un kit de montare pe stâlpi pentru a fixa dispozitivul de teren pe conducte sau stâlpi orizontali și verticali (diametru maxim de 60 mm (2.36")). Acesta poate fi achiziționat ca un accesoriu (consultați secțiunea „Accesorii”).

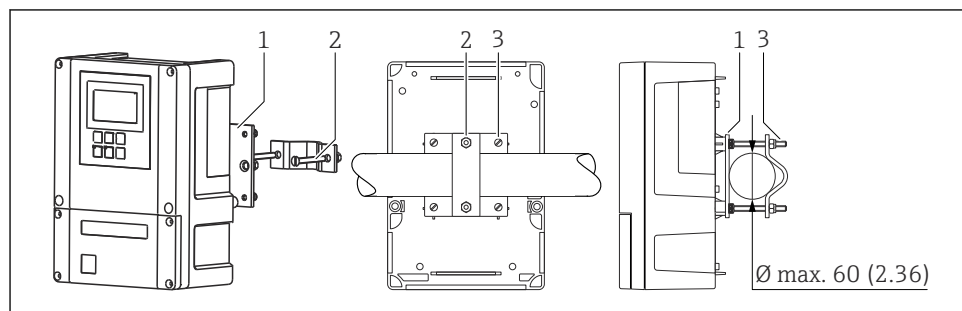

A0059139


5 Montarea pe conducte orizontale sau verticale

- 1 Placă de fixare
- 2 Șuruburi de fixare
- 3 Șuruburi de fixare

Pentru a monta transmîțătorul pe un stîlp, procedați după cum urmează:

1. Ghidați cele două șuruburi de fixare (1) ale kitului de montare prin deschiderile de pe placa de fixare (3).
2. Înșurubați placa de fixare pe transmîțător folosind patru șuruburi de fixare (2).
3. Fixați consola cu dispozitivul de teren pe stîlp sau conductă cu ajutorul clemei.

Dispozitivul de teren poate fi fixat, de asemenea, pe consola Flexdip CYH112 împreună cu carcasa de protecție împotriva intemperiilor. Acestea pot fi achiziționate ca accesorii (consultați secțiunea „Accesorii”).

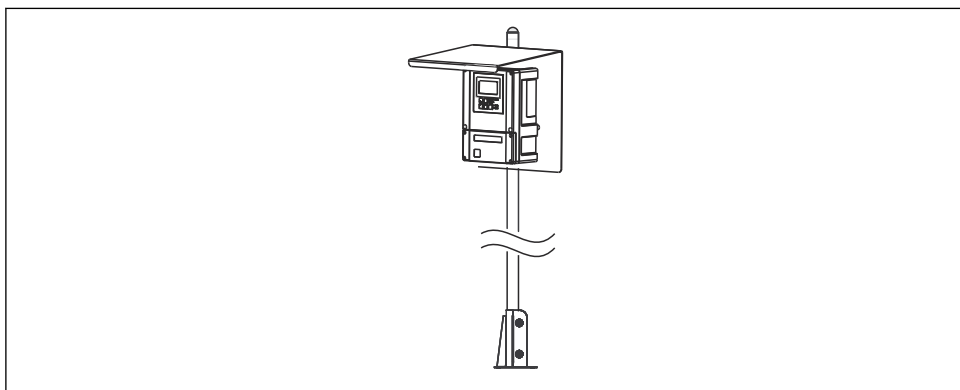

A0059140

6 Dispozitiv de teren pe consola Flexdip CYH112 cu carcasă de protecție împotriva intemperiilor

4.3 Verificarea post-instalare

- După instalare, verificați transmîțătorul, pentru a vedea dacă nu este deteriorat.
- Verificați dacă transmîțătorul este protejat la precipitații și lumină solară directă (de exemplu, de carcasa de protecție împotriva intemperiilor).

5 Conexiune electrică

⚠️ AVERTISMENT

Dispozitivul este sub tensiune!

Conexiunea incorectă poate duce la răniri sau deces!

- ▶ Conexiunea electrică trebuie realizată numai de către un tehnician electrician.
- ▶ Electricianul trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni de utilizare și trebuie să urmeze instrucțiunile pe care le conțin.
- ▶ **Înainte** de a începe lucrările de conectare, asigurați-vă că nu există tensiune pe niciun cablu.

5.1 Conectarea dispozitivului

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

- La punctul de alimentare, sursa de alimentare pentru dispozitivele pe 24 V trebuie izolată de cablurile sub tensiune periculoase prin izolație dublă sau izolații armate.


NOTĂ

Dispozitivul nu dispune de un întrerupător de alimentare

- Trebuie prevăzut un disjuncteur protejat în apropierea dispozitivului la locul de instalare.
- Disjuncteurul trebuie să fie un comutator sau un întrerupător de alimentare și trebuie etichetat drept disjuncteur pentru dispozitiv.

5.1.1 Schemă de conexiuni

Schema de conexiuni prezintă conexiunile unui dispozitiv dotat cu toate opțiunile. Conectarea senzorilor la diferitele cabluri de măsurare este explicată mai detaliat în secțiunea „Cabluri de măsurare și conectarea senzorilor”.

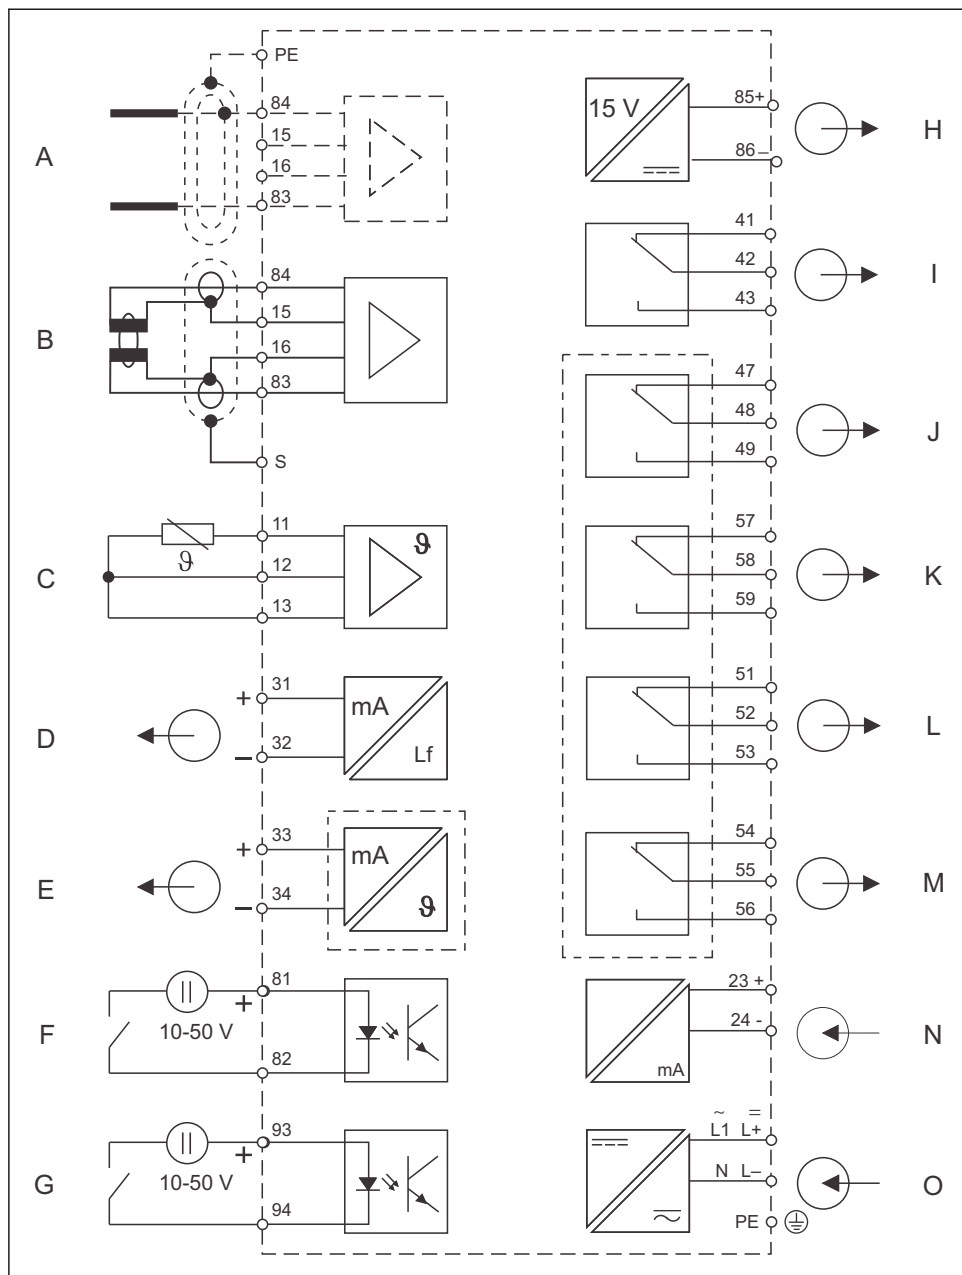

A0008920


7 Conexiunea electrică a transmițătorului

A	Senzor (conductiv)	I	Alarmă (poziție contact fără curent)
B	Senzor (inductiv)	J	Releu 1 (poziție contact fără curent)
C	Senzorul de temperatură	K	Releu 2 (poziție contact fără curent)
D	leșire de semnal 1, conductivitate	L	Releu 3 (poziție contact fără curent)
E	leșire de semnal 2, variabilă definită de utilizator	M	Releu 4 (poziție contact fără curent)
F	Intrare binară 1 (menținere)	N	Intrare de curent între 4 și 20 mA
G	Intrare binară 2 (Chemoclean)	O	Conexiune electrică
H	leșire auxiliară de tensiune		

Respectați următoarele:

- Dispozitivul este omologat pentru clasa de protecție II și funcționează în general fără o conexiune de împământare de protecție.
- Pentru a garanta stabilitatea măsurării și siguranța funcțională, conectați ecranul exterior al cablului senzorului:
 - Senzori inductivi: borna „S”
 - Senzori conductivi: Șină de distribuție PE
 Șina de distribuție PE este amplasată în compartimentul cu borne. Împământați șina de distribuție PE sau borna de împământare direct la fața locului, ori de câte ori este posibil.
- Circuitele „E” și „H” nu sunt izolate galvanic unul de celălalt.

Conectarea dispozitivului

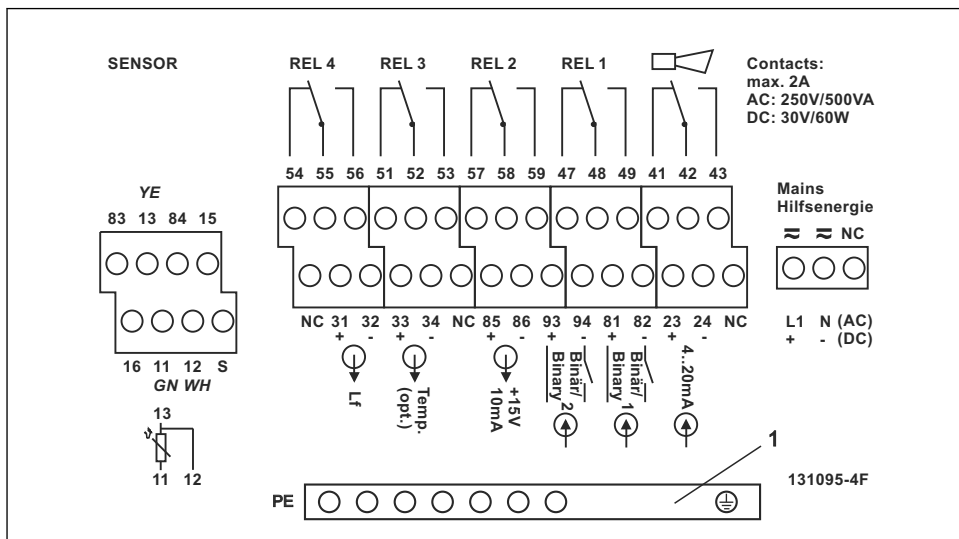

5.1.2 **Cabluri de măsurare și conectarea senzorilor**


Sunt necesare cabluri de măsurare ecranate speciale pentru conectarea senzorilor de conductivitate la transmițător.

Se pot utiliza următoarele tipuri de cabluri preterminate, multifilare:

Tip de senzor	Cablu	Extensie
Senzor cu doi electrozi cu sau fără senzor de temperatură Pt 100	CYK71 CPK9* (pentru CLS16)	Casetă VBM + cablu CYK71
Senzor inductiv CLS50, CLS52	Cablu fix pe senzor	Casetă VBM + cablu CLK6

* Versiunea pentru temperaturi înalte fără PML

Lungime maximă cablu	
Măsurarea conductivă a conductivității	Max. 100 m (328 ft) cu CYK71
Măsurarea rezistenței	Max. 15 m (49.2 ft) cu CYK71
Măsurarea inductivă a conductivității	Max. 55 m (180 ft) cu CLK5 (incl. cablu de senzor)

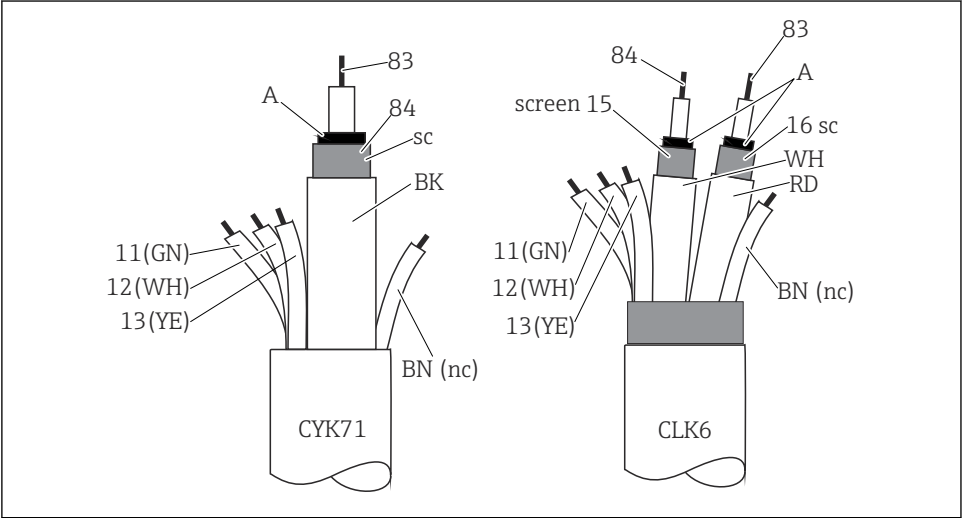

A0060183

9 Structura și terminațiile cablurilor de măsurare

- A Strat semiconductor
- sc Ecranare


 Pentru informații suplimentare despre cabluri și cutii de distribuție, consultați secțiunea „Accesorii”.

Conectarea cablului de măsurare


1. Deschideți capacul carcasei pentru a accesa regleta de borne din compartimentul de conexiuni.
2. Rupeți perforația pentru presgarnitura de cablu din carcasă, instalați o presgarnitură de cablu și ghidați cablul prin această presgarnitură.
3. Conectați cablul conform alocării bornelor (consultați eticheta compartimentului de conexiuni).
4. Strângeți presgarnitura de cablu.

Conectarea cablului de măsurare

- Conectați cablul de măsurare la bornele din spatele dispozitivului conform alocării bornelor (consultați eticheta conexiunii)

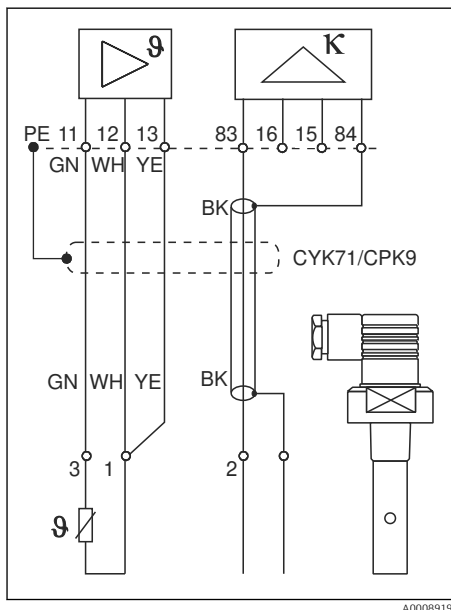


10 Conectarea senzorilor conductivi

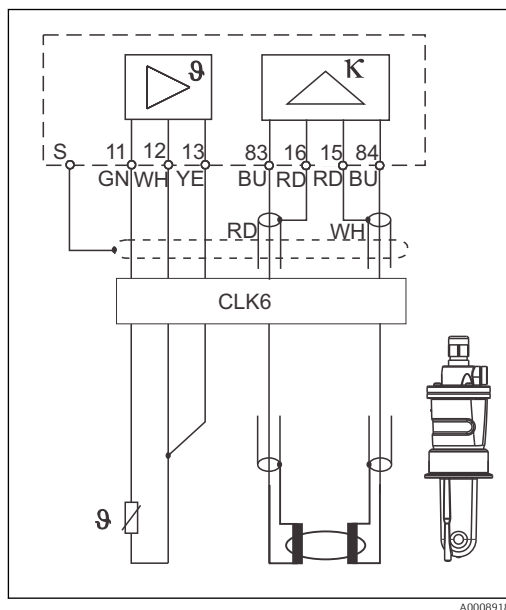

11 Conectarea senzorilor inductivi

5.2 Contact de alarmă

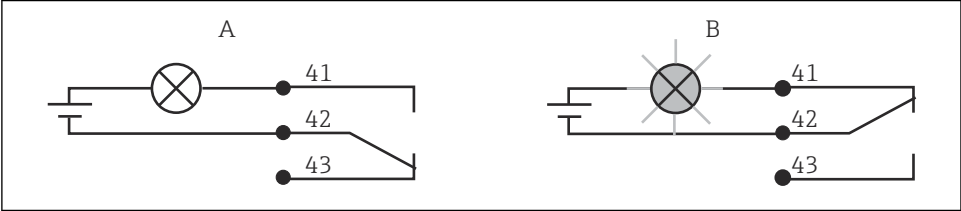

12 Se recomandă comutarea cu protecție intrinsecă pentru contactul de alarmă

- A Stare de funcționare normală
- B Stare de alarmă

Stare de funcționare normală

Dispozitiv în funcțiune și niciun mesaj de eroare prezent (LED de alarmă stins):

- Releu sub tensiune
- Contact 42/43 închis

Stare de alarmă

Mesaj de eroare prezent (LED de alarmă roșu) sau dispozitiv defect sau scos de sub tensiune (LED de alarmă stins):

- Releu fără tensiune
- Contact 41/42 închis

5.3 Verificare post-conectare

După ce ați configurat conexiunea electrică, efectuați următoarele verificări:

Starea și specificațiile dispozitivului	Note
Dispozitivele sau cablurile nu prezintă deteriorări pe partea exterioară?	Inspecție vizuală

Conexiune electrică	Note
Sunt cablurile montate fără a fi tensionate?	
Sunt cablurile conectate prevăzute cu protecție contra tensionării?	
Cablul este pozat corect, fără bucle și intersecțiuni?	
Sunt cablul de alimentare și cablurile de semnal conectate corect și în conformitate cu schema de conexiuni?	
Sunt strânse toate bornele cu șurub?	
Sunt toate intrările de cablu montate, strânse și etanșate?	
Blocurile distribuitorului PE sunt legate la pământ (dacă există)?	Împământarea se realizează la punctul de instalare.

6 Opțiuni de operare

6.1 Prezentare generală a opțiunilor de operare

Opțiuni pentru comandarea transmițătorului:

- La locația de instalare, de la tastatură
- Prin interfața HART (opțional, cu versiunea corespunzătoare a comenzii) cu:
 - Terminal portabil HART
 - PC cu modem HART și pachetul software Fieldcare
- Prin PROFIBUS PA/DP (opțional, cu versiunea de comandă corespunzătoare) pe PC cu o interfață corespunzătoare și un pachet software Fieldcare sau printr-un controler logic programabil (PLC).

 Pentru utilizare prin HART sau PROFIBUS PA/DP, respectați secțiunile corespunzătoare din instrucțiunile de operare suplimentare:

- PROFIBUS PA/DP, comunicație de teren pentru Liquisys M CXM223/253, BA00209C/07/DE
- HART, comunicație de teren pentru Liquisys M CXM223/253, BA00208C/07/DE

În secțiunea următoare este explicat numai modul de utilizare prin intermediul tastaturii.


6.2 Afișaj și elemente de operare

6.2.1 Structura și funcțiile meniului de operare

Indicatoare cu LED

 A0027220	Indică modul de operare actual, „Auto” (LED verde) sau „Manual” (LED galben)
 A0027222	Indică releul activat în modul „Manual” (LED roșu) Starea releelor 3 și 4 este indicată pe afișajul LC.
 A0027221	Indică starea de funcționare a releelor 1 și 2 LED verde: valoare măsurată în limitele admise, releu inactiv LED roșu: valoare măsurată în afara limitelor admise, releu activ
 A0027218	Afișaj alarmă, de exemplu în cazul depășirii continue a valorii limită, al defectării senzorului de temperatură sau al unei erori de sistem (consultați lista de erori)

Afișaj LC

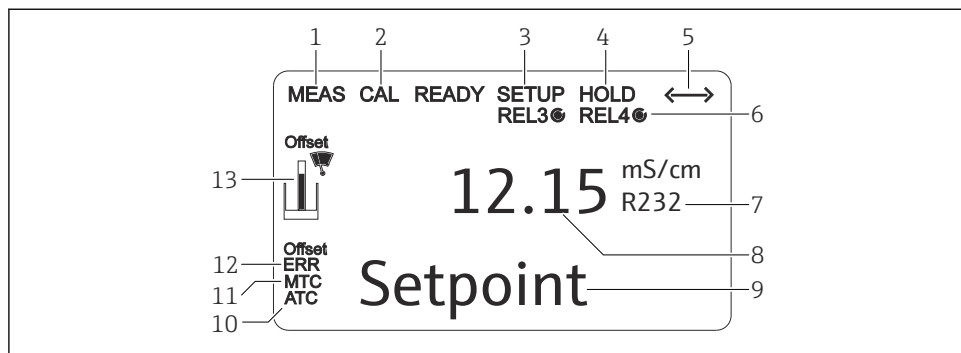


A0060188

13 Afișaj transmțător LC

- 1 Indicator pentru modul de măsurare (utilizare normală)
- 2 Indicator pentru modul de calibrare
- 3 Indicator pentru modul de setare (configurare)
- 4 Indicator pentru modul „Menținere” (ieșirile de curent rămân în ultima stare curentă)
- 5 Indicator pentru primirea unui mesaj pe dispozitivele cu comunicație
- 6 Indicator al stării de funcționare a releelor 3/4: ○ inactiv, ● activ
- 7 Indicator pentru codul funcției
- 8 În modul de măsurare: variabilă măsurată - în modul de setare: variabilă configurată
- 9 În modul de măsurare: valoare secundară măsurată - în modul de setare/calibrare: de exemplu, valoare de setare
- 10 Indicator pentru compensarea Compensarea temperaturii
- 11 Indicator pentru compensarea Compensarea temperaturii
- 12 „Eroare”: afișare eroare
- 13 Simbol senzor (consultați secțiunea „Calibrare”)

Elemente de operare

Pe afișaj apar simultan valoarea măsurată curentă și temperatura. Aceasta vă pune la dispoziție cele mai importante date de proces. Textul de ajutor din meniul de configurare îi ajută pe utilizatori să configureze parametrii dispozitivului.

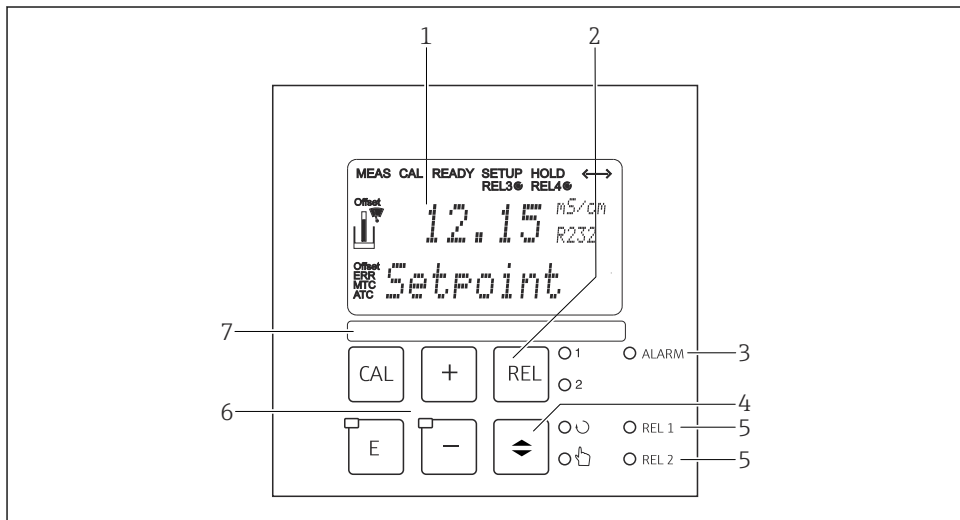




A0060194

14 Elemente de operare

- 1 Afișaj LC pentru indicarea valorilor măsurate și a datelor de configurare
- 2 Tastă pentru comutarea releelor în modul manual și pentru afișarea contactului activ
- 3 LED pentru funcția de alarmă
- 4 Comutator pentru modul automat/manual
- 5 LED-uri pentru releul contactorului de limitare (stare comutator)
- 6 Taste principale de acționare pentru calibrare și configurarea dispozitivului
- 7 Câmp pentru informații definite de utilizator

Funcțiile tastelor

 A0027235	tasta CAL Când apăsați tasta CAL, dispozitivul vă solicită mai întâi codul de acces pentru calibrare: ■ Codul 22 pentru calibrare ■ Codul 0 sau orice alt cod pentru citirea celor mai recente date de calibrare Utilizați tasta CAL pentru a accepta datele de calibrare sau pentru a comuta între câmpuri în meniul de calibrare.
 A0027236	tasta ENTER Când apăsați tasta ENTER, dispozitivul vă solicită mai întâi codul de acces pentru modul de configurare: ■ Cod 22 pentru configurare și configurație ■ Codul 0 sau orice alt cod pentru citirea tuturor datelor de configurare. Tasta ENTER are mai multe funcții: ■ Accesează meniul de configurare din modul de măsurare ■ Salvează (confirmă) datele introduse în modul de configurare ■ Trece mai departe într-un grup de funcții
 A0027241	tasta REL În modul manual, puteți utiliza tasta REL pentru a comuta între releu și pornirea manuală a curățării. În modul automat, utilizați tasta REL pentru a citi punctele de pornire (pentru contactorul de limitare) sau valorile de referință (pentru controlerul PID) atribuite releului în cauză. Apăsați tasta PLUS pentru a trece la setările următorului releu. Utilizați tasta REL pentru a reveni la modul de afișare (revenire automată după 30 s).
 A0027234	tasta AUTO Utilizați tasta AUTO pentru a comuta între modul automat și modul manual.



 A0027240	tasta PLUS și tasta MINUS În modul de Configurare, tastele PLUS și MINUS au următoarele funcții: ■ Selectarea grupurilor de funcții. Apăsați tasta MINUS pentru a selecta grupurile de funcții în ordinea indicată în secțiunea „Configurarea sistemului”. ■ Configurarea parametrilor și a valorilor numerice ■ Funcționarea releelor în modul manual În modul de măsurare, dispozitivul afișează următoarele funcții succesiv prin apăsarea repetată a butonului PLUS: ■ Temperatura afișată în °F ■ Temperatura este ascunsă ■ Semnal intrare curent în % ■ Semnal intrare curent în mA ■ Se afișează valoarea conductivității necompensate ■ Reveniți la setările de bază În modul de măsurare, dispozitivul afișează următoarea secvență de informații prin apăsarea repetată a tastei MINUS: ■ Defecțiunile curente sunt afișate consecutiv (max. 10). ■ După ce au fost afișate toate erorile, apare afișajul standard al măsurătorilor. În grupul de funcții F, se poate defini o alarmă separat pentru fiecare cod de eroare.
 A0027237	Funcția Escape Dacă apăsați simultan tastele PLUS și MINUS, reveniți la meniul principal sau înaintați la finalul calibrării în cazul în care calibrați. Dacă apăsați din nou tastele PLUS și MINUS, reveniți la modul de măsurare.
 A0027238	Blocarea tastaturii Apăsați simultan tastele PLUS și ENTER timp de cel puțin 3 secunde pentru a bloca tastatura împotriva oricărei introduceri neautorizate de date. Toate setările pot fi citite în continuare. Caseta codului afișează codul 9999.
 A0027239	Deblocarea tastaturii Apăsați simultan tastele CAL și MINUS, timp de cel puțin 3 secunde, pentru a debloca tastatura. Caseta codului afișează codul 0.


6.3 Accesul la meniul de operare prin intermediul afișajului local

6.3.1 Modul automat/manual

În mod normal, transmițătorul funcționează în modul automat. În acest caz, releele sunt declanșate de transmițător. În modul manual, puteți declanșa manual releele folosind tasta REL sau puteți porni funcția de curățare.

Comutarea modurilor de operare:

 A0027242	1. Transmițătorul este în modul automat. LED-ul superior (verde) de lângă tasta AUTO este aprins.
 A0027243	2. Apăsați tasta AUTOMAT.
 A0027240	3. Pentru a activa modul manual, introduceți codul 22 cu ajutorul tastelor PLUS și MINUS și apăsați ENTER pentru a confirma. LED-ul inferior (modul manual) este aprins.
 A0027241	4. Selectați releul sau funcția. Utilizați tasta REL pentru a comuta între rele. Releul selectat și starea comutatorului (ON/OFF) sunt afișate pe al doilea rând al afișajului. În modul manual, valoarea măsurată este afișată continuu (de exemplu, pentru monitorizarea valorii măsurate pentru funcțiile de dozare).

 A0027240	5.	Pornire/oprire rele. Releul este pornit folosind tasta PLUS și oprit cu tasta MINUS. Releul rămâne în starea selectată până când este pornit/oprit din nou.
 A0027234	6.	Apăsați tasta AUTOMAT pentru a reveni la modul de măsurare, adică la modul automat. Toate relele sunt declanșate din nou de către transmițător.



- Modul de operare rămâne activ chiar și după o întrerupere a alimentării cu curent. Relele intră însă în starea de repaus.
- Modul manual are prioritate față de toate celelalte funcții automate.
- Blocarea pieselor de fixare nu este posibilă în modul manual.
- Setările manuale sunt păstrate până când sunt resetate activ.
- Codul de eroare E102 este semnalizat în timpul funcționării manuale.

6.3.2 Concept de operare

Moduri de operare

Mod de calibrare

1. Apăsați tasta **CAL**.
2. Introduceți codul 22 folosind tastele +/-.
3. Apăsați tasta **CAL** din nou.

Mod de setare

1. Apăsați tasta **E**.
2. Introduceți codul 22 folosind tastele +/-.
3. Apăsați tasta **E** din nou.



Dacă nu se apasă pe nicio tastă în modul de setare timp de circa 15 minute, dispozitivul revine automat la modul de măsurare. Orice menținere activă (menținere în timpul setării) este anulată.

Coduri de acces

Toate codurile de acces la dispozitiv sunt fixe și nu pot fi modificate. Când dispozitivul solicită codul de acces, face diferența între coduri diferite.


- **Tasta CAL + codul 22:** acces la meniurile Calibration și Offset
- **Tasta ENTER + codul 22:** acces la meniuri pentru parametri care fac posibile setările de configurare și cele specifice utilizatorului
- **Tastele PLUS + ENTER** simultan (min. 3 s): blocați tastatura
- **Tastele CAL + MINUS** simultan (min. 3 s): deblocați tastatura
- **Tasta CAL sau ENTER + orice cod:** acces la modul de citire, respectiv toate setările pot fi citite, dar nu modificate.
Dispozitivul continuă măsurarea în modul de citire. Nu se trece la starea „Hold”. Ieșirea de curent și controlarele rămân active.

Structura meniului

Funcțiile de configurare și de calibrare sunt aranjate în grupuri de funcții.

- În modul de setare, selectați un grup de funcții cu tastele PLUS și MINUS.
- În grupul de funcții propriu-zis, comutați de la o funcție la alta cu ajutorul tastei ENTER.
- În cadrul funcției, selectați din nou opțiunea dorită cu tastele PLUS și MINUS sau editați setările cu aceste taste. Apoi, confirmați cu tasta ENTER și continuați.
- Apăsăți simultan pe tastele PLUS și MINUS (funcția Escape) pentru a părăsi modul programare (revenire la meniul principal).
- Apăsăți din nou simultan pe tastele PLUS și MINUS pentru a comuta la modul de măsurare.

 Dacă o setare modificată nu este confirmată prin apăsarea tastei ENTER, se păstrează setarea veche.

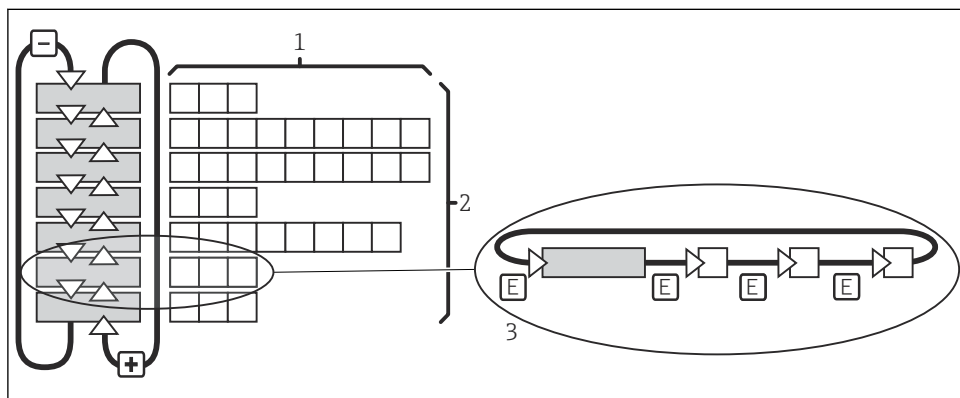

A0059578

15 Structura meniului

- 1 Funcții (selectarea parametrilor, introducerea numerelor)
- 2 Grupuri de funcții, derulare înainte și înapoi cu tastele PLUS și MINUS
- 3 Comutați de la o funcție la alta cu ajutorul tastei ENTER

7 Punerea în funcțiune

7.1 Verificarea funcțiilor

Conectare incorectă, tensiune de alimentare incorectă

Riscuri privind siguranța personalului și defecțiuni ale dispozitivului!

- ▶ Verificați dacă toate conexiunile au fost corect realizate, în conformitate cu schema de conexiuni.
- ▶ Asigurați-vă că tensiunea de alimentare coincide cu tensiunea înscrisă pe plăcuța de identificare.

7.2 Pornirea dispozitivului

Familiarizați-vă cu funcționarea transmițătorului înainte de a-l porni pentru prima dată. Citiți mai ales secțiunile „Instrucțiuni de siguranță de bază” și „Opțiuni de operare”. După pornire, dispozitivul execută o testare automată, iar apoi trece în modul de măsurare.

Acum calibrați senzorul conform instrucțiunilor din secțiunea „Calibrare”.



În timpul punerii inițiale în funcțiune, senzorul trebuie calibrat astfel încât sistemul de măsurare să poată returna date de măsurare precise.

Apoi, efectuați prima configurare în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea „Setare rapidă”. Valorile setate de utilizator sunt păstrate chiar și în cazul unei căderi de tensiune.

Următoarele grupuri de funcții sunt disponibile în transmițător (grupurile care sunt disponibile numai cu Pachetul Plus sunt marcate în mod corespunzător în descrierea funcțională):

Mod de setare

- SETUP 1 (A)
- SETUP 2 (B)
- CURRENT INPUT (Z)
- CURRENT OUTPUT (O)
- ALARM (F)
- CHECK (P)
- RELAY (R)
- TEMPERATURE COMPENSATION (T)
- CONCENTRATION MEASUREMENT (K)
- SERVICE (S)
- E+H SERVICE (E)
- INTERFACE (I)

Mod de calibrare

CALIBRATION (C)



Pentru o explicație detaliată a grupurilor de funcții disponibile în transmițător, consultați secțiunea „Configurarea dispozitivului”.

SETUP HOLD

2^S

F3

Err.delay

1

2

A0060196

1

Indicator funcție: codul afișat indică poziția funcției în grupul de funcții.

2

Informații suplimentare

16 Informații pentru utilizator pe afișaj

C

C1

C131

C121

C111

C132

C133

A0027502

Pentru a vă ajuta să selectați și să găsiți mai ușor grupuri de funcții și funcții, pentru fiecare funcție este afișat un cod pentru câmpul corespunzător

Structura acestui cod este afișată în → 17.

Grupurile de funcții sunt indicate sub formă de litere în prima coloană (consultați numele grupurilor de funcții). Funcțiile grupurilor individuale sunt afișate în mod incremental pe rânduri și pe coloane.

17 Cod funcție

7.3 Ghid de pornire rapidă

După pornire, trebuie să efectuați unele setări pentru a configura cele mai importante funcții ale transmîțătorului care sunt necesare pentru o măsurare corectă. În secțiunea următoare este prezentat un exemplu în acest sens.

Intrare utilizator		Interval de reglare (setările din fabrică cu aldine)
1.	Apăsați tasta ENTER.	
2.	Introduceți codul 22 pentru acces deschis la meniuri. Apăsați tasta ENTER.	
3.	Apăsați tasta MINUS până când este afișat grupul de funcții „Service”.	
4.	Apăsați tasta ENTER pentru a efectua setările necesare.	
5.	S1 În S1, selectați limba, de exemplu, „ENG” pentru engleză. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	ENG = Engleză GER = Germană FRA = Franceză ITA = Italiană NEL = Olandeză ESP = Spaniolă
6.	Apăsați simultan tastele PLUS și MINUS pentru a ieși din grupul de funcții „Service”.	
7.	Apăsați tasta MINUS până când este afișat grupul de funcții „Setup 1”.	
8.	Apăsați tasta ENTER pentru a efectua setările pentru „Setup 1”.	

Endress+Hauser

27

Intrare utilizator		Interval de reglare (setările din fabrică cu aldine)
9.	A1 În A1, selectați modul de funcționare dorit, de exemplu, „cond” = conductiv. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	cond = conductiv ind = inductiv MOhm = rezistență Conc = concentrație
10.	A2 În A2, apăsați tasta ENTER pentru a accepta setarea din fabrică. (Numai dacă A1 = conc, în caz contrar continuați cu etapa 12)	% ppm mg/l TDS = total solide dizolvate Niciunul
11.	A3 În A3, apăsați pe ENTER pentru a accepta setarea standard.	XX.xx X.xxx XXX.x XXXX
12.	A4 În A4, apăsați pe ENTER pentru a accepta setarea standard.	auto , $\mu\text{S}/\text{cm}$, mS/cm , S/cm , $\mu\text{S}/\text{m}$, mS/m , S/m
13.	A5 În A5, introduceți constanta de celulă exactă a senzorului. Constanta de celulă este indicată în certificatul de calitate al senzorului.	cond: 1,000 cm^{-1} ind: 1,98 cm^{-1} MOhm: 0,01 cm^{-1} Între 0,0025 și 99,99 cm^{-1}
14.	A6 Introduceți rezistența cablului (se aplică numai senzorilor conductivi) în A6.	Rezistența cablului: 0 Ω Între 0 și 99,99 Ω
15.	A7 Introduceți amortizarea valorii măsurate în A7. Amortizarea valorii măsurate determină media valorii măsurate pe baza numărului specificat de valori individuale măsurate (dacă A7 = 1, nu are loc amortizarea). Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER. Ecranul revine la afișarea inițială a grupului de funcții „Setup 1”.	1 De la 1 la 60
16.	Apăsați tasta MINUS până când este afișat grupul de funcții „Setup 2”. Apăsați tasta ENTER pentru a efectua setările pentru „Setup 2”.	
17.	B1 În B1, selectați senzorul de temperatură. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	Pt100 Pt1k = Pt 1000 NTC30 Fixat
18.	B2 În B2, selectați tipul de compensare a temperaturii adecvat pentru proces, de exemplu, „lin” = liniar. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER. Pentru informații detaliate, consultați secțiunea „Configurare 2”.	Niciunul Lin = liniar NaCl = sare de masă (IEC 746) Pure = apă ultrapură NaCl PureH = apă ultrapură HCl Tab = Tabel
19.	B3 În B3, introduceți coeficientul de temperatură α . Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	2.1 %/K între 0,0 și 20,0%/K

Intrare utilizator		Interval de reglare (setările din fabrică cu aldine)
20.	B5 Temperatura curentă este afișată în B5. Dacă este necesar, reglați senzorul de temperatură la o măsurare externă. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	Valoarea reală afișată și introdusă De la -35,0 la 250,0 °C
21.	Se afișează diferența dintre temperatura măsurată și cea introdusă. Apăsați tasta ENTER. Ecranul revine la afișarea inițială a grupului de funcții „Setup 2”.	0.0 °C De la -5,0 la 5,0 °C
22.	Apăsați tasta MINUS pentru a ajunge la grupul de funcții „Current output”. Apăsați tasta ENTER pentru a configura setările pentru ieșirile de curent.	
23.	O1 În O1, selectați ieșirea de curent, de exemplu, „Out 1” = ieșire 1. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	Out 1 Out 2
24.	O3 În O3, selectați caracteristica liniară. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	Lin = liniar (1) Lin = liniar (1) Tab = Tabel
25.	O311 În O311, selectați intervalul de curent pentru ieșirea de curent, de exemplu, de la 4 la 20 mA. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	Între 4 și 20mA Între 0 și 20 mA
26.	O312 În O312, specificați conductivitatea la care este aplicată valoarea minimă a curentului la ieșirea transmițătorului, de ex., 0 μS/cm. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER.	Cond/ind: 0,00 μS/cm MOhm: 0,00 kΩ·cm Conc: 0.00 % Temp: 0,00 °C
27.	O313 În O313, specificați conductivitatea la care este aplicată valoarea minimă a curentului la ieșirea transmițătorului, de ex., 2000 mS/cm. Confirmați introducerea apăsând tasta ENTER. Ecranul revine la afișarea inițială a grupului de funcții „Current output”.	Cond/ind: 2000 mS/cm MOhm: 500 kΩ·cm Conc: 99.99 % Temp: 150 °C
28.	Apăsați simultan pe PLUS și MINUS pentru a comuta la modul de măsurare.	



Efectuați o reglare de aer înainte de a instala senzorul de conductivitate inductivă. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Calibrare”.



71724050

www.addresses.endress.com
