

Einbauanleitung **Gehäuse**


Gammapilot, Cerabar, Deltabar



1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Eine defekte Einheit nur gegen eine funktionierende Einheit des gleichen Typs ersetzen.
- Nur Originalteile von Endress+Hauser verwenden.
- Im W@M Device Viewer prüfen, ob das Ersatzteil zum vorliegenden Gerät passt.

 Bei einigen Geräten befindet sich im Inneren des Gerätes eine Ersatzteilübersicht. Ist das Ersatzteilset dort aufgelistet, entfällt die Überprüfung.

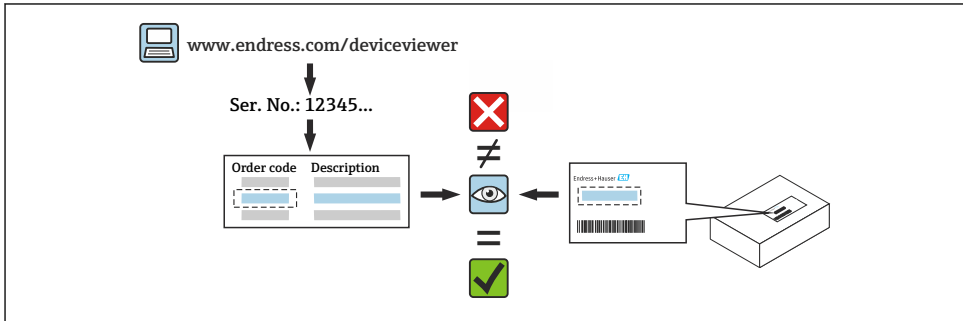

2 Reparaturberechtigte Personen

Das Fachpersonal muss folgende Anforderungen für Reparatur, Montage, elektrische Installation und Inbetriebnahme der Geräte erfüllen:

- In Gerätesicherheit ausgebildet.
- Mit den jeweiligen Einsatzbedingungen der Geräte vertraut.
- Bei Ex-zertifizierten Geräten: zusätzlich im Explosionsschutz ausgebildet.

 Das Fachpersonal, das eine Arbeit vornimmt, übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit während der Arbeiten, die Qualität der Ausführung und die Sicherheit des Geräts nach der Arbeit.

3 Sicherheitshinweise







- Die Betriebsanleitung zum Gerät beachten.
- Nationale Vorschriften bezüglich der Montage, elektrischen Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur einhalten.
- Gerät unter Spannung! Lebensgefahr durch Stromschlag. Gerät nur im spannungslosen Zustand öffnen.
- Bei Geräten für den explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.
- Bei Geräten in sicherheitstechnischen Applikationen gemäß IEC 61508 bzw. IEC 61511: Nach Reparatur Neuinbetriebnahme gemäß Betriebsanleitung durchführen.

- Vor einem Geräteausbau: Prozess in sicheren Zustand bringen und Leitung von gefährlichen Prozessstoffen befreien.
- Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Vor Arbeitsbeginn: Anlage und Gerät auf berührungssichere Temperatur abkühlen.
- Bei Geräten im abrechnungspflichtigen Verkehr: Nach Entfernen der Plombe ist der geeichte Zustand aufgehoben.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile! Eine ESD-geschützte Arbeitsumgebung herstellen.
- Nach Entfernen der Elektronikabdeckung: Stromschlaggefahr durch aufgehobenen Berührungsschutz! Gerät ausschalten, bevor interne Abdeckungen entfernt werden.
- Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.
- Gehäuse nur kurzzeitig öffnen. Eindringen von Fremdkörpern, Feuchtigkeit oder Verunreinigung vermeiden.
- Defekte Dichtungen nur durch Original-Dichtungen von Endress+Hauser ersetzen.
- Defekte Gewinde erfordern eine Instandsetzung des Geräts.
- Gewinde (z. B. von Elektronikraum- und Anschlussraumdeckel) nicht fetten.
- Wenn bei den Reparaturarbeiten Abstände reduziert oder die Spannungsfestigkeit des Geräts nicht sichergestellt ist: Prüfung nach Abschluss der Arbeiten durchführen (z. B. Hochspannungstest gemäß Herstellerangaben).
- Servicestecker:
 - Nicht in explosionsfähiger Atmosphäre anschließen.
 - Nur an Servicegeräte von Endress+Hauser anschließen.
- Die in der Betriebsanleitung aufgeführten Hinweise zum Transport und zur Rücksendung beachten.




Bei Fragen über Service und Ersatzteile, Endress+Hauser Vertriebsstelle kontaktieren.

4 Werkzeugliste

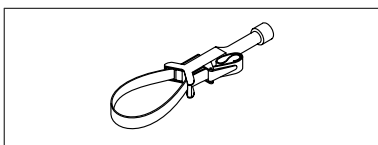

5 Gehäuseausführung

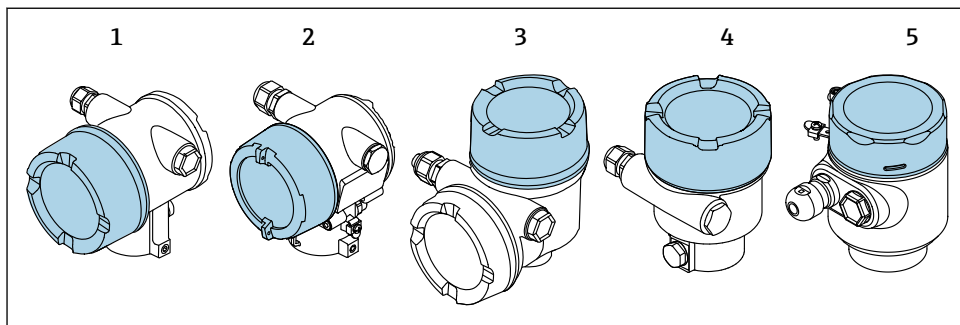


- 1 Zweikammergehäuse
- 2 Zweikammergehäuse Edelstahl, Feinguss
- 3 Zweikammergehäuse L-Form
- 4 Einkammergehäuse
- 5 Einkammergehäuse 316L Hygiene

6 Ausbau


6.1 Zweikammergehäuse (nicht L-Form)

6.1.1 Deckelsicherung lösen und Deckel demontieren


i Anzugsdrehmoment beim Einbau beachten.

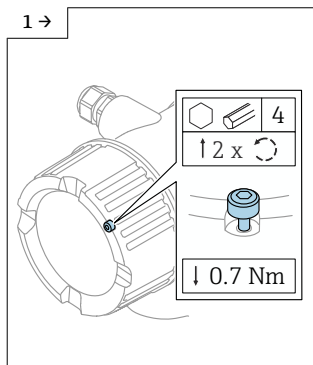


- Optional: Deckelsicherung.
- Wenn vorhanden: Deckelsicherungsschraube mit Innensechskantschlüssel lösen.
- **i** Die Sicherungsschraube darf nicht über den unteren Deckelrand herausstehen. Vor und während dem Zuschrauben des Deckels die Position der Sicherungsschraube beachten.

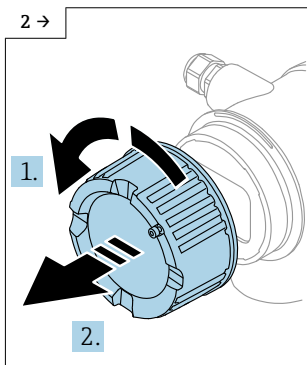

- Deckel abschrauben.

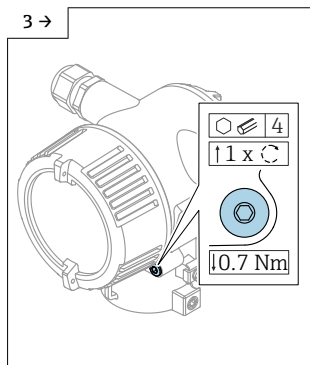


- Optional: Deckelsicherung Zweikammergehäuse Edelstahl, Feinguss.
- Spannung zwischen Deckel und Deckelsicherungsschraube lösen. Hierzu Deckelsicherungsschraube in Anzugsrichtung drehen.

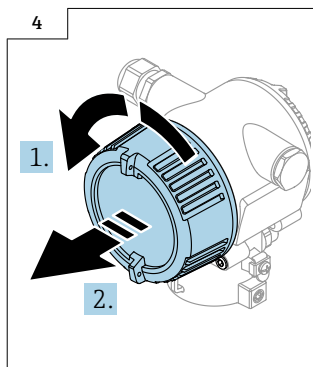

- Deckel abschrauben.


6.1.2 Optional: Anzeige demontieren

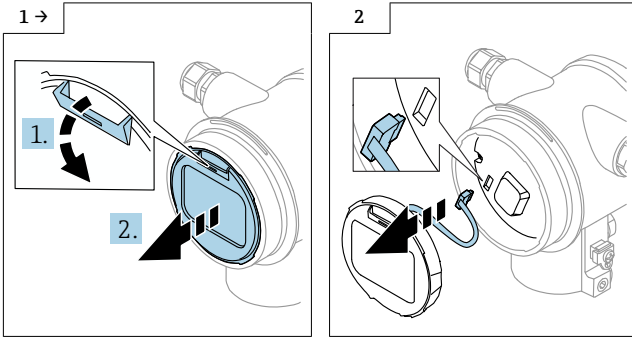


- Entriegelung betätigen und Anzeigemodul herausziehen.
- Steckverbindung lösen.

6.1.3 Elektronik demontieren


i Anzugsdrehmoment beim Einbau beachten.

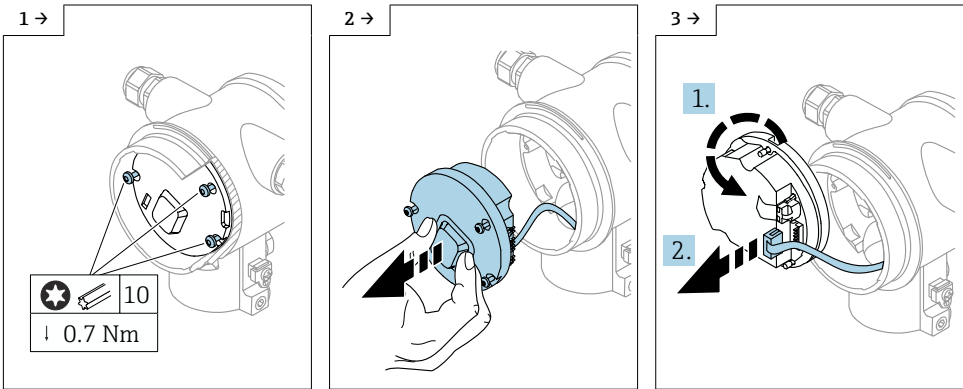

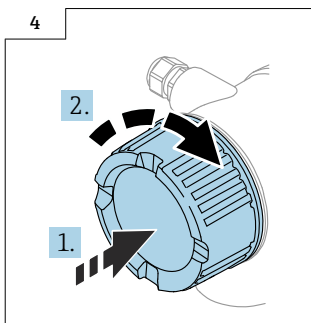


- Schutz gewährleisten: Deckel wieder fest auf das Gehäuse schrauben.
- Wenn vorhanden: Deckelsicherungsschraube mit Innensechskantschlüssel festziehen 0,7 Nm (0,52 lbf ft).


6.1.4 Gehäuse von der Sensorbaugruppe trennen

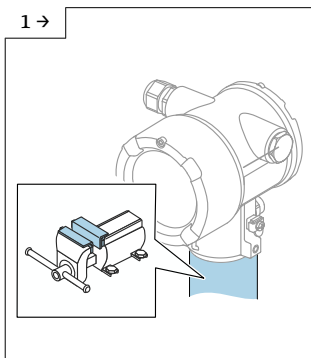


- Sensorbaugruppe und Gehäuse vor Beschädigung schützen. Schraubstock mit Schutzbacken verwenden.

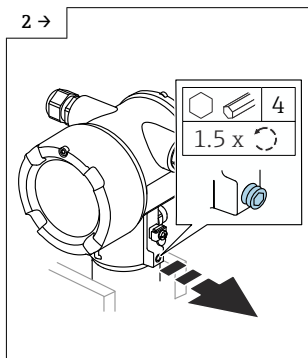


- Gehäusesicherung nur bei Aluminium- und Edelstahlgehäuse.

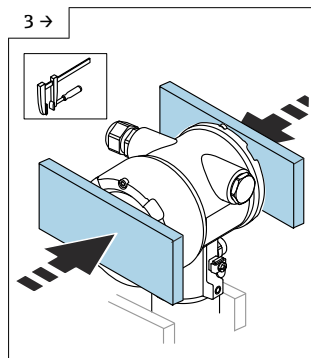


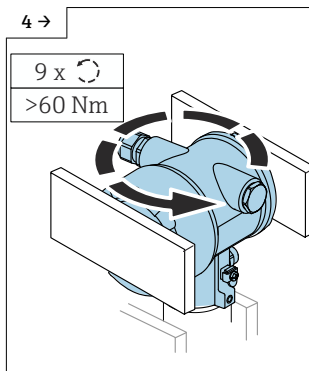


- Gehäuse mit hohem Kraftaufwand (> 60 Nm) mit geeignetem Hilfsmittel abschrauben. Dabei mehrmalige Krafteinwirkung in und gegen die Schraubrichtung anwenden, der Sicherungsring wird dabei bewusst zerstört. Beschichtung des Gehäuses nicht beschädigen.

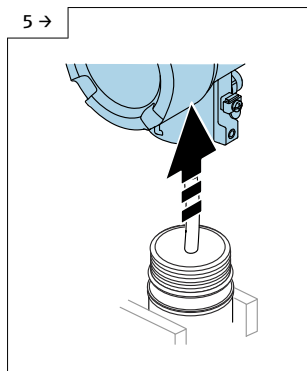

- Gehäuse vorsichtig von der Sensorbaugruppe abnehmen, das Sensorkabel dabei nicht beschädigen.

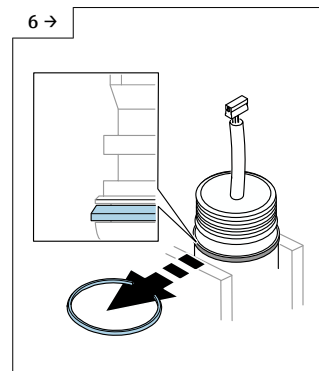

- Sicherungsring entfernen.



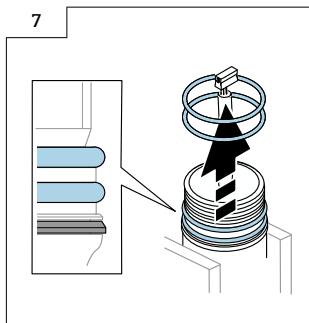


- O-Ringe entfernen.

6.2 Einkammergehäuse und Zweikammergehäuse L-Form

6.2.1 Deckelsicherung lösen und Deckel demontieren


i Anzugsdrehmoment beim Einbau beachten.

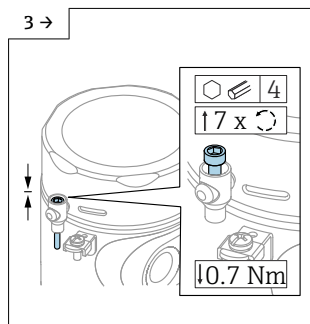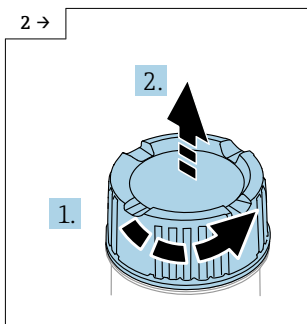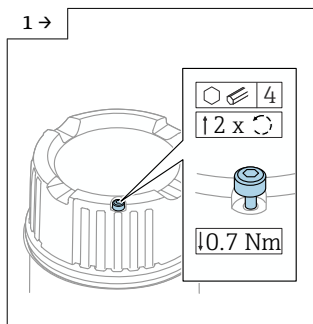

- Optional: Deckelsicherung.
- Wenn vorhanden: Deckelsicherungsschraube mit Innensechskantschlüssel lösen.
- **i** Die Sicherungsschraube darf nicht über den unteren Deckelrand herausstehen (gilt nicht für Einkammergehäuse 316L Hygiene). Vor und während dem Zerschrauben des Deckels die Position der Sicherungsschraube beachten.


► Deckel abschrauben.

► Optional: Deckelsicherung Einkammergehäuse 316L Hygiene

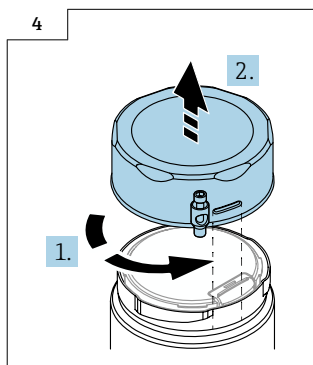


► Deckel aufdrehen.

6.2.2 Optionale Anzeige demontieren

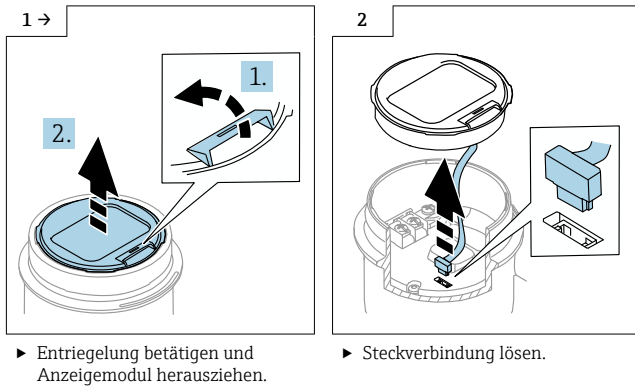

6.2.3 Optionales Transmitter VU140 demontieren






- Bei Kundenverdrahtung: Schritt 1, 2, 3
- Bei M12: Schritt 2, 3

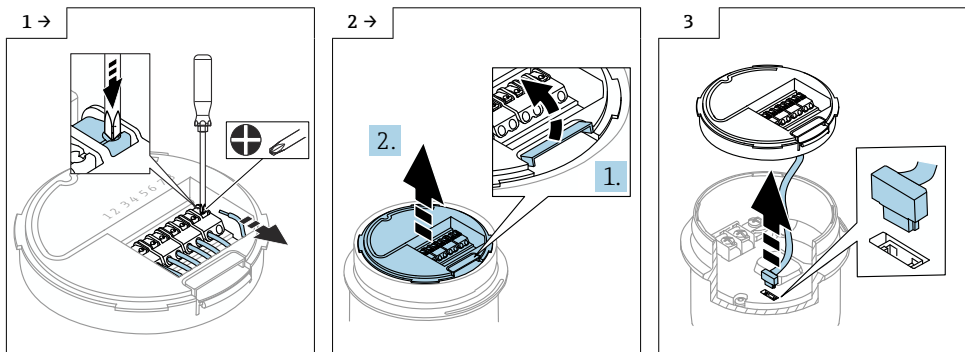


6.2.4 Hauptelektronik demontieren

- i** Anzugsdrehmoment beim Einbau beachten.


- Einkammergehäuse: Schritt 1, 2, 4, 5
- Zweikammergehäuse L-Form: Schritt 3, 4, 5

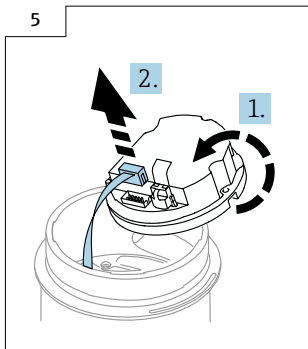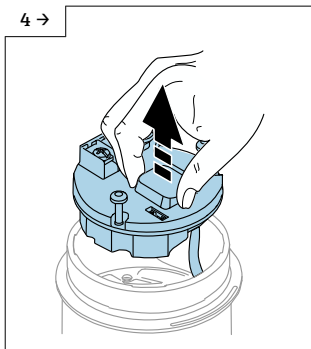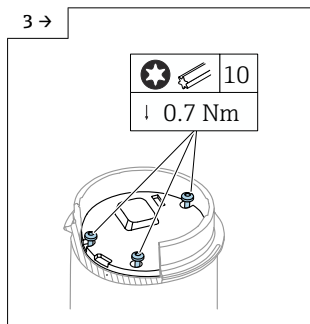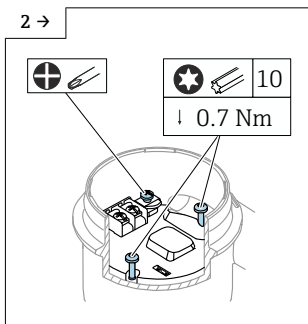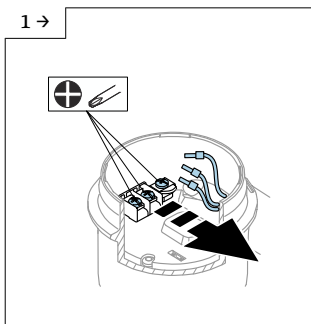


6.2.5 Gehäuse von der Sensorbaugruppe trennen

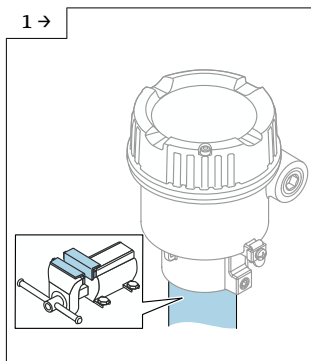


- Sensorbaugruppe und Gehäuse vor Beschädigung schützen. Schraubstock mit Schutzbacken verwenden.

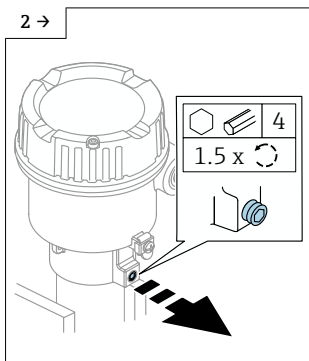


- Gehäusesicherung nur bei Aluminium- und Edelstahlgehäuse. Nicht bei Kunststoff- und Hygienegehäuse.

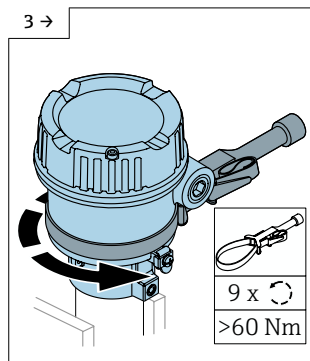

- Gehäuse mit hohem Krafteufwand (> 60 Nm) mit geeignetem Hilfsmittel abschrauben. Greifposition unterhalb der Kabeleinführung ansetzen. Dabei mehrmalige Krafteinwirkung in und gegen die Schraubrichtung anwenden, der Sicherungsring wird dabei bewusst zerstört. Beschichtung des Gehäuses nicht beschädigen.

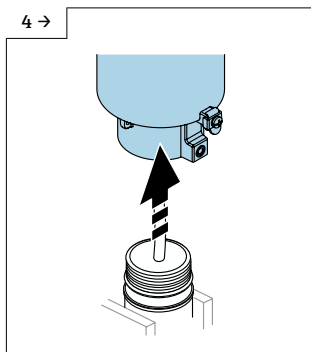

- Gehäuse vorsichtig von der Sensorbaugruppe abnehmen, das Sensorkabel dabei nicht beschädigen.

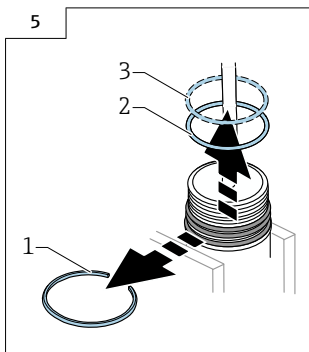

- O-Ring (2) und Sicherungsring (1) entfernen.
- Ringfeder (3) bei Kunststoff- und Hygienegehäuse
- Optional: O-Ring (3) bei Aluminium- und Edelstahlgehäuse zusätzlich entfernen.

7 Einbau

7.1 Genereller Einbauhinweis



Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.

7.2 Spezielle Einbauhinweise


7.2.1 Neues Gehäuse montieren

Die Vorgehensweise ist für alle Gehäuse- und Sensortypen gleich.


Beispiel: Zweikammergehäuse

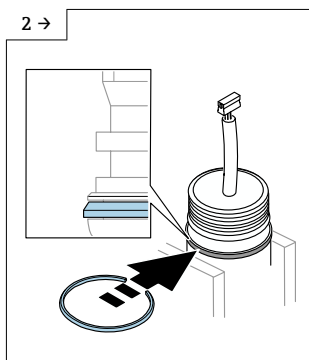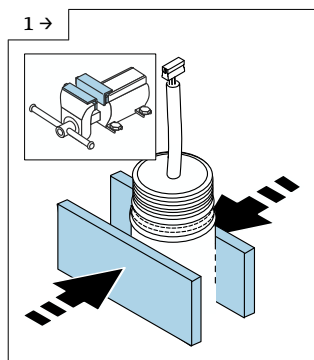


► Sicherungsring montieren

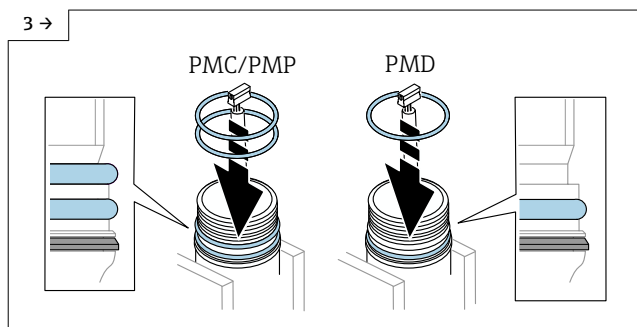

► O-Ringe montieren

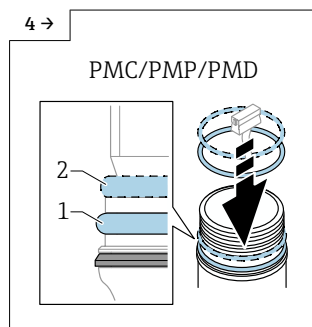


- Optional: Kunststoff- und Hygienegehäuse
- (1) O-Ring montieren
 - (2) Ringfeder montieren

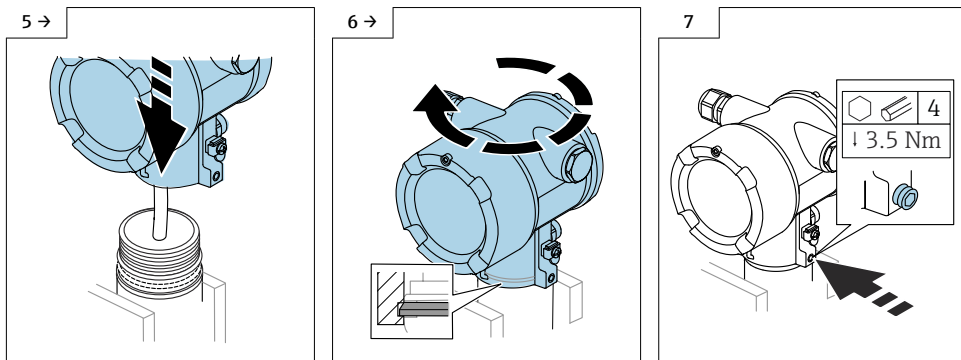

► Gehäusesicherung nur bei Aluminium- und Edelstahlgehäuse.
Nicht bei Kunststoff- und Hygienegehäuse.

7.2.2 Bei abgesetzter Anzeige FHX50B: Klemmenbelegung beachten

Die Klemmenbelegungen an Transmitter VU140 und an Receiver VU141 müssen übereinstimmen (alle Klemmen (1 bis 8)). Kabelschirm beidseitig an die Erdungsklemmen anschließen.

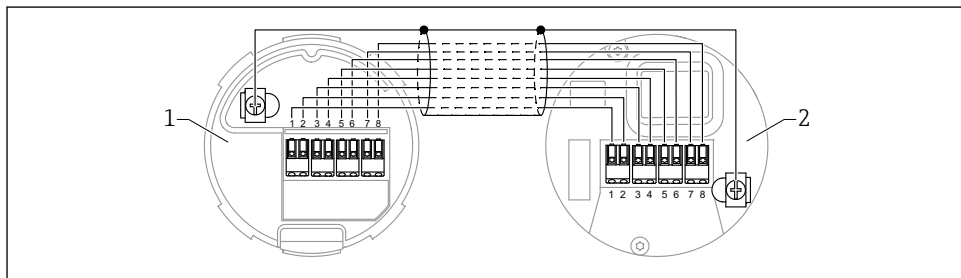

1 Transmitter VU140

2 Receiver VU141

8 Entsorgung

 Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.



71719225

www.addresses.endress.com
