

Instruções de operação **Proline Prowirl O 200** **FOUNDATION Fieldbus**

Medidor de vazão Vortex



- Certifique-se de que o documento está armazenado em um local seguro, de modo que esteja sempre disponível ao trabalhar no equipamento ou com o equipamento.
- Para evitar perigo para os indivíduos ou instalações, leia atentamente a seção "Instruções básicas de segurança", bem como todas as demais instruções de segurança contidas no documento que sejam específicas dos procedimentos de trabalho.
- O fabricante reserva-se o direito de modificar dados técnicos sem aviso prévio. Sua organização de vendas Endress+Hauser irá lhe fornecer informações atualizadas e atualizações a este manual.

Sumário

1 Sobre este documento	6	6.1.2 Especificações ambientais e de processo	25
1.1 Função do documento	6	6.2 Instalação do equipamento	28
1.2 Símbolos	6	6.2.1 Ferramentas necessárias	28
1.2.1 Símbolos de segurança	6	6.2.2 Preparação do medidor	28
1.2.2 Símbolos de elétrica	6	6.2.3 Instalação do sensor	28
1.2.3 Símbolos específicos de comunicação	6	6.2.4 Instalação do transmissor da versão remota	29
1.2.4 Símbolos das ferramentas	7	6.2.5 Giro do invólucro do transmissor	30
1.2.5 Símbolos para certos tipos de informação	7	6.2.6 Giro do módulo do display	30
1.2.6 Símbolos em gráficos	7	6.3 Verificação pós-montagem	31
1.3 Documentação	8		
1.4 Marcas comerciais registradas	8		
2 Instruções de segurança	9	7 Conexão elétrica	32
2.1 Especificações para o pessoal	9	7.1 Segurança elétrica	32
2.2 Uso indicado	9	7.2 Especificações de conexão	32
2.3 Segurança no local de trabalho	10	7.2.1 Ferramentas necessárias	32
2.4 Segurança da operação	10	7.2.2 Especificações para o cabo de conexão	32
2.5 Segurança do produto	10	7.2.3 Cabo de conexão para versão remota	32
2.6 Segurança de TI	10	7.2.4 Esquema de ligação elétrica	34
2.7 Segurança de TI específica do equipamento	11	7.2.5 Atribuição do pino do plugue do equipamento	34
2.7.1 Proteção de acesso através da proteção contra gravação de hardware	11	7.2.6 Blindagem e aterramento	34
2.7.2 Proteção de acesso através de senha	11	7.2.7 Especificações para a unidade de alimentação	36
2.7.3 Acesso através do fieldbus	11	7.2.8 Preparação do instrumento de medição	36
3 Descrição do produto	13	7.3 Conexão do equipamento	37
3.1 Design do produto	13	7.3.1 Conexão da versão compacta	37
4 Recebimento e identificação do produto	14	7.3.2 Conexão da versão remota	38
4.1 Recebimento	14	7.4 Equalização de potencial	43
4.2 Identificação do produto	14	7.4.1 Requisitos	43
4.2.1 Etiqueta de identificação do transmissor	15	7.5 Garantia do grau de proteção	43
4.2.2 Etiqueta de identificação do sensor	16	7.6 Verificação pós-conexão	43
4.2.3 Símbolos no equipamento	19		
5 Armazenamento e transporte	20	8 Opções de operação	45
5.1 Condições de armazenamento	20	8.1 Visão geral das opções de operação	45
5.2 Transporte do produto	20	8.2 Estrutura e função do menu de operação	46
5.2.1 Medidores sem olhais de elevação	20	8.2.1 Estrutura geral do menu de operação	46
5.2.2 Medidores com olhais de elevação	21	8.2.2 Conceito de operação	47
5.2.3 Transporte com empilhadeira	21	8.3 Acesso ao menu de operação através do display local	48
5.3 Descarte de embalagem	21	8.3.1 Display de operação	48
6 Instalação	22	8.3.2 Visualização de navegação	50
6.1 Requisitos de instalação	22	8.3.3 Visualização para edição	52
6.1.1 Posição de instalação	22	8.3.4 Elementos de operação	53
		8.3.5 Abertura do menu de contexto	54
		8.3.6 Navegar e selecionar a partir da lista	56
		8.3.7 Chamada de parâmetro diretamente	56
		8.3.8 Chamada de texto de ajuda	57
		8.3.9 Alterar parâmetros	58
		8.3.10 Funções de usuário e autorização de acesso relacionada	59

<p>8.3.11 Desabilitação da proteção contra gravação através do código de acesso 59</p> <p>8.3.12 Habilitação e desabilitação do bloqueio do teclado 60</p> <p>8.4 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação 60</p> <p>8.4.1 Conexão da ferramenta de operação .. 60</p> <p>8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370 62</p> <p>8.4.3 FieldCare 62</p> <p>8.4.4 DeviceCare 63</p> <p>8.4.5 Gerenciador de equipamento AMS ... 64</p> <p>8.4.6 Comunicador de campo 475 64</p> <p>9 Integração do sistema 65</p> <p>9.1 Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento 65</p> <p>9.1.1 Dados da versão atual para o equipamento 65</p> <p>9.1.2 Ferramentas de operação 65</p> <p>9.2 Dados de transmissão cíclica 65</p> <p>9.2.1 Modelo do bloco 66</p> <p>9.2.2 Descrição dos módulos 66</p> <p>9.2.3 Tempos de execução 69</p> <p>9.2.4 Métodos 69</p> <p>10 Comissionamento 71</p> <p>10.1 Verificação da função 71</p> <p>10.2 Ativação do medidor 71</p> <p>10.3 Configuração do idioma de operação 71</p> <p>10.4 Configuração do medidor 72</p> <p>10.4.1 Definição do nome de tag 72</p> <p>10.4.2 Configuração das unidades do sistema 73</p> <p>10.4.3 Selecione e configuração do meio 77</p> <p>10.4.4 Configurar as entradas analógicas ... 80</p> <p>10.4.5 Configurando o display local 80</p> <p>10.4.6 Configurar o corte de vazão baixa 83</p> <p>10.5 Configurações avançadas 84</p> <p>10.5.1 Configuração das propriedades da mídia 85</p> <p>10.5.2 Realização da compensação externa .. 98</p> <p>10.5.3 Execução do ajuste do sensor 100</p> <p>10.5.4 Configuração do pulso/frequência/ saída comutada 102</p> <p>10.5.5 Configuração do totalizador 107</p> <p>10.5.6 Execução de configurações de display adicionais 109</p> <p>10.5.7 Gerenciamento de configuração 112</p> <p>10.5.8 Usando os parâmetros para a administração do equipamento 113</p> <p>10.6 Simulação 114</p> <p>10.7 Proteção das configurações contra acesso não autorizado 116</p> <p>10.7.1 Proteção contra gravação através do código de acesso 116</p>	<p>10.7.2 Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação 117</p> <p>10.7.3 Proteção contra gravação através de operação de bloqueio 119</p> <p>10.8 Configuração do medidor através do FOUNDATION Fieldbus 120</p> <p>10.8.1 Configuração do bloco 120</p> <p>10.8.2 Dimensionamento do valor medido no bloco de entrada analógica 121</p> <p>10.9 Comissionamento para aplicação específica . 122</p> <p>10.9.1 Aplicações com vapor 122</p> <p>10.9.2 Aplicação em líquido 122</p> <p>10.9.3 Aplicações gasosas 123</p> <p>10.9.4 Cálculo das variáveis medidas 127</p> <p>11 Operação 131</p> <p>11.1 Leitura do status de bloqueio do equipamento 131</p> <p>11.2 Ajuste do idioma de operação 131</p> <p>11.3 Configuração do display 131</p> <p>11.4 Leitura dos valores medidos 131</p> <p>11.4.1 Variáveis de processo 132</p> <p>11.4.2 Submenu "Totalizador" 134</p> <p>11.4.3 Valores de Saída 135</p> <p>11.5 Adaptação do medidor às condições de processo 136</p> <p>11.6 Reinicialização do totalizador 136</p> <p>11.6.1 Escopo de função de parâmetro "Controlar totalizador" 137</p> <p>11.6.2 Âmbito da parâmetro "Resetar todos os totalizadores" 137</p> <p>11.7 Exibição do registro de dados 137</p> <p>12 Diagnóstico e solução de problemas 141</p> <p>12.1 Localização geral de falhas 141</p> <p>12.2 Informações de diagnóstico no display local . 143</p> <p>12.2.1 Mensagem de diagnóstico 143</p> <p>12.2.2 Recorrendo a medidas corretivas ... 145</p> <p>12.3 Informações de diagnóstico em FieldCare ou DeviceCare 145</p> <p>12.3.1 Opções de diagnóstico 145</p> <p>12.3.2 Acessar informações de correção ... 147</p> <p>12.4 Adaptação das informações de diagnóstico .. 147</p> <p>12.4.1 Adaptação do comportamento de diagnóstico 147</p> <p>12.4.2 Adaptação do sinal de status 148</p> <p>12.5 Visão geral das informações de diagnóstico . 152</p> <p>12.5.1 Diagnóstico do sensor 152</p> <p>12.5.2 Diagnóstico dos componentes eletrônicos 158</p> <p>12.5.3 Diagnóstico de configuração 169</p> <p>12.5.4 Diagnóstico do processo 175</p> <p>12.5.5 Condições de operação para exibição das seguintes informações de diagnóstico 185</p>
---	---

12.5.6 Modo de emergência no caso de compensação de temperatura	185	16.9 Processo	217
12.6 Eventos de diagnóstico pendentes	185	16.10 Construção mecânica	218
12.7 Mensagens de diagnóstico no Bloco Transdutor de DIAGNÓSTICO	186	16.11 Operabilidade	223
12.8 Lista de diag	186	16.12 Certificados e aprovações	225
12.9 Registro de eventos	187	16.13 Pacotes de aplicação	227
12.9.1 Leitura do registro de eventos	187	16.14 Acessórios	227
12.9.2 Filtragem do registro de evento	188	16.15 Documentação	227
12.9.3 Visão geral dos eventos de informações	188		
12.10 Reinicialização do medidor	189	Índice	230
12.10.1 Escopo de função da parâmetro "Restart"	189		
12.10.2 Escopo de função de parâmetro "Reset de Serviços"	189		
12.11 Informações do equipamento	189		
12.12 Histórico do firmware	191		
13 Manutenção	192		
13.1 Tarefas de manutenção	192		
13.1.1 Limpeza externa	192		
13.1.2 Limpeza interior	192		
13.1.3 Substituição das vedações	192		
13.2 Medição e teste do equipamento	192		
13.3 Assistência técnica da Endress+Hauser	192		
14 Reparo	193		
14.1 Notas gerais	193		
14.1.1 Conceito de reparo e conversão	193		
14.1.2 Observações sobre reparo e conversão	193		
14.2 Peças de reposição	193		
14.3 Assistência técnica da Endress+Hauser	194		
14.4 Devolução	194		
14.5 Descarte	194		
14.5.1 Remoção do medidor	195		
14.5.2 Descarte do medidor	195		
15 Acessórios	196		
15.1 Acessórios específicos do equipamento	196		
15.1.1 Para o transmissor	196		
15.1.2 Para o sensor	197		
15.2 Acessórios específicos de comunicação	197		
15.3 Acessórios específicos para serviço	198		
15.4 Componentes do sistema	199		
16 Dados técnicos	200		
16.1 Aplicação	200		
16.2 Função e projeto do sistema	200		
16.3 Entrada	200		
16.4 Saída	207		
16.5 Fonte de alimentação	210		
16.6 Características de desempenho	212		
16.7 Instalação	216		
16.8 Ambiente	216		

1 Sobre este documento

1.1 Função do documento

Estas Instruções de Operação contêm todas as informações necessárias nas diversas fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento à instalação, conexão, operação e comissionamento até a localização de falhas, manutenção e descarte.

1.2 Símbolos

1.2.1 Símbolos de segurança

PERIGO

Este símbolo te alerta para uma situação perigosa. Se essa situação não for evitada, isso resultará em ferimentos sérios ou fatais.

ATENÇÃO

Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente perigosa. Se essa situação não for evitada, isso pode resultar em ferimentos sérios ou fatais..

CUIDADO

Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente perigosa. Se essa situação não for evitada, isso resultará em ferimentos leves ou médios.

AVISO

Este símbolo te alerta para uma situação potencialmente prejudicial. A falha em evitar essa situação pode resultar em danos ao produto ou a algo em suas proximidades.

1.2.2 Símbolos de elétrica

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Gleich- und Wechselstrom
	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Anschluss Potenzialausgleich (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen. Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: <ul style="list-style-type: none">▪ Innere Erdungsklemme: Anschluss Potenzialausgleich wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.▪ Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.2.3 Símbolos específicos de comunicação

Símbolo	Significado
	Rede sem fio de área local (WLAN) Comunicação por uma rede local, sem fio.
	Bluetooth Transmissão de dados sem fio entre equipamentos a uma distância curta por meio de tecnologia de rádio.

1.2.4 Símbolos das ferramentas

Símbolo	Significado
	Chave de fenda plana
	Chave Allen
	Chave de boca

1.2.5 Símbolos para certos tipos de informação

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações que são permitidos.
	Preferível Procedimentos, processos ou ações que são recomendados.
	Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidos.
	Dica Indica informação adicional.
	Referência à documentação
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
	Aviso ou etapa individual a ser observada
	Série de etapas
	Resultado de uma etapa
	Ajuda em caso de problema
	Inspeção visual

1.2.6 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3, ...	Números de itens
1, 2, 3, ...	Série de etapas
A, B, C, ...	Visualizações
A-A, B-B, C-C, ...	Seções
	Área classificada
	Área segura (área não classificada)
	Direção da vazão

1.3 Documentação

- i** Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
 - *Aplicativo de operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série que está na etiqueta de identificação ou escaneie o QR code.

Os seguintes tipos de documentação estão disponíveis na área de downloads do site da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads), dependendo da versão do equipamento::

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento
Informações técnicas (TI)	Auxílio de planejamento para seu equipamento O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que o leva rapidamente ao 1º valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	Referência para seus parâmetros O documento oferece uma explicação detalhada de cada parâmetro individual. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas classificadas também são fornecidas com o equipamento. Elas são parte integral das instruções de operação. i A etiqueta de identificação indica que Instruções de segurança (XA) se aplicam ao equipamento.
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Siga sempre as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.

1.4 Marcas comerciais registradas

FOUNDATION™ Fieldbus

Registro de marca pendente do grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

KALREZ®, VITON®

Marcas registradas da DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, EUA

GYLON®

Marca registrada da Garlock Sealing Technologies, Palmyra, NY, EUA

2 Instruções de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- ▶ Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- ▶ Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- ▶ Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- ▶ Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

O pessoal de operação deve preencher as seguintes especificações:

- ▶ Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietário-operador das instalações.
- ▶ Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

Aplicação e meio

O instrumento de medição neste manual destina-se somente para a medição de vazão de líquidos, gases e vapores.

Dependendo da versão encomendada, o instrumento de medição também pode ser usado para medir substâncias potencialmente explosivas¹⁾, inflamável, tóxico e oxidante.

Os instrumentos de medição para uso em áreas classificadas, em aplicações higiênicas, ou onde há um risco maior devido à pressão de processo, estão identificados de acordo na etiqueta de identificação.

Para garantir que o instrumento de medição esteja em perfeitas condições durante a operação:

- ▶ Apenas use o instrumento de medição em total conformidade com os dados na etiqueta de identificação e condições gerais listadas nas Instruções de operação e documentação complementar.
- ▶ Usando a etiqueta de identificação, verifique se o equipamento solicitado pode ser utilizado em área classificada (por exemplo: proteção contra explosão, segurança de recipiente de pressão).
- ▶ Use o instrumento de medição apenas para meios para os quais as partes molhadas pelo processo sejam adequadamente resistentes.
- ▶ Mantenha dentro da faixa de pressão e temperatura especificadas.
- ▶ Mantenha dentro da faixa de temperatura ambiente especificada.
- ▶ Proteja o instrumento de medição permanentemente contra a corrosão por intempéries.

Uso indevido

O uso não indicado pode comprometer a segurança. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

⚠ ATENÇÃO

Risco de quebra devido a fluidos corrosivos ou abrasivos e às condições ambientes!

- ▶ Verifique a compatibilidade do fluido do processo com o material do sensor.
- ▶ Certifique-se de que há resistência de todas as partes molhadas pelo fluido no processo.
- ▶ Mantenha dentro da faixa de pressão e temperatura especificadas.

1) Não aplicável a instrumentos de medição IO-Link

AVISO**Verificação de casos limites:**

- Para fluidos especiais ou fluidos para limpeza, a Endress+Hauser fornece assistência na verificação da resistência à corrosão de partes molhadas por fluido, mas não assume qualquer responsabilidade ou dá nenhuma garantia, uma vez que mudanças de minutos na temperatura, concentração ou nível de contaminação no processo podem alterar as propriedades de resistência à corrosão.

Risco residual**⚠ CUIDADO**

Risco de queimaduras por calor ou frio! O uso de mídia e eletrônicos com temperaturas altas ou baixas pode gerar superfícies quentes ou frias no dispositivo.

- Instale uma proteção contra toque adequada.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.

2.4 Segurança da operação

Dano ao equipamento!

- Opere o equipamento apenas em condições técnicas adequadas e condições de segurança.
- O operador é responsável pela operação do equipamento livre de interferência.

Modificações aos equipamentos

Modificações não autorizadas ao equipamento não são permitidas e podem levar a perigos imprevisíveis!

- Se, mesmo assim, for necessário fazer modificações, consulte o fabricante.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

- Executar reparos no equipamento somente se eles forem expressamente permitidos.
- Observe as regulamentações nacionais/federais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- Use apenas acessórios e peças de reposição originais.

2.5 Segurança do produto

Este equipamento de última geração foi projetado e testado de acordo com as boas práticas de engenharia para atender às normas de segurança da operação. Ele saiu da fábrica em uma condição segura para ser operado.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Ele atende também as diretrizes da UE listadas na Declaração de Conformidade da UE específica para este equipamento. O fabricante confirma isto ao afixar a identificação CE.

2.6 Segurança de TI

A garantia do fabricante somente é válida se o produto for instalado e usado conforme descrito nas Instruções de operação. O produto é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer mudança accidental das configurações.

Medidas de segurança de TI, que oferecem proteção adicional para o produto e a respectiva transferência de dados, devem ser implantadas pelos próprios operadores de acordo com seus padrões de segurança.

2.7 Segurança de TI específica do equipamento

O equipamento oferece uma gama de funções específicas para apoiar medidas de proteção para o operador. Essas funções podem ser configuradas pelo usuário e garantir maior segurança em operação, se usado corretamente. A seguinte lista fornece uma visão geral das funções mais importantes:

2.7.1 Proteção de acesso através da proteção contra gravação de hardware

O acesso a gravação nos parâmetros do equipamento através do display locale rede ou ferramenta de operação (por ex. FieldCare, DeviceCare) pode ser desabilitado através de uma seletora de proteção contra gravação (minisseletora no módulo de eletrônica principal). Quando a proteção contra gravação de hardware é habilitada, somente é possível o acesso de leitura aos parâmetros.

2.7.2 Proteção de acesso através de senha

Uma senha pode ser usada para proteger contra acesso aos parâmetros do equipamento. Isso controla o acesso de gravação aos parâmetros de equipamento através do display local ou de outras ferramentas de operação (ex. FieldCare, DeviceCare) e, em termos de funcionalidade, corresponde à proteção contra gravação no hardware. Se for usada a interface de serviço CDI, o acesso para leitura somente é possível inserindo primeiro a senha.

Código de acesso específico do usuário

O acesso de escrita aos parâmetros do equipamento através do display local ou ferramenta de operação (ex. FieldCare, DeviceCare) pode ser protegido pelo código de acesso modificável, específico do usuário (→ 116).

Quando o equipamento é entregue, o equipamento não possui um código de acesso e é equivalente a *0000* (aberto).

Notas gerais sobre o uso de senhas

- O código de acesso e a chave de rede fornecidos com o equipamento deverão ser alterados durante o comissionamento por motivos de segurança.
- Siga as regras gerais para a geração de uma senha segura ao definir e gerenciar o código de acesso ou a chave de rede.
- O usuário é responsável pelo gerenciamento e pelo manuseio cuidadoso do código de acesso e chave de rede.
- Para informações sobre a configuração do código de acesso ou sobre o que fazer em caso de perda da senha, por exemplo, consulte "Proteção contra gravação através de código de acesso" → 116.

2.7.3 Acesso através do fieldbus

Ao se comunicar através do fieldbus, o acesso aos parâmetros do equipamento pode ser restrito ao acesso "*Somente leitura*". A opção pode ser alterada no parâmetro **Fieldbus writing access**.

Isso não afeta a transmissão de valor cíclico medido para o sistema de encomendas mais elevado, que é sempre garantido.



Para informações detalhadas sobre os parâmetros do equipamento, consulte:
Documento "Descrição dos parâmetros do equipamento" → 228.


3 Descrição do produto

O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.

Duas versões do equipamento estão disponíveis:

- Versão compacta - o transmissor e o sensor formam uma unidade mecânica.
- Versão remota - o transmissor e o sensor são montados em locais separados.

3.1 Design do produto

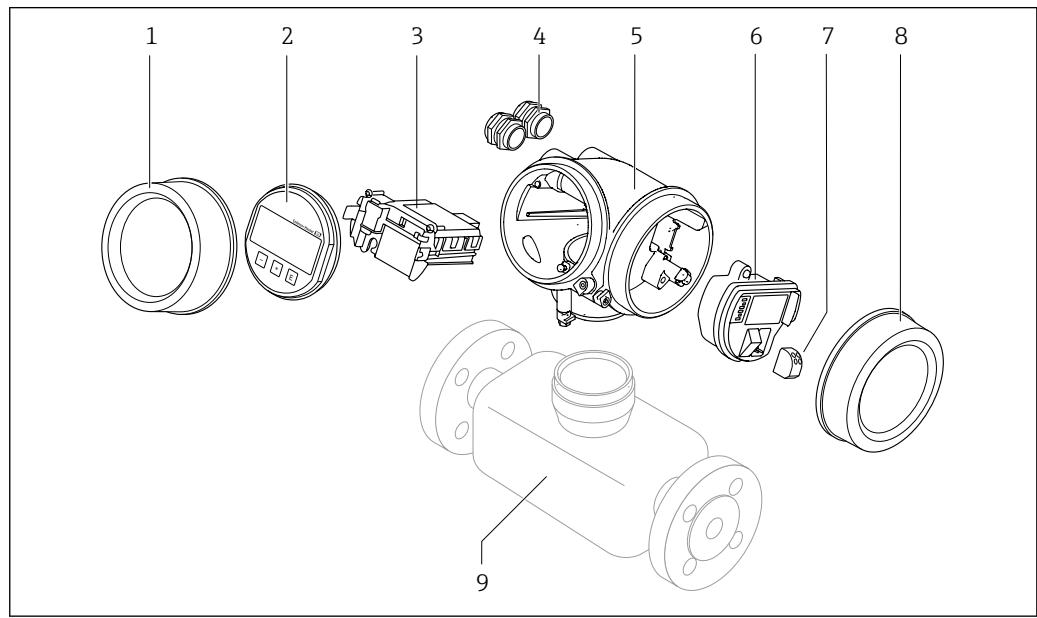

- 1 Tampa do compartimento dos componentes eletrônicos
- 2 Módulo do display
- 3 Módulo dos componentes eletrônicos principais
- 4 Prensa-cabos
- 5 Invólucro do transmissor (incluindo HistoROM)
- 6 Módulo dos componentes eletrônicos de E/S
- 7 Terminais (terminais plug-in de mola)
- 8 Tampa do compartimento de conexão
- 9 Sensor

4 Recebimento e identificação do produto

4.1 Recebimento

Ao receber a entrega:

1. Verifique se há danos na embalagem.
 - ↳ Relate todos os danos imediatamente ao fabricante.
 - Não instale componentes danificados.
2. Verifique o escopo de entrega usando a nota de entrega.
3. Compare os dados na etiqueta de identificação com as especificações do pedido na nota de entrega.
4. Verifique a documentação técnica e todos os outros documentos necessários, como por ex. certificados, para garantir que estejam completos.

 Se uma dessas condições não estiver de acordo, entre em contato com o fabricante.

4.2 Identificação do produto


O equipamento pode ser identificado das seguintes maneiras:

- Etiqueta de identificação
- Código de pedido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de entrega
- Insira os números de série das etiquetas de identificação no *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): são exibidas todas as informações sobre o equipamento.
- Insira os números de série das etiquetas de identificação no *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser* ou leia o código DataMatrix na etiqueta de identificação com o *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: são exibidas todas as informações sobre o equipamento.

Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:

- A "Documentação adicional do equipamento padrão" e as seções "Documentação complementar dependente do equipamento"
- O *Device Viewer*: Insira o número de série da etiqueta de identificação (www.endress.com/deviceviewer)
- O *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série a partir da etiqueta de identificação ou leia o código DataMatrix na etiqueta de identificação.

4.2.1 Etiqueta de identificação do transmissor

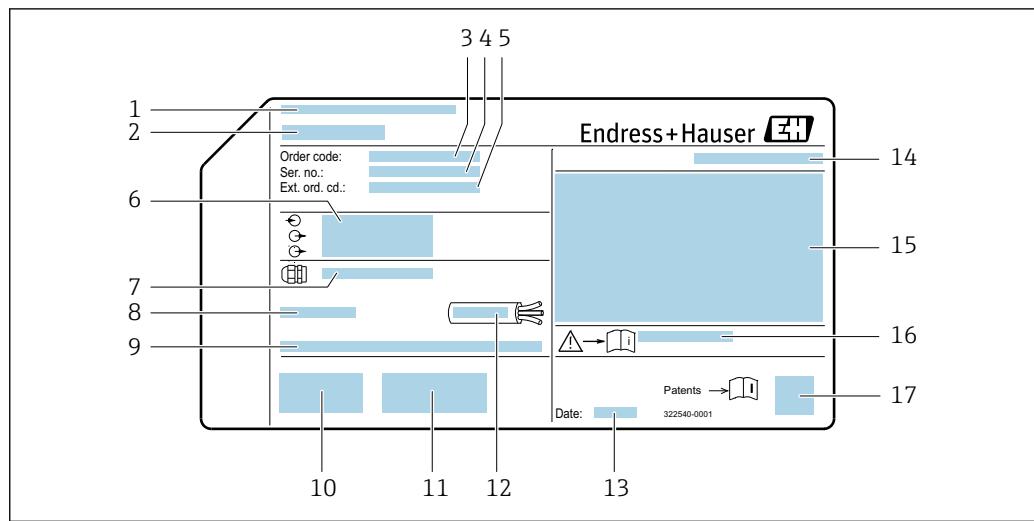

1 Exemplo de uma etiqueta de identificação de transmissor

- 1 Endereço do fabricante/portador do certificado
- 2 Nome do transmissor
- 3 Código de pedido
- 4 Número de série
- 5 Código de pedido estendido
- 6 Dados da conexão elétrica, por ex. entradas e saídas disponíveis, tensão de alimentação
- 7 Tipo de prensa-cabo
- 8 Temperatura ambiente permitida (T_a)
- 9 Versão de firmware (FW) de fábrica
- 10 Identificação CE, identificação RCM
- 11 Informações adicionais sobre a versão: certificados, aprovações
- 12 Faixa de temperatura permitida para cabo
- 13 Data de fabricação: ano-mês
- 14 Grau de proteção
- 15 Informações de aprovação para proteção contra explosão
- 16 Número do documento da documentação adicional referente à segurança
- 17 Código da matriz 2-D

4.2.2 Etiqueta de identificação do sensor

Código de pedido para "Invólucro" opção B "GT18 com compartimento duplo, 316L, compacto" e opção K "GT18 compartimento duplo, 316L, remoto"


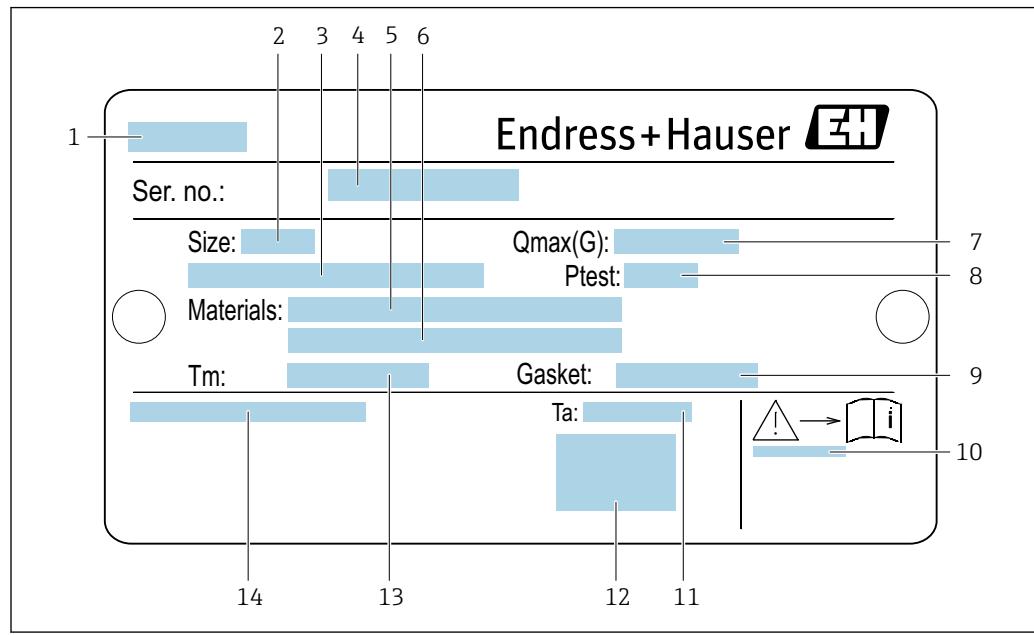


Fig. 2 Exemplo de uma etiqueta de identificação de sensor

- 1 Nome do sensor
- 2 Diâmetro nominal do sensor
- 3 Diâmetro nominal do flange/pressão nominal
- 4 Número de série (Nº série)
- 5 Material do tubo de medição
- 6 Material do tubo de medição
- 7 Vazão volumétrica máxima permitida (gás/vapor): $Q_{\text{máx}}$ → 201
- 8 Pressão de teste do sensor: OPL
- 9 Material de vedação
- 10 Número do documento da documentação adicional referente à segurança → 228
- 11 Faixa de temperatura ambiente
- 12 Identificação CE
- 13 Faixa de temperatura média
- 14 Grau de proteção

Código de pedido para "Invólucro" opção C "GT20 duas câmaras, alumínio, revestido, compacto"

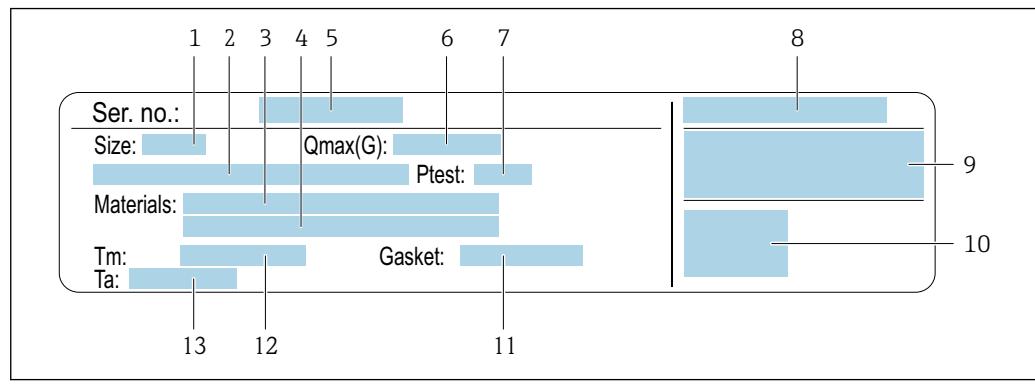

3 Exemplo de uma etiqueta de identificação de sensor

- 1 Diâmetro nominal do sensor
- 2 Diâmetro nominal do flange/pressão nominal
- 3 Material do tubo de medição
- 4 Material do tubo de medição
- 5 Número de série (Nº série)
- 6 Vazão volumétrica máxima permitida (gás/vapor)
- 7 Pressão de teste do sensor
- 8 Grau de proteção
- 9 Informação de aprovação para proteção contra explosão e diretriz de equipamento de pressão → 228
- 10 Identificação CE
- 11 Material de vedação
- 12 Faixa de temperatura média
- 13 Faixa de temperatura ambiente

Código de pedido para "Invólucro" opção C "GT20 duas câmaras, alumínio, revestido, remoto"

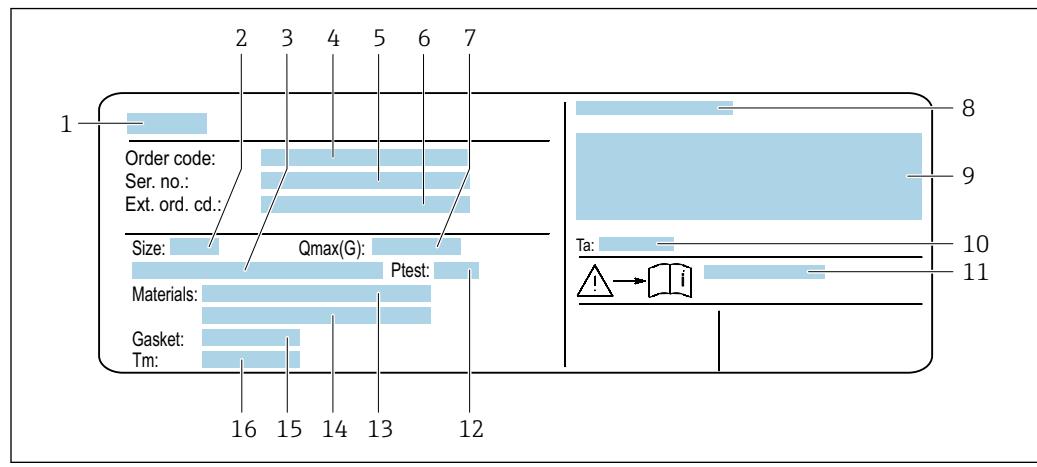


Fig. 4 Exemplo de uma etiqueta de identificação de sensor

- 1 Nome do sensor
- 2 Diâmetro nominal do sensor
- 3 Diâmetro nominal do flange/pressão nominal
- 4 Código de pedido
- 5 Número de série (Nº série)
- 6 Código de pedido estendido (ext. ord. cd.)
- 7 Vazão volumétrica máxima permitida (gás/vapor)
- 8 Grau de proteção
- 9 Informação de aprovação para proteção contra explosão e diretriz de equipamento de pressão
- 10 Faixa de temperatura ambiente
- 11 Número da documentação adicional referente à segurança → 228
- 12 Pressão de teste do sensor
- 13 Material do tubo de medição
- 14 Material do tubo de medição
- 15 Material de vedação
- 16 Faixa de temperatura média

i Código do produto

O medidor é encomendado novamente usando o código do produto.

Código do produto estendido

- O tipo de equipamento (raiz do produto) e as especificações básicas (características obrigatórias) sempre são listados.
- Das especificações opcionais (características opcionais), apenas as especificações relacionadas à aprovação e segurança são listadas (e.g. LA). Se outras especificações opcionais também forem encomendadas, as mesmas são indicadas coletivamente usando o símbolo de espaço reservado # (e.g. #LA#).
- Se as especificações opcionais não incluírem quaisquer especificações relacionadas à aprovação e segurança, elas são indicadas pelo símbolo de espaço reservado + (e.g. XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Símbolos no equipamento

Símbolo	Significado
	AVISO! Este símbolo alerta para uma situação perigosa. A falha em evitar essa situação pode resultar em ferimentos sérios ou fatais. Consulte a documentação do instrumento de medição para descobrir o tipo de perigo potencial e as medidas para evitá-lo.
	Verifique a documentação Refere-se à documentação do equipamento correspondente.
	Conexão de aterramento de proteção Um terminal que deve ser conectado ao aterramento antes de estabelecer qualquer outra conexão.

5 Armazenamento e transporte

5.1 Condições de armazenamento


Observe as seguintes notas de armazenamento:

- Armazene na embalagem original para garantir proteção contra choque.
- Não remova coberturas de proteção ou tampas protetoras instaladas nas conexões de processo. Elas impedem danos mecânicos às superfícies de vedação e contaminação do tubo de medição.
- Proteja contra luz solar direta. Evite altas temperaturas superficiais inadmissíveis.
- Armazene em um local seco e livre de poeira.
- Não armazene em local aberto.

Temperatura de armazenamento: -50 para +80 °C (-58 para +176 °F)

5.2 Transporte do produto

Transporte o medidor para o ponto de medição na embalagem original.

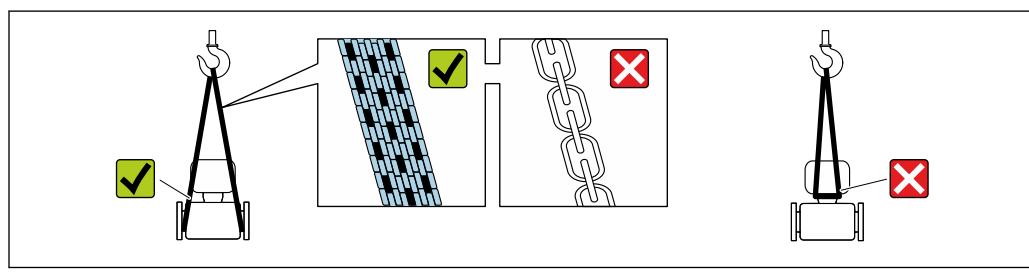

A0029252

i Não remova as tampas de proteção ou as tampas instaladas nas conexões de processo. Elas impedem danos mecânicos às superfícies de vedação e contaminação do tubo de medição.


5.2.1 Medidores sem olhais de elevação

⚠ ATENÇÃO

Centro de gravidade do medidor é maior do que os pontos de suspensão das lingas de conexão em rede.

Risco de ferimento se o medidor escorregar.

- Fixe o medidor para que não gire ou escorregue.
- Observe o peso especificado na embalagem (etiqueta adesiva).

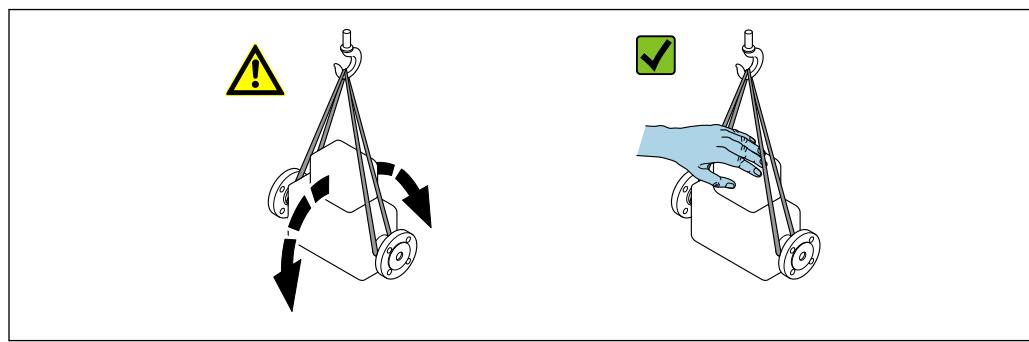

A0029214

5.2.2 Medidores com olhais de elevação

A CUIDADO

Instruções especiais de transporte para equipamentos com olhais de elevação

- ▶ Ao transportar o equipamento, use somente os olhais de elevação instalados no equipamento ou as flanges.
- ▶ O equipamento deve sempre ser preso em, pelo menos, dois olhais de elevação.

5.2.3 Transporte com empilhadeira

Se transportar em engradados, a estrutura do piso permite que as caixas sejam elevadas horizontalmente ou através de ambos os lados usando uma empilhadeira.

5.3 Descarte de embalagem

Todos os materiais de embalagem são sustentáveis e 100% recicláveis:


- Embalagem exterior do dispositivo
 - Filme plástico de empacotamento feito de polímero de acordo com a Diretriz da UE 2002/95/EC (RoHS)
- Embalagem
 - Engradado de madeira tratado de acordo com a norma ISPM 15, confirmado pelo logo IPPC
 - Caixa de papelão de acordo com a diretriz europeia de embalagens 94/62/EC, reciclagem confirmada pelo símbolo Resy
- Material de transporte e acessórios de fixação
 - Palete de plástico descartável
 - Tiras plásticas
 - Tiras adesivas de plástico
- Material de enchimento
 - Almofadas de papel

6 Instalação

6.1 Requisitos de instalação

6.1.1 Posição de instalação

Local de instalação

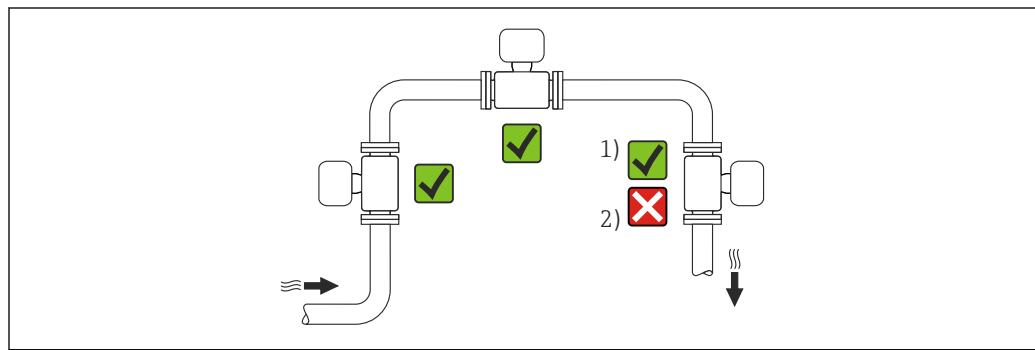





1 *Instalação adequada para gases e vapor*



2 *Instalação não adequada para líquidos*

Orientação

A direção da seta na etiqueta de identificação do sensor ajuda você a instalar o sensor de acordo com a direção da vazão (direção de vazão média pela tubulação).

Os medidores Vortex exigem um perfil de vazão totalmente desenvolvido como um pré-requisito para a medição correta da vazão volumétrica. Portanto, observe o seguinte:


	Orientação	Recomendação	
		Versão compacta	Versão remota
A	Orientação vertical (líquidos)		 ¹⁾
A	Orientação vertical (gases secos)	 	 
B	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para cima		 ²⁾

	Orientação	Recomendação	
		Versão compacta	Versão remota
C	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para baixo	 A0015590	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ³⁾
D	Direção horizontal, cabeçote do transmissor voltado para o lado	 A0015592	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

- 1) Em caso de líquidos, deve haver vazão para cima nos tubos verticais para evitar enchimento parcial do tubo (Fig. A). Interrupção na medição de vazão!
- 2) No caso de meios quentes (por ex. temperatura do vapor ou do meio ($TM \geq 200^{\circ}\text{C}$ (392°F))): orientação C ou D
- 3) No caso de meios muito frios (por exemplo, nitrogênio líquido): orientação B ou D

Operações de entrada e saída

Para obter o nível especificado de precisão do instrumento de medição, as operações de entrada e saída mencionadas abaixo devem ser mantidas no nível mínimo.

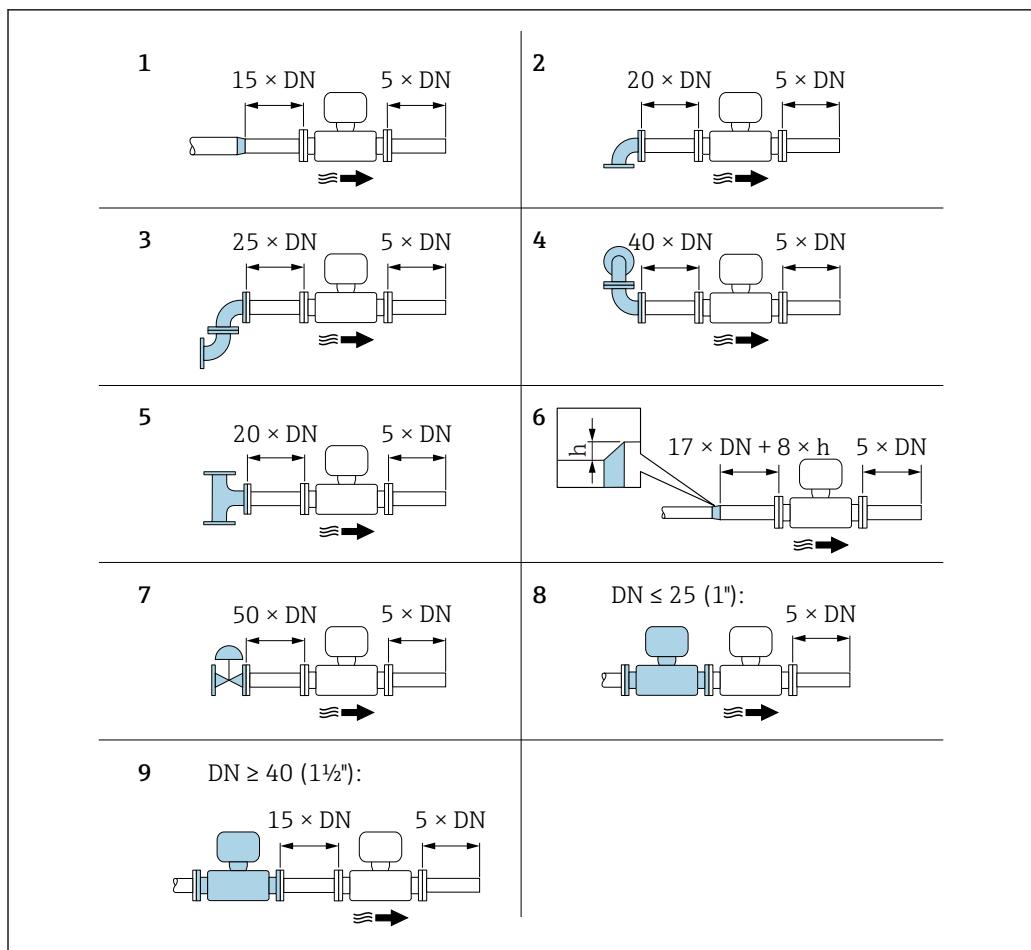

A0019189

5 Trechos retos a montante e a jusante mínimos com várias obstruções de vazão

h Diferença de expansão

1 Redução em um diâmetro nominal

2 Cotovelo único (cotovelo 90°)

3 Cotovelo duplo (Cotovelos 2 × 90°, opostos)

4 Cotovelo duplo 3D (Cotovelos 2 × 90°, opostos, não em um único plano)

5 Peça T

6 Extensão

7 Válvula de comando

8 Dois instrumentos de medição em sequência nos quais $DN \leq 25$ (1"): diretamente flange em flange

9 Dois instrumentos de medição em sequência, nos quais $DN \geq 40$ (1½"): para espaçamento, consulte o gráfico




- Se houver várias perturbações de vazão presentes, o escoamento de entrada mais longo especificado deve ser mantido.
- Caso os escoamentos de entrada necessários não possam ser observados, é possível instalar um condicionador de vazão especialmente projetado → 24.

Condicionador de vazão

Caso os escoamentos de entrada não possam ser observados, recomenda-se o uso de um condicionador de vazão.

O condicionador de fluxo é ajustado entre as flanges de dois tubos e centralizado pelos parafusos de fixação. Isso geralmente reduz a operação de entrada necessária para $10 \times DN$ com máxima precisão de medição.

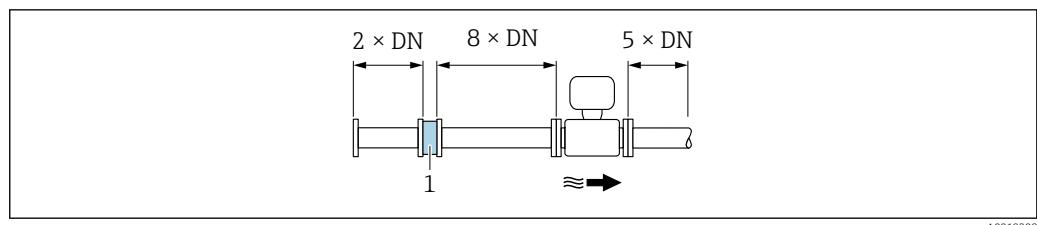

1 Condicionador de vazão

A perda de pressão nos condicionadores de vazão é calculada da seguinte forma:

$$\Delta p \text{ [mbar]} = 0.0085 \cdot \rho \text{ [kg/m}^3\text{]} \cdot v^2 \text{ [m/s]}$$

Exemplo para vapor

$$\begin{aligned} p &= 10 \text{ bar abs.} \\ t &= 240^\circ\text{C} \rightarrow \rho = 4.39 \text{ kg/m}^3 \\ v &= 40 \text{ m/s} \\ \Delta p &= 0.0085 \cdot 4.39 \cdot 40^2 = 59.7 \text{ mbar} \end{aligned}$$

Exemplo para H₂O condensada (80 °C)


$$\begin{aligned} \rho &= 965 \text{ kg/m}^3 \\ v &= 2.5 \text{ m/s} \\ \Delta p &= 0.0085 \cdot 965 \cdot 2.5^2 = 51.3 \text{ mbar} \end{aligned}$$

ρ : densidade do produto
 v : velocidade de vazão média
abs. = absoluto

Para as dimensões de condicionador de vazão, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

Trechos retos a jusante, ao instalar equipamentos externos

Caso instale um equipamento externo, observe a distância especificada.

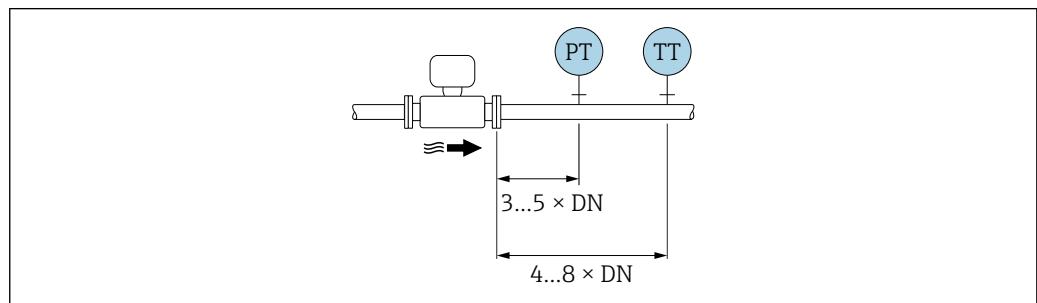

PT Pressão
TT Equipamento de temperatura

Dimensões de instalação

Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

6.1.2 Especificações ambientais e de processo

Faixa de temperatura ambiente

Versão compacta

Instrumento de medição	Área não classificada:	-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 para +70 °C (-40 para +158 °F)

	Ex d, XP:	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
Display local		-40 para +70 °C (-40 para +158 °F) ¹⁾

- 1) Em temperaturas abaixo de -20 °C (-4 °F), dependendo das características físicas envolvidas, pode não ser mais possível ler o display de cristal líquido.

Versão remota

Transmissor	Área não classificada:	-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)
	Ex d:	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)
Sensor	Área não classificada:	-40 para +85 °C (-40 para +185 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 para +85 °C (-40 para +185 °F)
	Ex d:	-40 para +85 °C (-40 para +185 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40 para +85 °C (-40 para +185 °F)
Display local		-40 para +70 °C (-40 para +158 °F) ¹⁾

- 1) Em temperaturas < -20 °C (-4 °F), dependendo das características físicas envolvidas, pode não ser mais possível ler o display de cristal líquido.

- Se em operação em áreas externas:

Evite luz solar direta, particularmente em regiões de clima quente.

 Você pode pedir um tampa de proteção contra tempo da Endress+Hauser. → [196](#).


Isolamento térmico

Para melhores medições da temperatura e cálculo de massa, a transferência de calor no sensor deve ser evitada para alguns fluidos. Isso pode ser assegurado ao instalar-se o isolamento térmico. Uma ampla variedade de materiais pode ser usada para o isolamento exigido.

Isso se aplica para:

- Versão compacta
- Versão de sensor remoto

A altura de isolamento máxima permitida é ilustrada no diagrama:

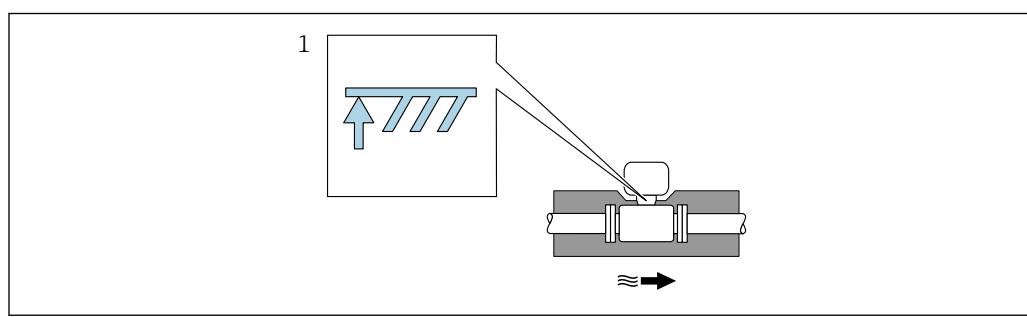

1 Altura máxima de isolamento

- Quando isolar, certifique-se de que uma área suficientemente grande do suporte do invólucro permanece exposta.

As partes descobertas funcionam como um radiador e protegem os componentes eletrônicos contra o superaquecimento e resfriamento excessivo.

AVISO

Superaquecimento dos componentes eletrônicos devido ao isolamento térmico!


- ▶ Observe a altura máxima de isolamento permitida indicada no pescoço do transmissor de tal forma que o cabeçote do transmissor e/ou o invólucro da conexão da versão remota esteja completamente livre.
- ▶ Observe a informação sobre as faixas de temperaturas permissíveis .
- ▶ Observe que uma certa orientação pode ser necessária, dependendo da temperatura do fluido .

Instalação para medições de delta de calor

Código de pedido para "Versão do sensor", opção CD "massa; Liga 718; 316L (medição da temperatura integrada), -200 para +400 °C (-328 para +750 °F)"

A segunda medição da temperatura é realizada, usando um sensor de temperatura separado. O instrumento de medição lê esse valor através de uma interface de comunicação.

- No caso de medições de delta de calor de vapor saturado, o instrumento de medição deve ser instalado no lado do vapor.
- No caso de medições de delta de calor de água, o equipamento pode ser instalado no lado frio ou quente.

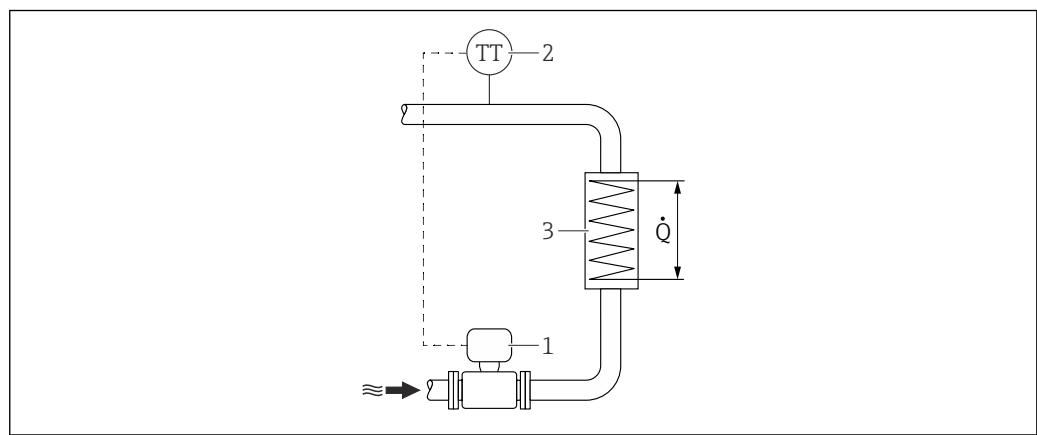

A0019209

■ 6 Layout para a medição de delta de calor de água e vapor saturado

- 1 Instrumento de medição
- 2 Sensor de temperatura
- 3 Trocador de calor
- Q Vazão de calor

Instalação em sistemas de vapor

O equipamento foi testado para picos de pressão dinâmicos de até 300 bar (4 350 psi) por meio de golpes de aríete induzidos pela condensação (CIWH). Apesar do design robusto e reforçado, aplicam-se as seguintes recomendações de melhores práticas para aplicações de vapor para evitar danos devido a golpes de aríete induzidos pela condensação.

1. Garanta a drenagem de condensado suficiente e constante dos tubos usando os coletores de vapor corretamente dimensionados e bem mantidos. Geralmente, eles são instalados a cada 30 para 50 m (100 para 165 in) em tubos horizontais ou em pontos de aterrramento.
2. As linhas de vapor devem ter um gradiente adequado de pelo menos 1% na direção da vazão de vapor para garantir que o condensado seja direcionado aos coletores de vapor nos pontos de drenagem
3. Se o sistema for desligado, eles devem ser completamente drenados.

4. Evite configurações de tubo que causem acúmulos de água estacionária.
5. Aumente lentamente a pressão estática e a taxa de vazão de vapor ao iniciar o sistema.
6. Certifique-se de que o vapor não entre em contato com condensado significativamente mais frio.

Tampa de proteção

Uma tampa protetora está disponível como acessório para o equipamento. Ela é usada para proteger contra a luz solar direta, precipitação e gelo.

Ao instalar a tampa de proteção, uma folga mínima deve ser mantida acima:
222 mm (8.74 in)

A tampa de proteção pode ser solicitada através da estrutura do produto juntamente com o equipamento:

Código de pedido para "Acessórios incluídos" opção PB "Tampa de proteção"

Solicitado separadamente como acessório → [196](#)

6.2 Instalação do equipamento

6.2.1 Ferramentas necessárias

Para o transmissor

- Para girar o invólucro do transmissor: chave de boca 8 mm
- Para abertura das braçadeiras de fixação: chave Allen 3 mm

Para o sensor

Para flanges e outras conexões de processo: use uma ferramenta de instalação adequada.

6.2.2 Preparação do medidor

1. Remova toda a embalagem de transporte restante.
2. Remova as coberturas ou tampas de proteção presentes no sensor.
3. Remova a etiqueta adesiva na tampa do compartimento de componentes eletrônicos.

6.2.3 Instalação do sensor


ATENÇÃO

Perigo devido à vedação incorreta do processo!

- Certifique-se de que os diâmetros internos das juntas sejam maiores ou iguais aos das conexões de processo e da tubulação.
- Certifique-se de que as vedações estejam limpas e não estejam danificadas.
- Prenda as vedações corretamente.

1. Certifique-se de que a direção da seta no sensor corresponda à direção de vazão do meio.
2. Para garantir a conformidade com as especificações do equipamento, instale o instrumento de medição entre os flanges da tubulação de forma que ele esteja no centro da seção de medição.

3. Instale o instrumento de medição ou gire o invólucro do transmissor de forma que as entradas para cabos não apontem para cima.

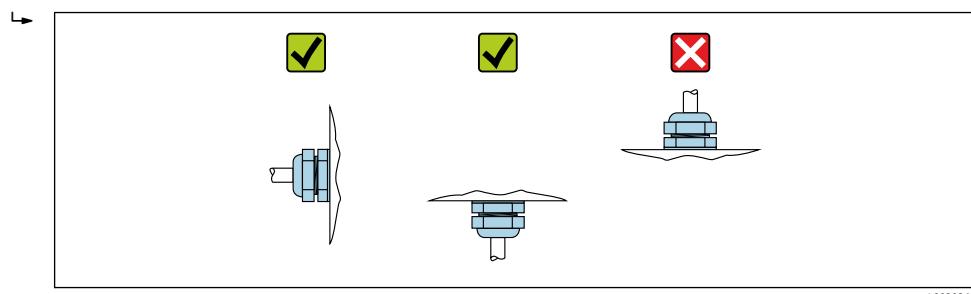

A0029263

6.2.4 Instalação do transmissor da versão remota

⚠ CUIDADO

Temperatura ambiente muito elevada!

Perigo de superaquecimento de eletrônicos e deformação do invólucro.

- ▶ Não exceda a temperatura ambiente máxima permitida.
- ▶ Ao operar em ambiente externo: Evite luz solar direta e exposição às condições atmosféricas, particularmente em regiões de clima quente.

⚠ CUIDADO


Força excessiva pode danificar o invólucro!

- ▶ Evite tensão mecânica excessiva.

O transmissor da versão remota pode ser montado das seguintes maneiras:

- Montagem em parede
- Montagem em tubos


Instalação em parede

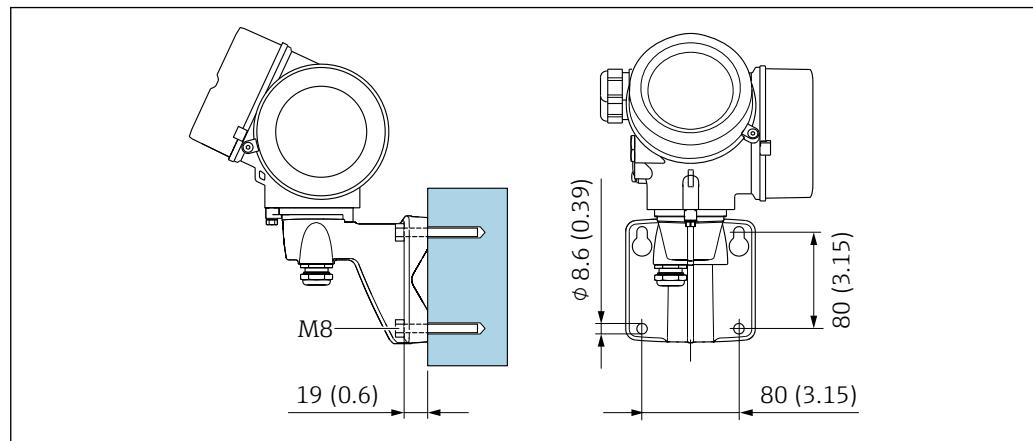

A0033484

7 mm (pol.)

Instalação em tubos

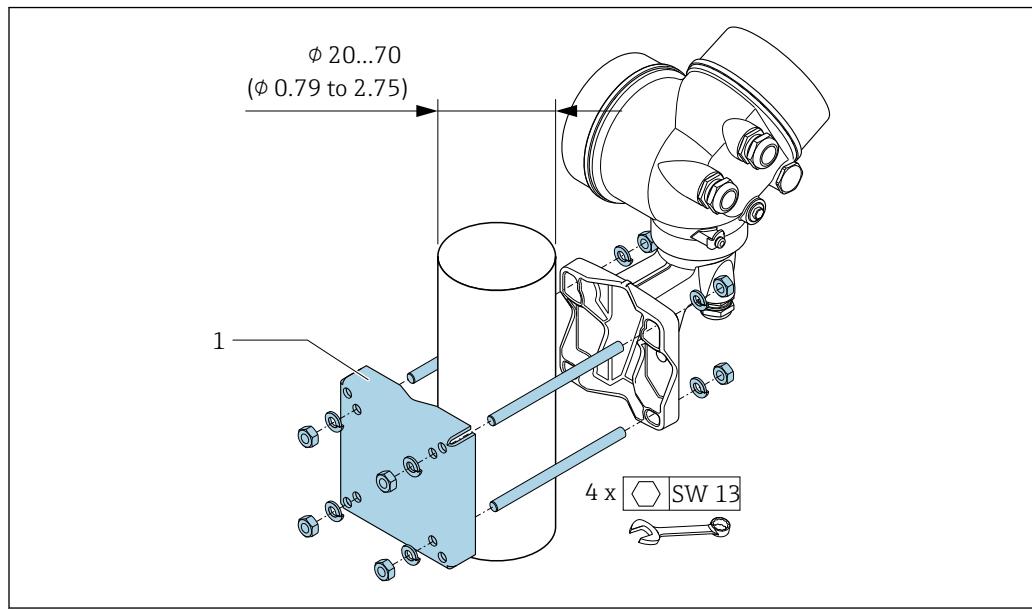


A0033486

8 mm (pol.)

6.2.5 Giro do invólucro do transmissor

Para proporcionar acesso mais fácil ao compartimento de conexão ou ao módulo do display, o invólucro do transmissor pode ser virado.

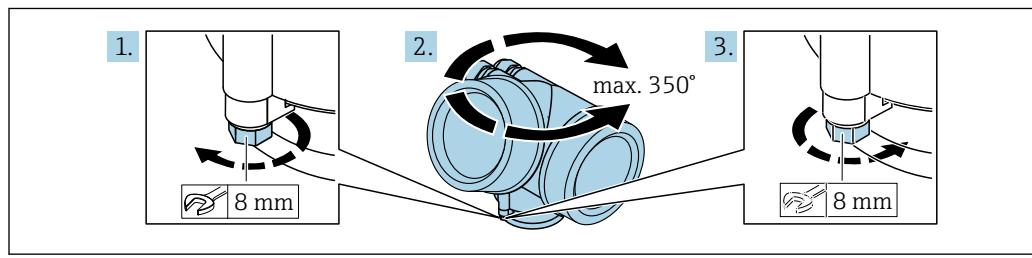


A0032242

1. Solte o parafuso de fixação.
2. Gire o invólucro para a posição desejada.
3. Aperte com firmeza o parafuso de fixação.

6.2.6 Giro do módulo do display

O módulo do display pode ter a posição alterada para otimizar a leitura e capacidade de operação do display.

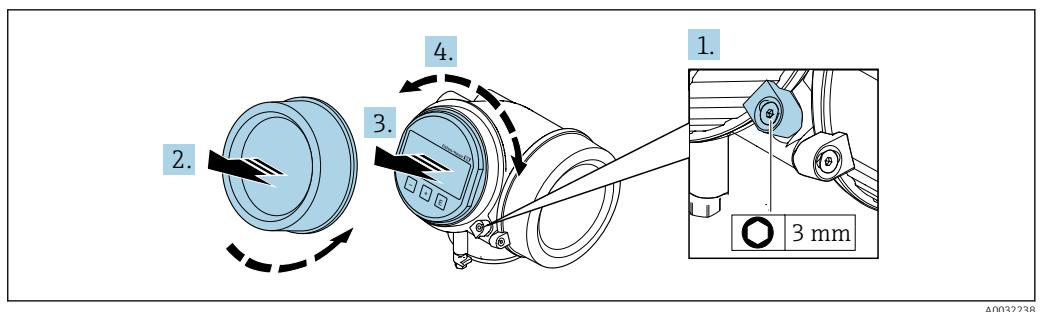

1. Solte a braçadeira de fixação da tampa do compartimento de componentes eletrônicos usando uma chave Allen.
2. Desrosqueie a tampa do compartimento de componentes eletrônicos do invólucro do transmissor.
3. Opcional: puxe o módulo do display para fora com um suave movimento de rotação.
4. Gire o módulo do display na posição desejada: máx. $8 \times 45^\circ$ em cada direção.
5. Sem o módulo do display puxado para fora:
Permita que o módulo do display encaixe na posição desejada.
6. Com o módulo do display puxado para fora:
Coloque o cabo no vão entre o invólucro e o módulo da eletrônica principal e conecte o módulo do display no compartimento dos componentes eletrônicos até encaixar.
7. Reinstale o transmissor na ordem inversa.

6.3 Verificação pós-montagem

Há algum dano no equipamento (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
O instrumento de medição correspondem às especificações do ponto de medição? Por exemplo: <ul style="list-style-type: none">■ Temperatura de processo■ Pressão de processo (consulte a seção sobre "Níveis de pressão/temperatura" no documento "Informações técnicas")■ Temperatura ambiente■ Faixa de medição → 201	<input type="checkbox"/>
Foi selecionada a orientação correta para o sensor → 22? <ul style="list-style-type: none">■ De acordo com o tipo de sensor■ De acordo com a temperatura do meio■ De acordo com as propriedades do meio (desprendimento de gases, com arraste de sólidos)	<input type="checkbox"/>
A seta no sensor corresponde à direção de vazão do meio → 22?	<input type="checkbox"/>
O nome da etiqueta e a identificação estão corretos (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
O equipamento está protegido o suficiente da precipitação e luz solar direta?	<input type="checkbox"/>
O parafuso de fixação e a braçadeira de fixação estão devidamente apertados?	<input type="checkbox"/>
A altura máxima de isolamento permitida foi observada?	<input type="checkbox"/>

7 Conexão elétrica

7.1 Segurança elétrica

De acordo com as regulamentações nacionais aplicáveis.

7.2 Especificações de conexão

7.2.1 Ferramentas necessárias

- Para entrada para cabo: use as ferramentas correspondentes
- Para braçadeiras de fixação: chave Allen 3 mm
- Desencapador de fio
- Quando usar cabos trançados: Ferramenta de crimpagem para arruela de ponta de fio
- Para remoção de cabos do terminal: chave de fenda chata ≤ 3 mm (0.12 in)

7.2.2 Especificações para o cabo de conexão

Os cabos de conexão fornecidos pelo cliente devem atender as especificações a seguir.

Faixa de temperatura permitida

- As diretrizes de instalação que se aplicam no país de instalação devem ser observadas.
- Os cabos devem ser adequados para temperaturas mínimas e máximas a serem esperadas.

Cabo de sinal

Saída em pulso/frequência/comutada

Cabo de instalação padrão é suficiente.

FOUNDATION Fieldbus

Cabo de dois fios, blindado, trançado.

 Para mais informações sobre o planejamento e a instalação de redes FOUNDATION Fieldbus consulte:

- Instruções de operação para "Características gerais do FOUNDATION Fieldbus" (BA00013S)
- Diretrizes do FOUNDATION Fieldbus
- IEC 61158-2 (MBP)

Diâmetro do cabo

- Prensa-cabos fornecido:
M20 × 1,5 com cabo Ø 6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
- Terminais plug-in de mola para versão do equipamento sem proteção contra sobretensão integrada: seção transversal do fio 0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)

7.2.3 Cabo de conexão para versão remota

Cabo de conexão (padrão)

Cabo padrão	Cabo de PVC 2 × 2 × 0.5 mm ² (22 AWG) com blindagem comum (2 pares, par trançado) ¹⁾
Resistência a chamas	De acordo com DIN EN 60332-1-2

Resistência a óleo	De acordo com DIN EN 60811-2-1
Blindagem	Trança de cobre galvanizada, densidade ótica aprox. 85 %
Comprimento do cabo	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
Temperatura de operação contínua	Quando instalado em uma posição fixa: -50 para +105 °C (-58 para +221 °F); quando o cabo pode mover-se livremente: -25 para +105 °C (-13 para +221 °F)

- 1) A radiação UV pode danificar a capa externa do cabo. Proteja o cabo contra exposição ao sol, o máximo possível.

Cabo de conexão (blindado)


Cabo, blindado	Cabo PVC $2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) com blindagem comum (2 pares, par trançado) e bainha trançada adicional de fio de aço ¹⁾
Resistência a chamas	De acordo com DIN EN 60332-1-2
Resistência a óleo	De acordo com DIN EN 60811-2-1
Blindagem	Trança de cobre galvanizada, densidade ót. aproximada 85%
Alívio de deformação e reforço	Trança de fio de aço, galvanizado
Comprimento do cabo	10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
Temperatura de operação contínua	Quando montada em uma posição fixa: -50 para +105 °C (-58 para +221 °F); quando o cabo pode mover-se livremente: -25 para +105 °C (-13 para +221 °F)

- 1) A radiação UV pode danificar a capa externa do cabo. Proteja o cabo contra exposição ao sol, o máximo possível.

7.2.4 Esquema de ligação elétrica

Transmissor

Versão de conexão para FOUNDATION Fieldbus, saída de pulso/frequência/comutada

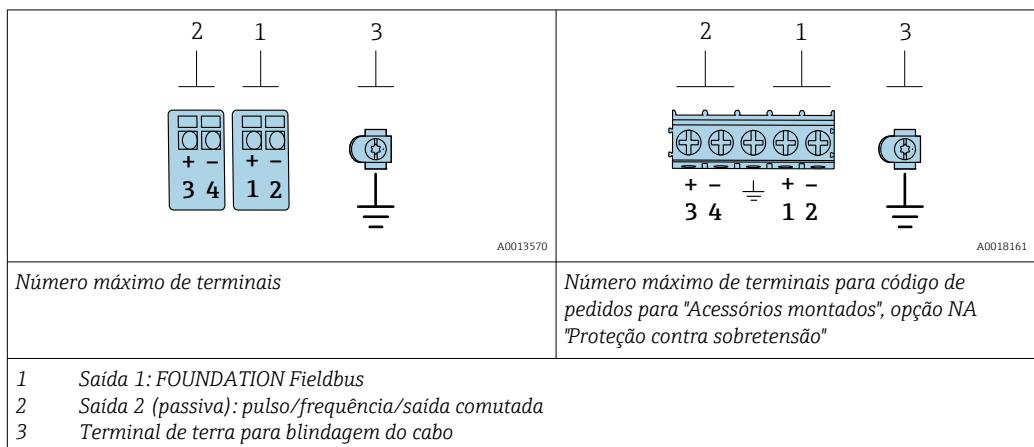

Código de pedido para "Saída"	Números de terminal			
	Saída 1		Saída 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
Opção E ^{1) 2)}	FOUNDATION Fieldbus		Pulso/frequência/saída comutada (passiva)	

- 1) A saída 1 deve sempre ser usada; a saída 2 é opcional.
2) FOUNDATION Fieldbus com proteção contra polaridade reversa integrada.

7.2.5 Atribuição do pino do plugue do equipamento

	Pino	Atribuição		Codificado	Conector/soquete
	1	2	3		
	+		Sinal +	A	Conector
	-		Sinal -		
			Aterramento		
			Não usado		

7.2.6 Blindagem e aterrimento

Compatibilidade eletromagnética ideal (EMC) do sistema fieldbus somente pode ser garantida se os componentes de sistema e, em particular, as linhas estiverem blindadas e a blindagem forma uma cobertura o mais completa possível. O ideal é uma cobertura de blindagem de 90 %.

- Para garantir a proteção EMC ideal, conecte a blindagem sempre que possível ao terra de referência.
- Devido à proteção contra explosão, recomenda-se que o aterramento seja descartado.

Para estar em conformidade com as especificações, existem basicamente três tipos diferentes de blindagem no sistema fieldbus:

- Blindagem em ambas as extremidades
- Blindagem em uma extremidade na lateral de alimentação com terminação de capacidade no equipamento de campo
- Blindagem em uma extremidade do lado da alimentação

Por experiência, sabe-se que o melhor resultado com relação a EMC é obtido, na maioria das vezes, em instalações com blindagem unilateral, no lado da alimentação (sem terminação de capacitância no equipamento de campo). Deve-se tomar medidas apropriadas com relação à ligação elétrica de entrada para permitir a operação irrestrita quando houver interferência de EMC. Estas medidas foram levadas em consideração para este equipamento. A operação em casos de variáveis de turbulência de acordo com NAMUR NE21 fica garantida.


1. Observe os requisitos e as diretrizes nacionais de instalação durante a instalação.
2. Onde existem grandes diferenças de potencial entre os pontos individuais de aterramento,
conecte apenas um ponto da blindagem diretamente ao terra de referência.
3. Em sistemas sem equalização potencial,
a blindagem do cabo do sistema fieldbus deve estar aterrada em apenas um lado, por exemplo, na unidade de alimentação do fieldbus ou nas barreiras de segurança.

AVISO

Em sistemas sem adequação de potencial, o aterramento múltiplo da blindagem do cabo causa correntes de equalização de corrente!

Dano à blindagem do cabo do barramento.

- Somente terra à blindagem do cabo do barramento terra local ou no terra de proteção em uma extremidade.
- Isole a blindagem que não está conectada.

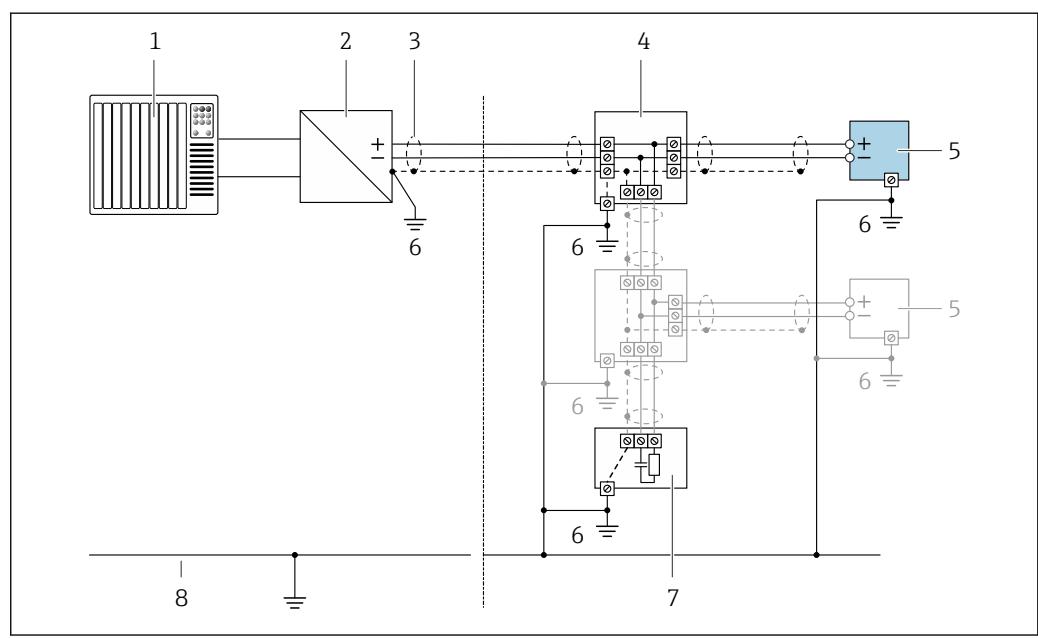

A0028768

■ 9 Exemplo de conexão para o FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema de automação (ex. PLC)
- 2 Condicionador de potência (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Blindagem do cabo: a blindagem do cabo deve ser aterrada nas duas extremidades para atender as especificações EMC; observe as especificações de cabo
- 4 T-box
- 5 Instrumento de medição
- 6 Aterramento local
- 7 Terminador do barramento
- 8 Condutor de equalização potencial

7.2.7 Especificações para a unidade de alimentação

Tensão de alimentação

Transmissor

Uma fonte de alimentação externa é necessária para cada saída.

Os seguintes valores de fonte de alimentação aplicam-se às saídas disponíveis:

Fonte de alimentação para uma versão compacta sem display local¹⁾

Código do pedido para "Saída, entrada"	Mínimo tensão do terminal ²⁾	Máximo Tensão do terminal
Opção E: FOUNDATION Fieldbus, saída em pulso/frequência/comutada	≥ CC 9 V	DC 32 V

1) No caso de uma fonte de alimentação externa do condicionador de potência

2) A tensão mínima do terminal aumenta se a operação local for usada: consulte a tabela a seguir

Aumento da tensão mínima do terminal com operação local

Código do pedido para "Display; operação"	Aumento na mínima Tensão do terminal
Opção C: Operação local SD02	+ CC 1 V
Opção E: Operação local SD03 com iluminação (iluminação de fundo não usada)	+ CC 1 V
Opção E: Operação local SD03 com iluminação (iluminação de fundo usada)	+ CC 3 V

7.2.8 Preparação do instrumento de medição

Execute os passos na seguinte ordem:

1. Monte o sensor e o transmissor.
2. Invólucro de conexão do sensor: conecte o cabo de conexão.
3. Transmissor: conecte o cabo de conexão.
4. Transmissor: Conecte o o cabo para a fonte de alimentação.

AVISO

Vedação insuficiente do invólucro!

A confiabilidade operacional do medidor pode estar comprometida.

► Use prensa-cabos adequados correspondendo ao grau de proteção.

1. Remova o conector falso, se houver.
2. Se o medidor for fornecido sem os prensa-cabos:
Forneça um prensa-cabo adequado para o cabo de conexão correspondente.
3. Se o medidor for fornecido com os prensa-cabos:
Observe as exigências para os cabos de conexão →  32.

7.3 Conexão do equipamento

AVISO


Uma conexão incorreta compromete a segurança elétrica!

- Somente pessoal especializado devidamente treinado pode realizar trabalhos de conexão elétrica.
- Observe os códigos e regulamentações federais/nacionais aplicáveis.
- Esteja em conformidade com as regulamentações de segurança do local de trabalho.
- Sempre conecte o cabo terra de proteção \ominus antes de conectar os cabos adicionais.
- Quando usado em atmosferas potencialmente explosivas, observe as informações na documentação EX específica para o equipamento.
- A unidade de alimentação deve ser aprovado por segurança (ex.: energia limitada pela classe de proteção II PELV/ SELV).

7.3.1 Conexão da versão compacta

Conexão do transmissor

Conexão através de terminais

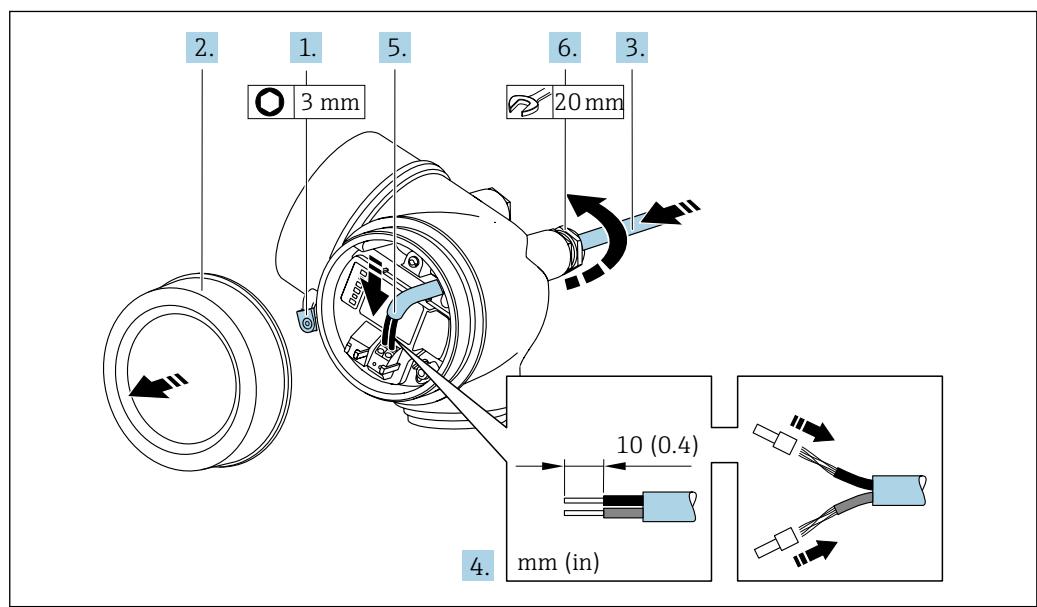

A0048825


1. Afrouxe a braçadeira de fixação da tampa do compartimento de conexão.
2. Desrosqueie a tampa do compartimento de conexão.
3. Empurre o cabo através da entrada para cabo. Para garantir a vedação estanque, não remova o anel de vedação da entrada para cabo.
4. Desencapse os cabos e as extremidades do cabo. No caso de cabos trançados, instale também as ponteiras.
5. Conecte o cabo de acordo com o esquema de ligação elétrica → 34.
6. **ATENÇÃO**

Grau de proteção do invólucro anulado devido à vedação insuficiente do invólucro.

- Fixe o parafuso sem usar lubrificante. As roscas na tampa são revestidas com um lubrificante seco.

Aperte firmemente os prensa-cabos.

7. Reinstale o transmissor na ordem inversa.

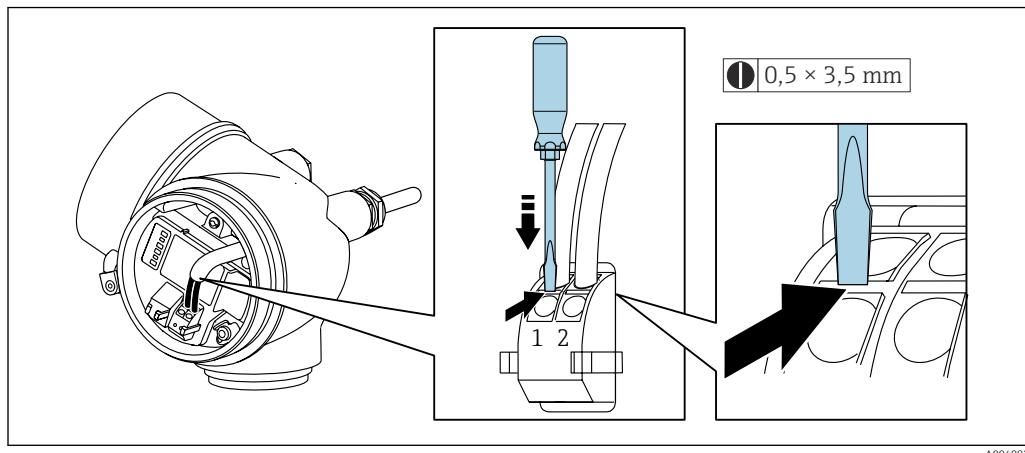Remoção do cabo

- ▶ Para remover um cabo do terminal, use uma chave de fenda de lâmina plana para empurrar o slot entre os dois furos de terminal enquanto simultaneamente puxa a extremidade do cabo para fora do terminal.

7.3.2 Conexão da versão remota

⚠ ATENÇÃO

Risco de danos aos componentes eletrônicos!

- ▶ Conecte o sensor e o transmissor na mesma equalização potencial.
- ▶ Apenas conecte o sensor ao transmissor com o mesmo número de série.

A seguinte sequência de etapas é recomendada:

1. Monte o sensor e o transmissor.
2. Conecte o.
3. Conecte o transmissor.

i O modo em que o cabo de conexão é ligado ao invólucro do transmissor depende da aprovação do instrumento de medição e a versão do cabo de conexão usado.

Nas versões a seguir, somente os terminais podem ser utilizados para a conexão no invólucro do transmissor:


- Código de pedido para "Conexão elétrica", opção B, C, D, 6
- Aprovações: Ex nA, Ex ec, Ex tb e Divisão 1
- Uso de cabo de conexão reforçado

Nas versões a seguir, um conector de equipamento M12 é utilizado para a conexão no invólucro do transmissor:


- Outras aprovações
- Uso de cabo de conexão (padrão)

Sempre são utilizados terminais para conectar o cabo de conexão no invólucro de conexão do sensor (torque de aperto das roscas para alívio de deformação do cabo: 1.2 para 1.7 Nm).

Conectando o invólucro de conexão do sensor

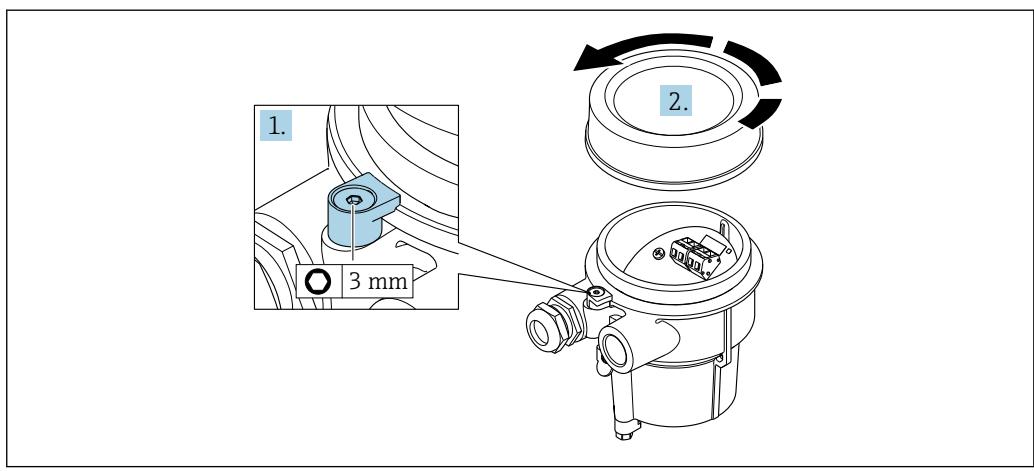

1. Solte a braçadeira de fixação.
2. Desaperte a tampa do invólucro.

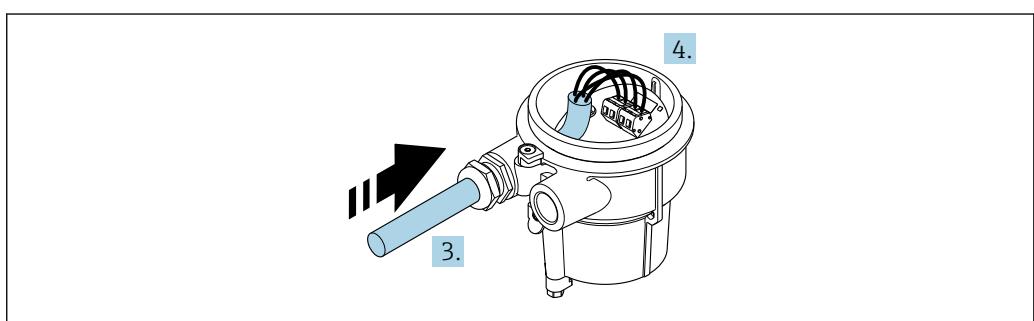

10 Gráfico de amostra

Cabo de conexão (padrão, reforçado)

3. Guie o cabo de conexão pela entrada para cabo e para dentro do invólucro de conexão (se usar um cabo de conexão sem um conector de equipamento M12, use a terminação desencapada mais curta do cabo de conexão).
4. Faça a fiação dos cabos de conexão:
 - ↳ Terminal 1 = cabo marrom
 - Terminal 2 = cabo branco
 - Terminal 3 = cabo amarelo
 - Terminal 4 = cabo verde
5. Conecte a blindagem do cabo através do alívio de deformação do cabo.
6. Aperte os parafusos para o alívio de deformação do cabo usando um torque na faixa de 1.2 para 1.7 Nm.
7. Para reinstalar o invólucro de conexão, faça o procedimento reverso da remoção.


Cabo de conexão (opção "massa compensada por pressão/temperatura")

3. Guie o cabo de conexão pela entrada para cabo e para dentro do invólucro de conexão (se usar um cabo de conexão sem um conector de equipamento M12, use a terminação desencapada mais curta do cabo de conexão).

4. Faça a fiação dos cabos de conexão:
 - ↳ Terminal 1 = cabo marrom
 - Terminal 2 = cabo branco
 - Terminal 3 = cabo verde
 - Terminal 4 = cabo vermelho
 - Terminal 5 = cabo preto
 - Terminal 6 = cabo amarelo
 - Terminal 7 = cabo azul
5. Conecte a blindagem do cabo através do alívio de deformação do cabo.
6. Aperte os parafusos para o alívio de deformação do cabo usando um torque na faixa de 1.2 para 1.7 Nm.
7. Para reinstalar o invólucro de conexão, faça o procedimento reverso da remoção.

Coneção do transmissor


Coneção do transmissor pelo conector

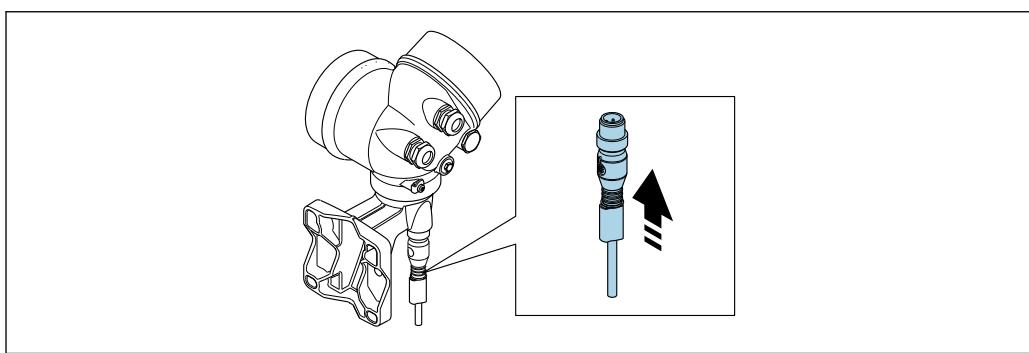

A0034172


- Conecte o conector.

Coneção do transmissor pelos terminais

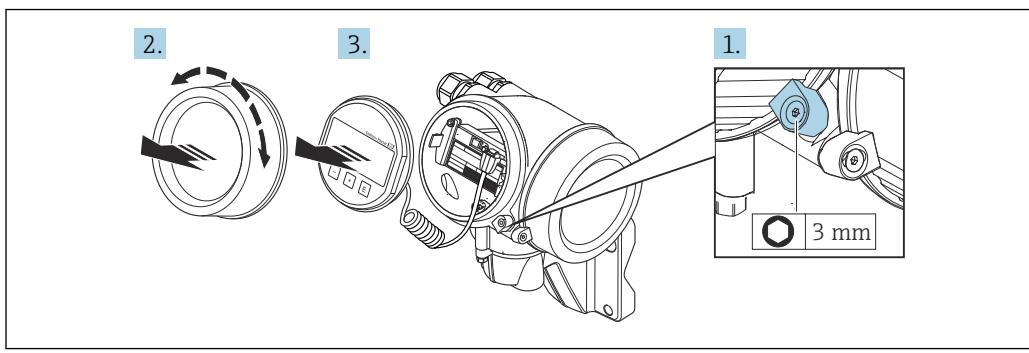


A0034173

1. Solte a braçadeira de fixação da tampa do compartimento dos componentes elétricos.
2. Desaparafuse a tampa do compartimento de componentes eletrônicos.
3. Puxe o módulo do display para fora com um suave movimento de rotação. Para facilitar o acesso à chave de bloqueio, instale o módulo de display na borda do compartimento de componentes eletrônicos.

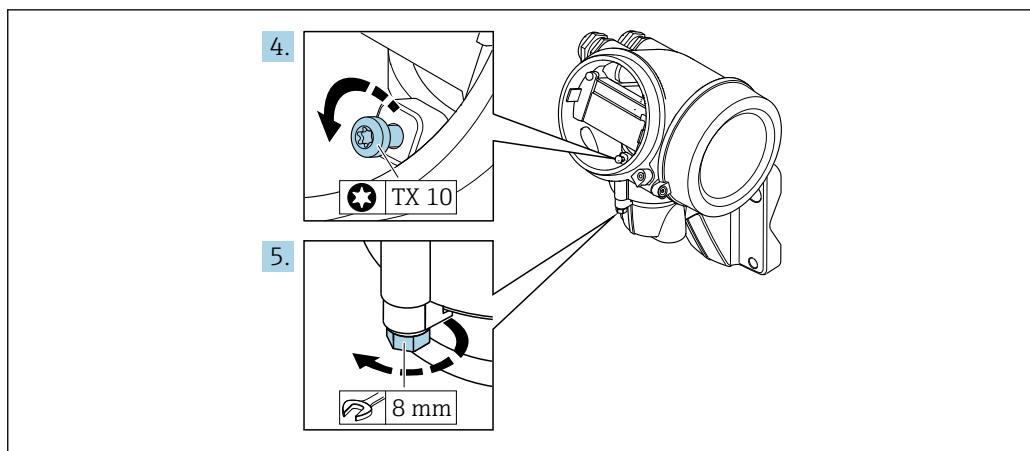


4. Solte o parafuso de fixação do invólucro do transmissor.
5. Solte as braçadeiras de fixação do invólucro do transmissor.

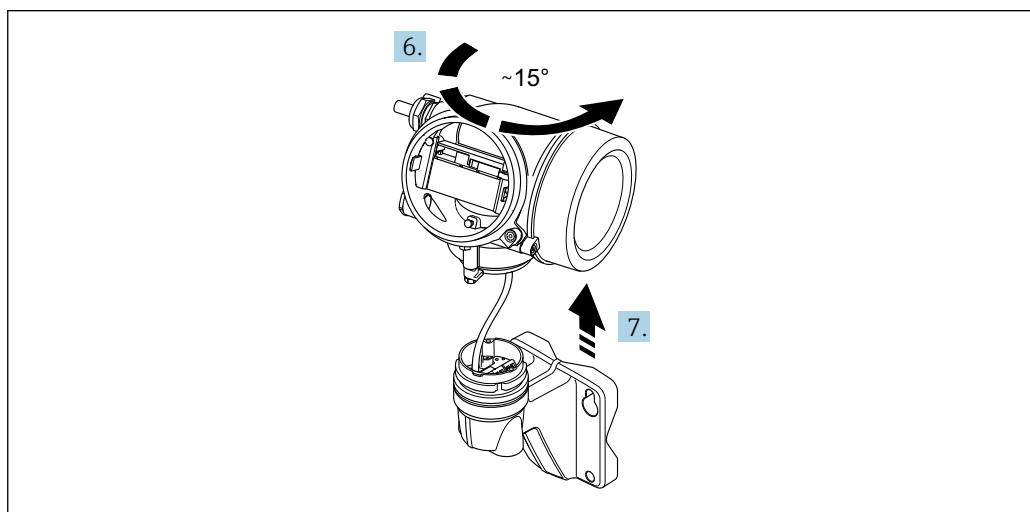


11 Gráfico de amostra

6. Gire o invólucro do transmissor para a direita até que ele atinja a marcação.
 7. **AVISO**
O quadro de conexão do invólucro de parede é conectado ao quadro dos componentes eletrônicos do transmissor pelo cabo de sinal!
► Preste atenção ao cabo de sinal quando levantar o invólucro do transmissor!
- Levante o invólucro do transmissor.

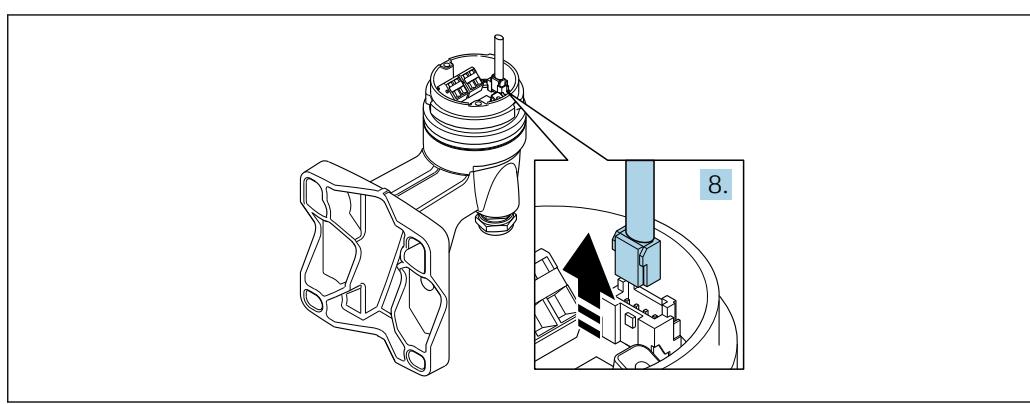

12 Gráfico de amostra

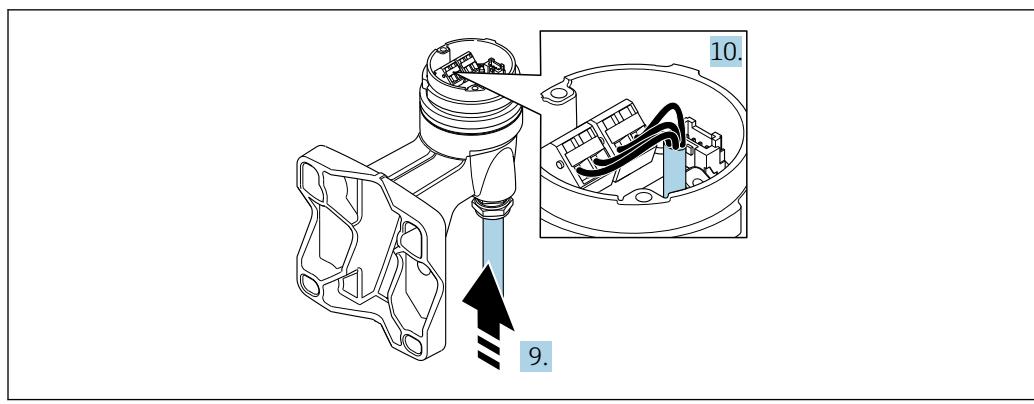

A0034177

13 Gráfico de amostra

Cabo de conexão (padrão, reforçado)

8. Desconecte o cabo do sinal do quadro do invólucro de parede ao pressionar o clipe de travamento no conector. Remova o invólucro do transmissor.
9. Guie o cabo de conexão pela entrada para cabo e para dentro do invólucro de conexão (se usar um cabo de conexão sem um conector de equipamento M12, use a terminação desencapada mais curta do cabo de conexão).
10. Faça a fiação dos cabos de conexão:
 - ↳ Terminal 1 = cabo marrom
 - Terminal 2 = cabo branco
 - Terminal 3 = cabo amarelo
 - Terminal 4 = cabo verde
11. Conecte a blindagem do cabo através do alívio de deformação do cabo.
12. Aperte os parafusos para o alívio de deformação do cabo usando um torque na faixa de 1.2 para 1.7 Nm.
13. Para reinstalar o invólucro do transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

Cabo de conexão (opção "massa compensada por pressão/temperatura")

8. Desconecte ambos os cabos de sinal do quadro do invólucro de parede ao pressionar o clipe de travamento no conector. Remova o invólucro do transmissor.
9. Guie o cabo de conexão pela entrada para cabo e para dentro do invólucro de conexão (se usar um cabo de conexão sem um conector de equipamento M12, use a terminação desencapada mais curta do cabo de conexão).
10. Faça a fiação dos cabos de conexão:
 - ↳ Terminal 1 = cabo marrom
 - Terminal 2 = cabo branco
 - Terminal 3 = cabo verde
 - Terminal 4 = cabo vermelho
 - Terminal 5 = cabo preto
 - Terminal 6 = cabo amarelo
 - Terminal 7 = cabo azul
11. Conecte a blindagem do cabo através do alívio de deformação do cabo.
12. Aperte os parafusos para o alívio de deformação do cabo usando um torque na faixa de 1.2 para 1.7 Nm.
13. Para reinstalar o invólucro do transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

7.4 Equalização de potencial

7.4.1 Requisitos

Para equalização de potencial:


- Observe os conceitos de aterramento do local
- Considere as condições de operação como material da tubulação e aterramento
- Conecte o meio, sensor e transmissor ao mesmo potencial elétrico
- Use um cabo de aterramento com uma seção transversal mínima de 6 mm² (10 AWG) e um terminal de cabos para as conexões de equalização potencial

7.5 Garantia do grau de proteção

O instrumento de medição atende às especificações para grau de proteção IP66/67, invólucro Tipo 4X .

Para garantir um grau de proteção IP66/67, invólucro Tipo 4X , execute as etapas a seguir após a conexão elétrica:

1. Verifique se as vedações do invólucro estão limpas e devidamente encaixadas.
2. Seque, limpe ou substitua as vedações, se necessário.
3. Aperte todos os parafusos do invólucro e as tampas dos parafusos.
4. Aperte firmemente os prensa-cabos.
5. Para garantir que a umidade não penetre na entrada para cabo:
Diracione o cabo de tal forma que ele faça uma volta para baixo antes da entrada para cabo ("coletor de água").

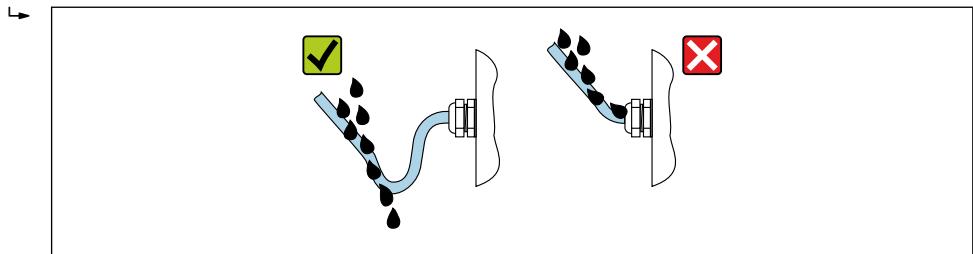

A0029278

6. Os prensa-cabos fornecidos não asseguram a proteção do invólucro quando não estão em uso. Portanto, eles devem ser substituídos por conectores falsos de acordo com a proteção do invólucro.


7.6 Verificação pós-conexão

O equipamento e o cabo não estão danificados (inspeção visual)?	<input type="checkbox"/>
Os cabos usados cumprem com as exigências → 32?	<input type="checkbox"/>
As deformações dos cabos montados foram aliviadas?	<input type="checkbox"/>
Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e vedados? Trecho do cabo com "armadilha d'água" → 43?	<input type="checkbox"/>
Dependendo da versão do equipamento: todos os conectores do equipamento estão firmemente apertados → 37?	<input type="checkbox"/>
Somente para versão remota: ■ O sensor está conectado ao transmissor correto? ■ Verifique o número de série na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor.	<input type="checkbox"/>
A fonte de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação do transmissor ?	<input type="checkbox"/>

A atribuição de terminais está correta ?	<input type="checkbox"/>
Se a fonte de alimentação estiver presente, os valores aparecem no módulo do display?	<input type="checkbox"/>
Todas as tampas dos invólucros estão instaladas corretamente e firmemente apertadas?	<input type="checkbox"/>
A braçadeira de fixação está apertada com segurança?	<input type="checkbox"/>
Os parafusos para o alívio de deformação do cabo foram apertados usando o torque correto → 38?	<input type="checkbox"/>

8 Opções de operação

8.1 Visão geral das opções de operação

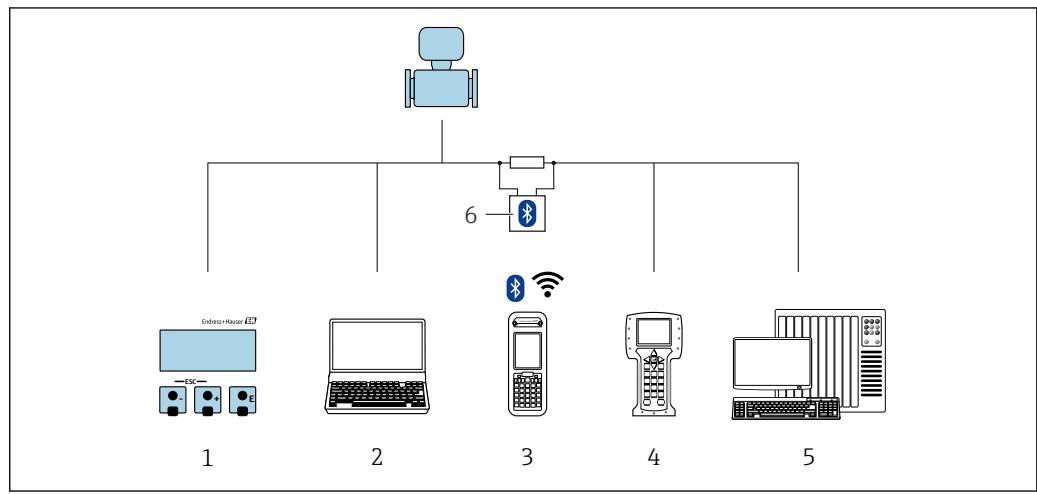


- 1 Operação local via módulo do display
- 2 Computador com ferramenta de operações (por exemplo, FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Comunicador de campo 475
- 5 Sistema de automação (por ex. PLC)
- 6 Modem VIATOR Bluetooth com cabo de conexão

8.2 Estrutura e função do menu de operação

8.2.1 Estrutura geral do menu de operação

 Para uma visão geral do menu de operação para especialistas: consulte o documento "Descrição dos parâmetros de equipamento" fornecido com o equipamento

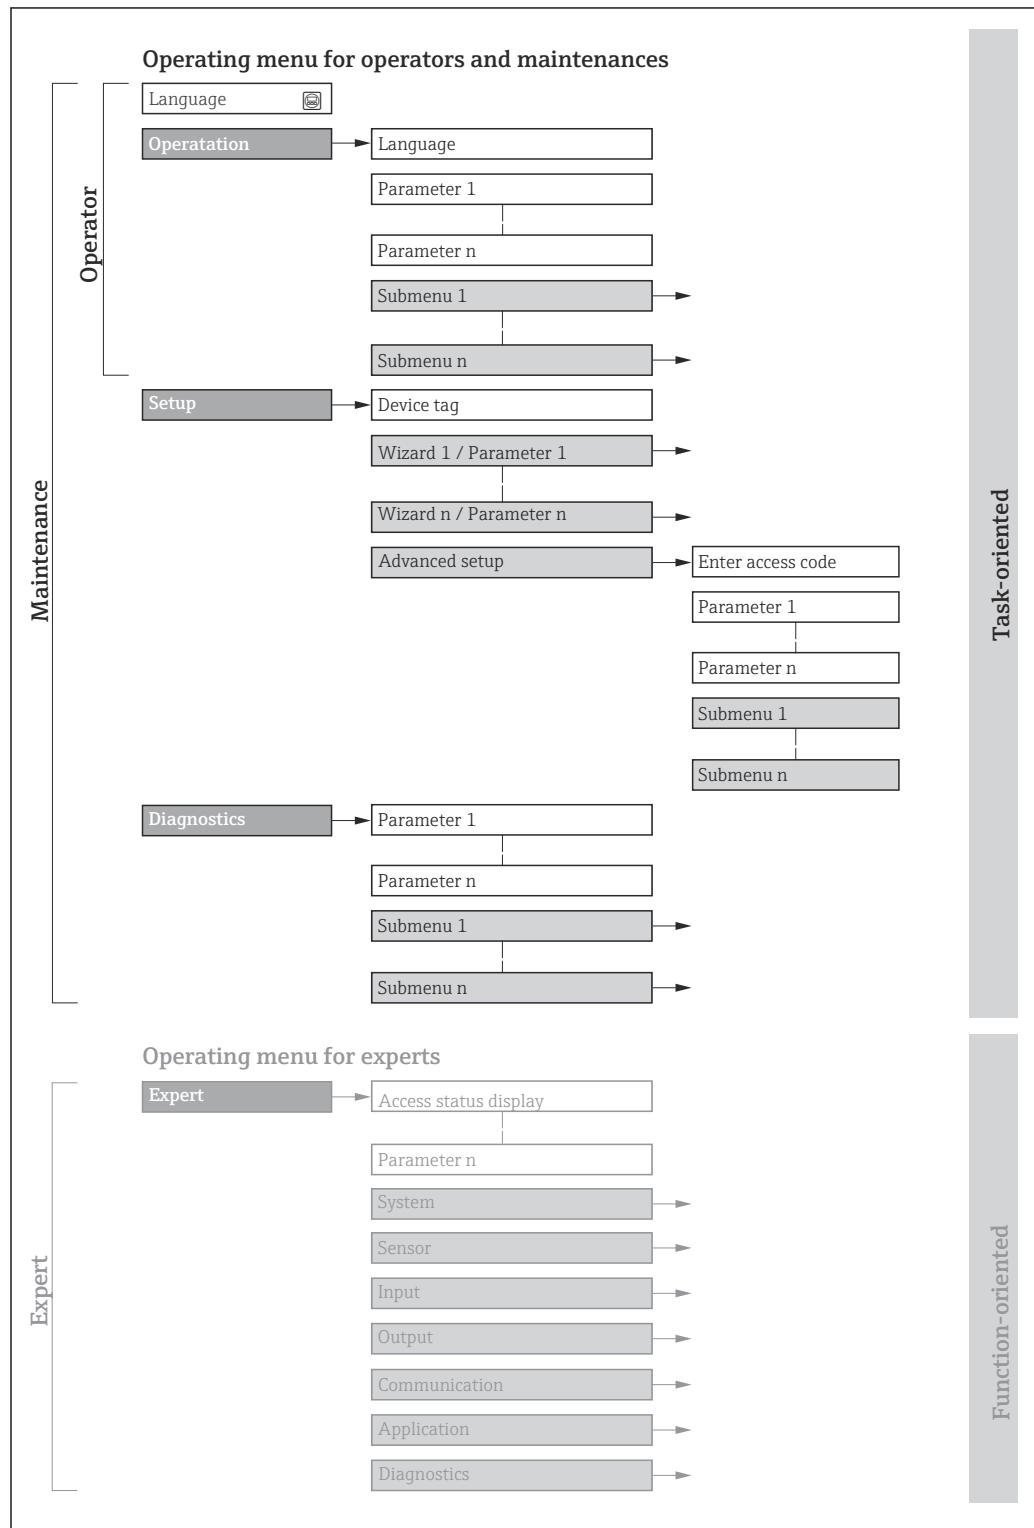

 14 Estrutura esquemática do menu de operação

A0018237-PT


8.2.2 Conceito de operação

As peças individuais do menu de operação são especificadas para certas funções de usuário (por ex. operador, manutenção etc.). Cada função de usuário contém tarefas típicas durante a vida útil do equipamento.

Menu/parâmetro	Funções de usuário e ações	Conteúdo/Significado
Language	Orientado conforme tarefas	Função "Operador", "Manutenção" Tarefas durante a operação: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuração do display operacional ▪ Leitura dos valores medidos
Operação		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuração do display de operação (por ex. formato do display, contraste do display) ▪ Reiniciar e controlar totalizadores
Configuração		Função "Maintenance" Comissionamento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuração da medição ▪ Configuração das entradas e saídas Assistente para comissionamento rápido: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Configuração das unidades do sistema ▪ Definição do meio ▪ Configuração da entrada em corrente ▪ Configurar as saídas ▪ Configuração do display operacional ▪ Definição do condicionamento da saída ▪ Configurar o corte de vazão baixa Configuração avançada <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para mais customizações de configuração da medição (adaptação para condições especiais de medição) ▪ Configuração dos totalizadores ▪ Administração (defina o código de acesso, reinicie o medidor)
Diagnóstico		Função "Maintenance" Localização de falhas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnósticos e eliminação de processos e erros do equipamento ▪ Simulação do valor medido Contém todos os parâmetros para detectar e analisar processos e erros do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lista de diagnóstico Contém até 5 mensagens de erro atualmente pendentes. ▪ Livro de registro de eventos Contém mensagens dos eventos ocorridos. ▪ Informações do equipamento Contém informações para identificar o equipamento ▪ Valor medido Contém todos os valores medidos atuais. ▪ Submenu Registro de dados com opção para pedido "HistoROM estendido" Armazenamento e visualização de valores medidos ▪ Tecnologia Heartbeat Verificação da funcionalidade do equipamento sob demanda e documentação dos resultados da verificação ▪ Simulação Usado para simular os valores medidos ou valores de saída.
Especialista	Orientado para função	Tarefas que necessitam conhecimento detalhado da função do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medições de comissionamento em condições difíceis ▪ Adaptação ideal da medição para condições difíceis ▪ Configuração detalhada da interface de comunicação ▪ Diagnósticos de erro em casos difíceis Contém todos os parâmetros do equipamento e permite acesso direto a eles por meio de um código de acesso. A estrutura deste menu baseia-se nos blocos de função do equipamento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema Contém todos os parâmetros prioritários do equipamento que não afetam a medição ou a comunicação do valor medido ▪ Sensor Configuração da medição. ▪ Saída Configuração da saída de pulso/frequência/comutada ▪ Comunicação Configuração da interface de comunicação digital ▪ Submenus para blocos de função (ex. "Entradas analógicas") Configuração dos blocos de função ▪ Aplicação Configuração das funções que vão além da medição em si (por ex. totalizador) ▪ Diagnóstico Detecção de erro e análise de processo e erros de equipamento e para a simulação do equipamento e Heartbeat Technology.

8.3 Acesso ao menu de operação através do display local

8.3.1 Display de operação

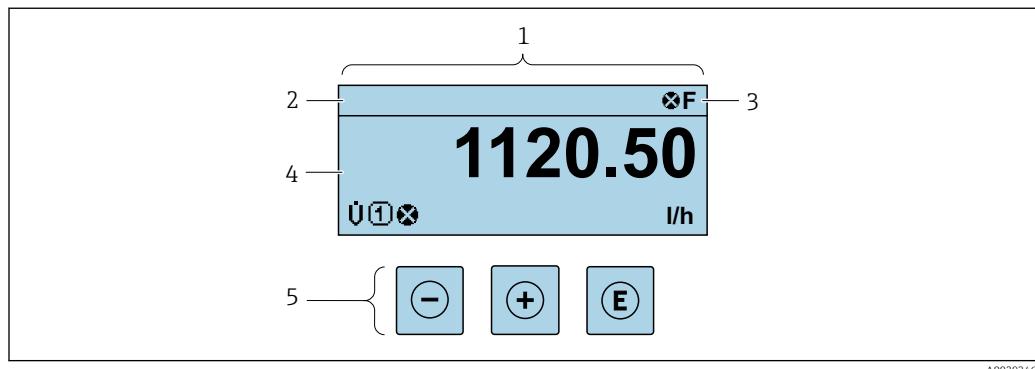

A0029346

- 1 Display de operação
- 2 Nome de tag → 72
- 3 Área de status
- 4 Área de display para valores medidos (até 4 linhas)
- 5 Elementos de operação → 53

Área de status

Os seguintes símbolos aparecem na área de status o display de operação no canto superior direito:

- Sinais de status → 143
 - **F**: Falha
 - **C**: Verificação da função
 - **S**: Fora da especificação
 - **M**: Manutenção necessária
- Comportamento de diagnóstico → 144
 - **☒**: Alarme
 - **⚠**: Aviso
- **🔒**: Bloqueio (o equipamento é travado pelo hardware)
- **➡**: Comunicação (comunicação através da operação remota está ativa)

Área do display

Na área do display, cada valor medido é antecedido por determinados tipos de símbolos para uma descrição mais detalhada:

Variáveis de medição

Símbolo	Significado
U	Vazão volumétrica

i O formato de número e exibição das variáveis medidas podem ser configurados através do parâmetro **Formato de exibição** (→ 82).

Totalizador

Símbolo	Significado
Σ	Totalizador i O número do canal de medição indica qual dos três totalizadores é exibido.

Números do canal de medição


Símbolo	Significado
	<p>Canal de medição 1 a 4</p> <p> O número do canal de medição só é exibido se mais de um canal estiver presente para o mesmo tipo de variável medida (por exemplo, Totalizador 1 a 3).</p>

Comportamento do diagnóstico

Símbolo	Significado
	<p>Alarme</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A medição é interrompida. ■ As saídas do sinal e totalizadores assumem a condição de alarme definida. ■ É gerada uma mensagem de diagnóstico. ■ Para o display local com controle touchscreen: a iluminação de fundo muda para vermelho.
	<p>Aviso</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Medição é retomada. ■ As saídas de sinal e os totalizadores não são afetados. ■ É gerada uma mensagem de diagnóstico.

 O comportamento de diagnóstico refere-se a um evento de diagnóstico que seja relevante à variável medida exibida.


8.3.2 Visualização de navegação

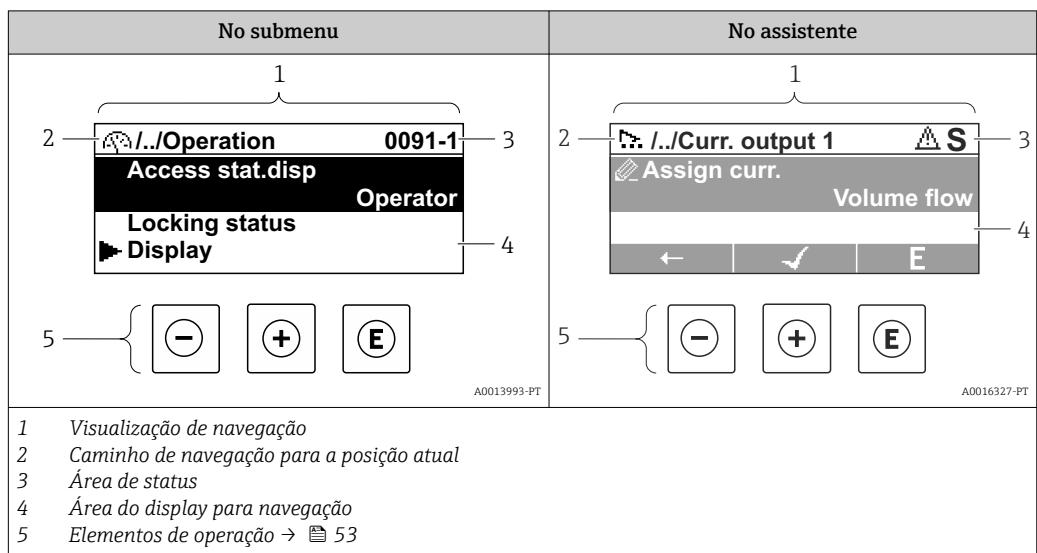

Caminho de navegação

O caminho de navegação para a posição atual é exibido no canto superior esquerdo da visualização de navegação e consiste nos seguintes elementos:

- O símbolo do display para o menu/submenu (►) ou o assistente (☒).
- Omissão do símbolo (/ ../) para níveis de menu de operação intermediários.
- Name do atual submenu, assistente ou parâmetro

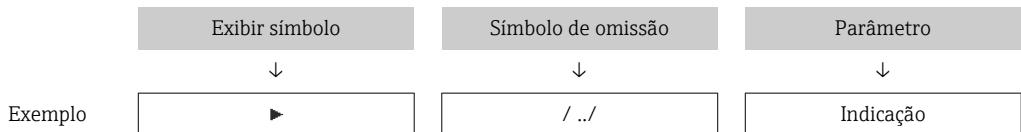

i Para mais informações sobre os ícones de menu, consulte a seção "Área do Display" → [51](#)

Área de status

O seguinte aparece na área de status da visualização de navegação no canto superior direito:

- No submenu
 - O código de acesso direto ao parâmetro (por exemplo, 0022-1)
 - Se um evento de diagnóstico estiver presente, o comportamento de diagnóstico e o sinal de status
- No assistente

Se um evento de diagnóstico estiver presente, o comportamento de diagnóstico e o sinal de status

i ■ Para informações sobre o comportamento de diagnóstico e o sinal de status → [143](#)
 ■ Para informações sobre a função e a entrada do código de acesso direto → [56](#)

Área do display

Menus

Símbolo	Significado
	Operação É exibido: <ul style="list-style-type: none">■ No menu próximo à seleção "Operação"■ À esquerda no caminho de navegação no menu Operação
	Configuração É exibido: <ul style="list-style-type: none">■ No menu próximo à seleção "Setup"■ À esquerda no caminho de navegação no menu Configurar
	Diagnóstico É exibido: <ul style="list-style-type: none">■ No menu próximo à seleção "Diagnostics"■ À esquerda no caminho de navegação no menu Diagnósticos
	Expert É exibido: <ul style="list-style-type: none">■ No menu próximo à seleção "Expert"■ À esquerda no caminho de navegação no menu Expert

Submenus, assistentes, parâmetros

Símbolo	Significado
	Submenu
	Assistentes
	Parâmetros junto ao assistente  Não há símbolo de display para parâmetros em submenus.


Procedimento de bloqueio

Símbolo	Significado
	Parâmetro bloqueado Quando exibido na frente de uma denominação do parâmetro, indica que o parâmetro está bloqueado. <ul style="list-style-type: none">■ Para um código de acesso específico para o cliente■ Pela chave de proteção contra gravação de hardware

Assistentes

Símbolo	Significado
	Altera para o parâmetro anterior.
	Confirma o valor de parâmetro e alterna para o parâmetro seguinte.
	Abre a visualização de edição do parâmetro.

8.3.3 Visualização para edição

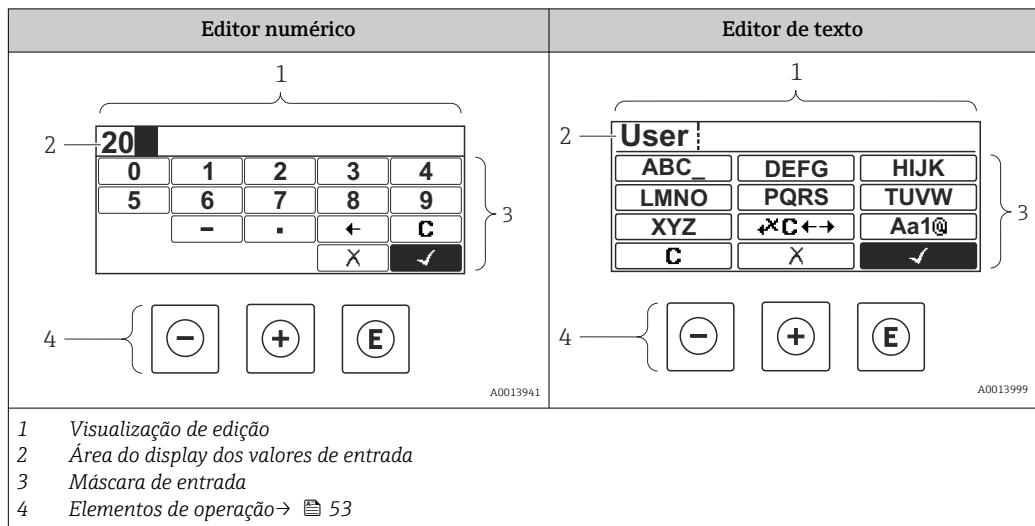

Tela de entrada

Os seguintes símbolos de entrada estão disponíveis na máscara de entrada do editor numérico e de texto:

Editor numérico

Símbolo	Significado
0 ...	Seleção de números de 0 a 9
.	Insere um separador decimal na posição do cursor.
-	Insere um sinal de menos na posição do cursor.
✓	Confirma a seleção.
←	Move a posição de entrada uma posição para a esquerda.
X	Sai da entrada sem aplicar as alterações.
C	Limpa todos os caracteres inseridos.

Editor de texto

Símbolo	Significado
Aa1@ ...	Alternar <ul style="list-style-type: none"> ■ Entre letras minúsculas e maiúsculas ■ Para inserir números ■ Para inserir caracteres especiais
ABC_ ...	Seleção de letras de A a Z.

	Seleção de letras de A a Z.
	Seleção de caracteres especiais.
	Confirma a seleção.
	Altera para a seleção das ferramentas de correção.
	Sai da entrada sem aplicar as alterações.
	Limpa todos os caracteres inseridos.

Correção do texto em

Símbolo	Significado
	Limpa todos os caracteres inseridos.
	Move a posição de entrada uma posição para a direita.
	Move a posição de entrada uma posição para a esquerda.
	Exclui um caractere imediatamente à esquerda da posição de entrada.

8.3.4 Elementos de operação

Tecla de operação	Significado
	<p>Tecla "menos"</p> <p><i>No menu, submenu</i> Move a barra de seleção para cima em uma lista de opções</p> <p><i>Em assistentes</i> Vai para o parâmetro anterior</p> <p><i>No editor de texto e numérico</i> Na tela de entrada, move a barra de seleção para a esquerda (para trás)</p>
	<p>Tecla mais</p> <p><i>No menu, submenu</i> Move a barra de seleção para baixo em uma lista de opções</p> <p><i>Em assistentes</i> Vai para o próximo parâmetro</p> <p><i>No editor de texto e numérico</i> Na tela de entrada, move a barra de seleção para a direita (para frente)</p>

Tecla de operação	Significado
	<p>Tecla Enter</p> <p><i>Na tela operacional</i> Pressione a tecla por 2 s para abrir o menu de contexto.</p> <p><i>No menu, submenu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pressionar a tecla: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abre o menu, submenu ou o parâmetro selecionado. ▪ Inicia o assistente. ▪ Se o texto de ajuda estiver aberto, fecha o texto de ajuda do parâmetro. ▪ Pressionar a tecla por 2 s em um parâmetro: Se houver, abre o texto de ajuda para a função do parâmetro. <p><i>Em assistentes</i> Abre a visualização de edição do parâmetro e confirma o valor do parâmetro</p> <p><i>No editor de texto e numérico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pressionar a tecla: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abre o grupo selecionado. ▪ Executa a ação selecionada. ▪ Pressionar a tecla por 2 s confirma o valor do parâmetro editado.
	<p>Combinação da tecla "Esc" (pressionar teclas simultaneamente)</p> <p><i>No menu, submenu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pressionar a tecla: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sai do nível de menu atual e vai para o próximo nível mais alto. ▪ Se o texto de ajuda estiver aberto, fecha o texto de ajuda do parâmetro. ▪ Pressionar a tecla por 2 s retorna ao display operacional ("posição inicial"). <p><i>Em assistentes</i> Sai do assistente e vai para o próximo nível mais alto</p> <p><i>No editor de texto e numérico</i> Fecha o editor de texto ou numérico sem aplicar as mudanças.</p>
	<p>Combinação da tecla Mais/Enter (pressionar e manter pressionadas as teclas simultaneamente)</p> <p>Aumenta o contraste (ajuste mais escuro).</p>
	<p>Combinação da tecla Menos/Mais/Enter (pressionar teclas simultaneamente)</p> <p><i>Na tela operacional</i> Habilita ou desabilita o bloqueio do teclado (apenas para o módulo de display SD02).</p>

8.3.5 Abertura do menu de contexto


Usando o menu de contexto, o usuário pode acessar os seguintes menus rápidas e diretamente a partir do display operacional:

- Configurar
- Configuração do display reserva
- Simulação

Acessar e fechar o menu de contexto

O usuário está no display operacional.

1. Pressione as teclas e por mais de 3 segundos.
↳ O menu de contexto abre.

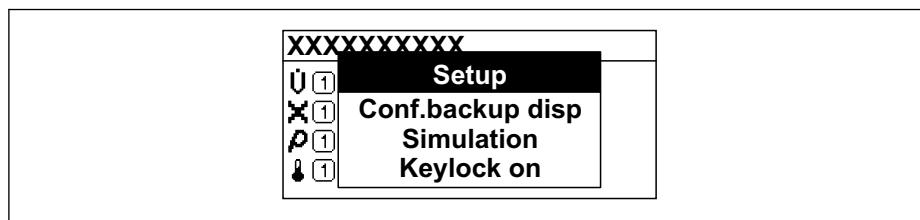

2. Pressione + simultaneamente.
↳ O menu de contexto é fechado e o display operacional aparece.

Acessando o menu por meio do menu de contexto


1. Abra o menu de contexto.
2. Pressione para navegar no menu desejado.
3. Pressione para confirmar a seleção.
↳ O menu selecionado abre.

8.3.6 Navegar e selecionar a partir da lista

Elementos de operação diferentes são utilizados para navegar através do menu de operação. O caminho de navegação é exibido à esquerda no cabeçalho. Os ícones são exibidos na frente dos menus individuais. Esses ícone também são exibidos no cabeçalho durante a navegação.

i Para uma explicação da visão de navegação com símbolos e elementos de operação
→ [50](#)

Exemplo: Definir o número de valores medidos exibidos em "2 valores"

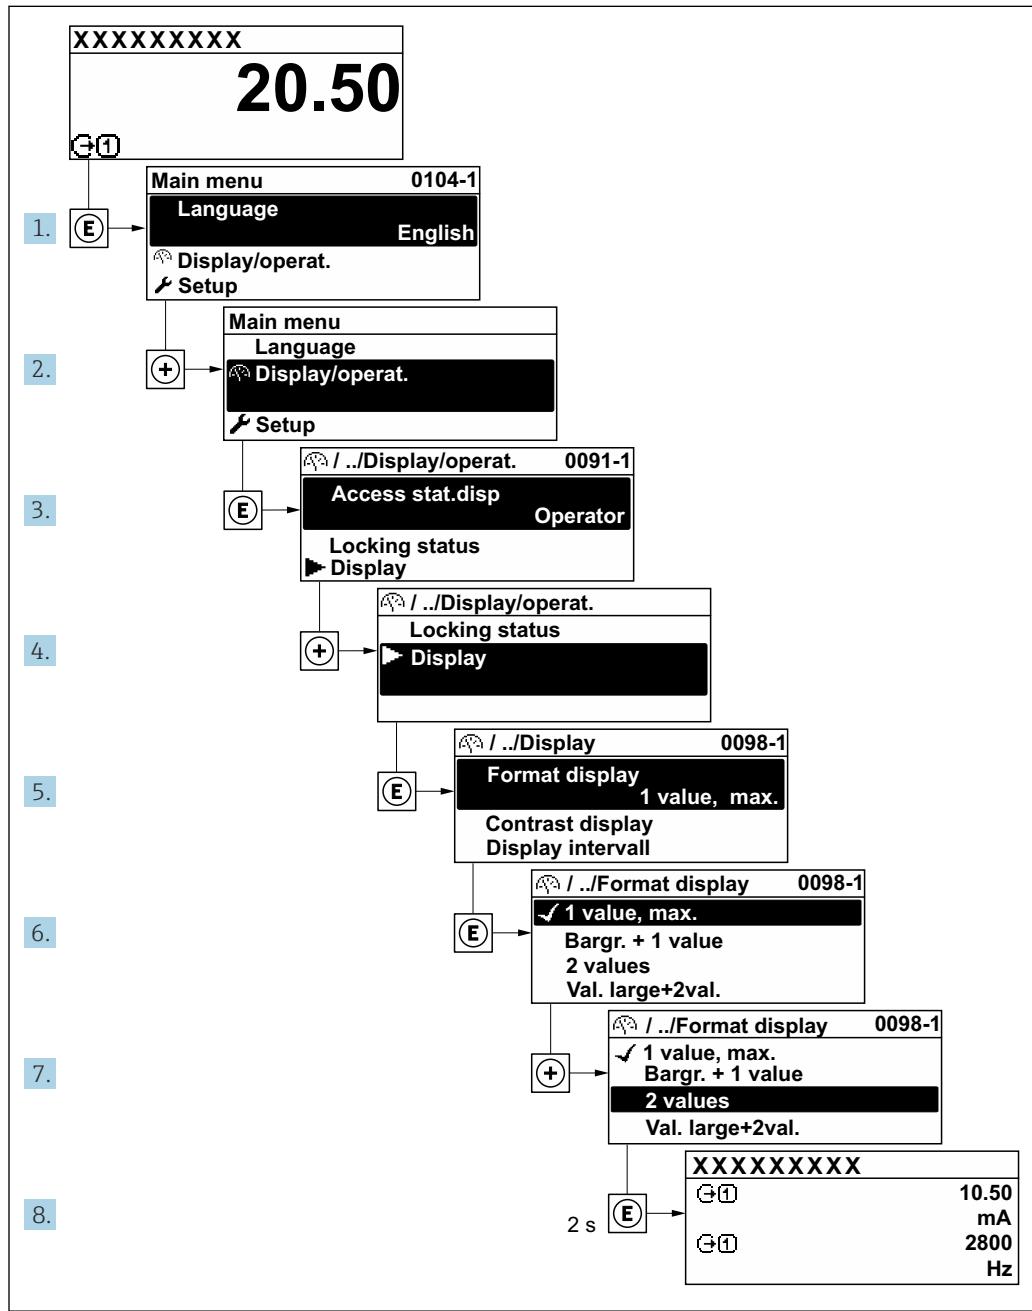


8.3.7 Chamada de parâmetro diretamente

Um número de parâmetro é atribuído a cada parâmetro para que possa acessar um parâmetro diretamente através do display local. Inserir este código de acesso no parâmetro **Acesso direto** chama o parâmetro desejado diretamente.

Caminho de navegação

Especialista → Acesso direto

O código de acesso direto é formado por um número de 5 dígitos (no máximo) e o número do canal, o qual identifica o canal de uma variável de processo: ex. 00914-2. Na visualização de navegação, ele aparece do lado direito do cabeçalho no parâmetro selecionado.

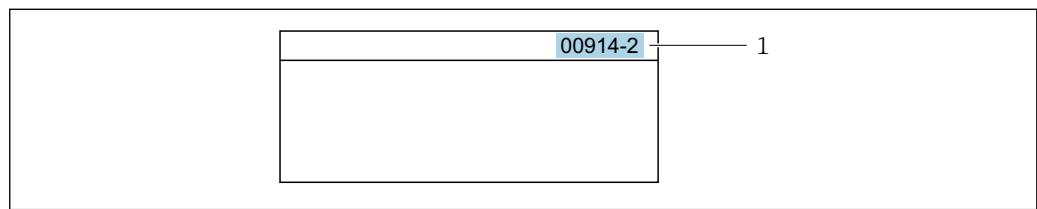

1 Código de acesso direto

Observe o seguinte ao inserir o código de acesso direto:

- Os zeros à esquerda no código de acesso direto não precisam ser inseridos.
Exemplo: Insira "914" ao invés de "00914"
- Se não for inserido nenhum número do canal, o canal 1 é aberto automaticamente.
Exemplo: Insira 00914 → parâmetro **Atribuir variável do processo**
- Se for aberto um canal diferente: Insira o código de acesso direto com o número do canal correspondente.
Exemplo: Insira 00914-2 → parâmetro **Atribuir variável do processo**

Para o código de acesso direto dos parâmetros individuais, consulte o documento "Descrição dos parâmetros do equipamento" para o equipamento


8.3.8 Chamada de texto de ajuda

O texto de ajuda está disponível para alguns parâmetros e pode ser convocado na visualização do navegador. O texto de ajuda fornece uma breve explicação da função do parâmetro e fornecendo suporte para comissionamento rápido e seguro.

Chamada e fechamento de texto de ajuda

O usuário está na visualização de navegação e a barra de seleção está em um parâmetro.

1. Pressione para 2 s.
↳ O texto de ajuda para o parâmetro selecionado abre.

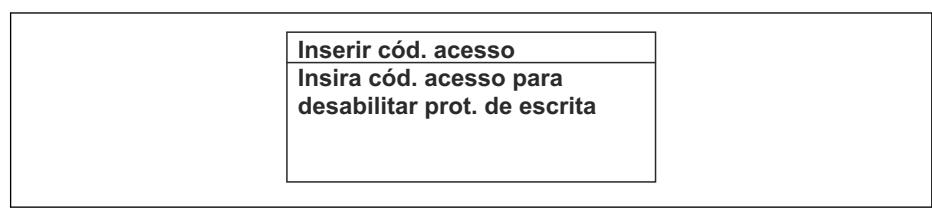


15 Exemplo: texto de ajuda para o parâmetro "Inserir código de acesso"

2. Pressione + simultaneamente.
↳ O texto de ajuda é fechado.

8.3.9 Alterar parâmetros

i Para uma descrição da visualização de edição - que consiste em editor de texto e editor numérico - com símbolos → 52, para uma descrição dos elementos de operação → 53

Exemplo: Alteração do nome do tag no parâmetro "Descrição do tag" de 001-FT-101 à 001-FT-102

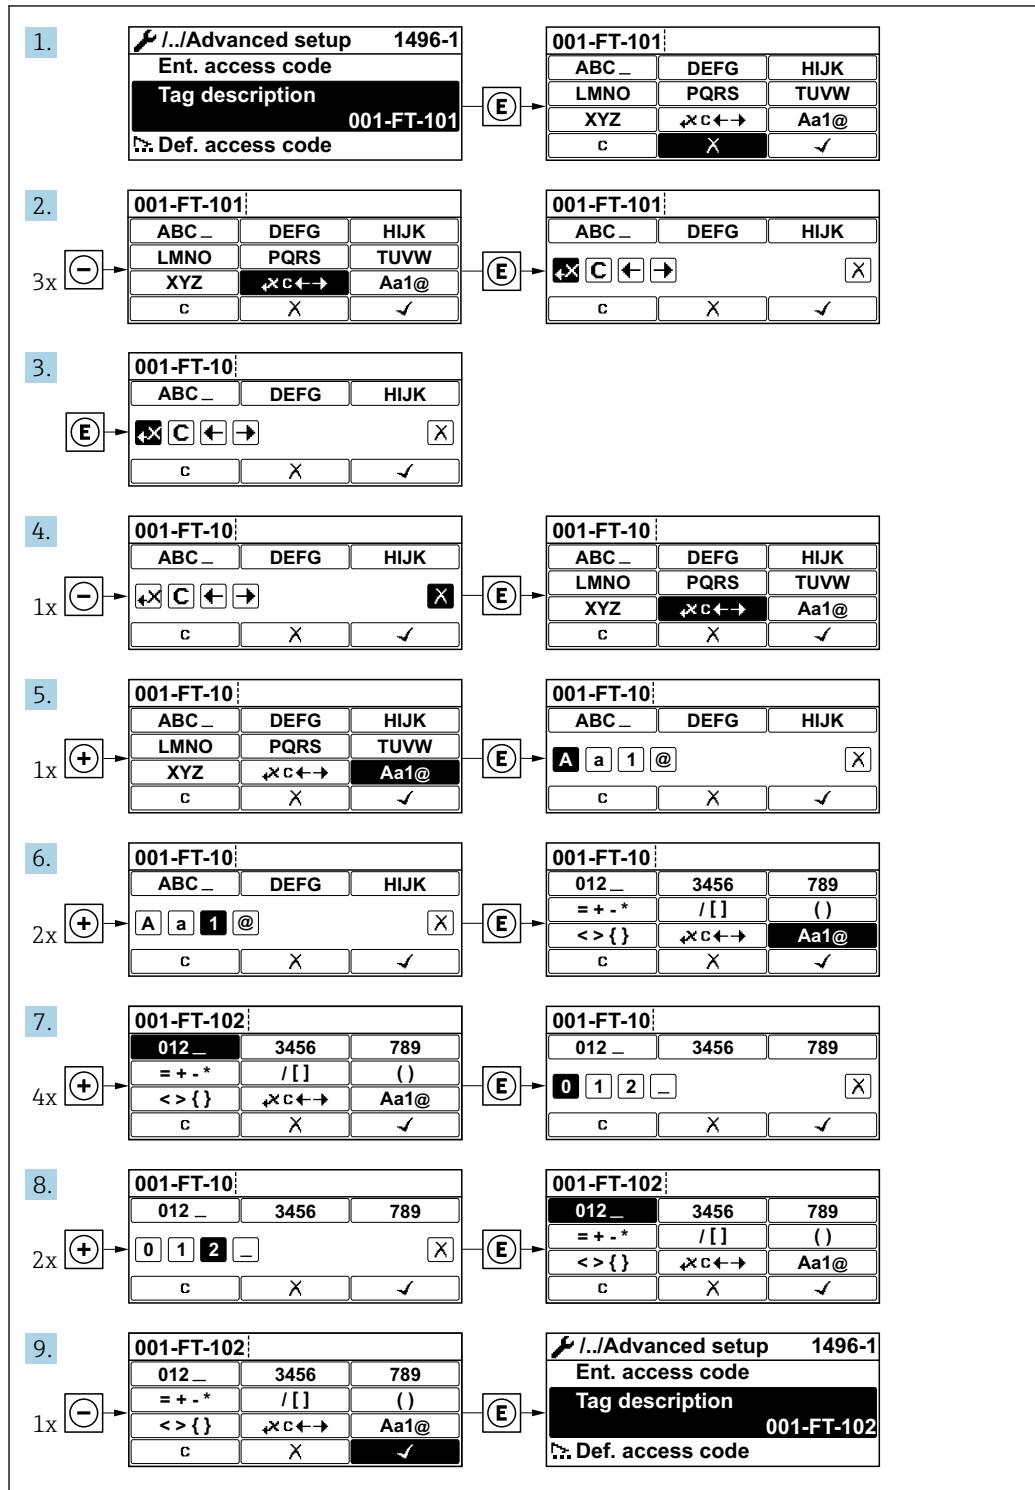

A0029563-PT

Uma mensagem é exibida se o valor inserido estiver fora da faixa permitida.

Ins. código de acesso
Ins. inválida ou fora de alcance
valor
Mín:0
Máx:9999

A0014049-PT

8.3.10 Funções de usuário e autorização de acesso relacionada

As duas funções de usuário "Operador" e "Manutenção" possuem acesso de escrita diferentes aos parâmetros se o cliente definir um código de acesso específico para o usuário. Isso protege a configuração do equipamento por intermédio do display local contra acesso não autorizado.

Definição da autorização de acesso para funções de usuário

Quando o equipamento é fornecido de fábrica, ainda não há um código de acesso definido. A autorização de acesso (acesso leitura e gravação) para o equipamento não é restrita e corresponde ao função do usuário "Manutenção".

- Definir o código de acesso.
 - ↳ O função do usuário "Operador" é redefinido além do função do usuário "Manutenção". A autorização de acesso é diferente para as duas funções de usuário.

Autorização de acesso para parâmetros: função do usuário "Manutenção"

Status do código de acesso	Acesso para leitura	Acesso para gravação
Um código de acesso ainda não foi definido (Ajuste de fábrica).	✓	✓
Após a definição de um código de acesso.	✓	✓ ¹⁾

- 1) O usuário tem acesso de gravação apenas após inserir o código de acesso.

Autorização de acesso para parâmetros: função do usuário "Operador"

Status do código de acesso	Acesso para leitura	Acesso para gravação
Após a definição de um código de acesso.	✓	- ¹⁾

- 1) Apesar do código de acesso definido, alguns parâmetros podem sempre ser modificados e, assim, são excluídos da proteção contra gravação, pois eles não afetam a medição: proteção contra gravação via código de acesso

 A função na qual o usuário está atualmente conectado é indicada pelo Parâmetro **Display de status de acesso** Caminho de navegação: Operação → Display de status de acesso

8.3.11 Desabilitação da proteção contra gravação através do código de acesso

Se o símbolo  aparece no display local em frente a um parâmetro, o parâmetro é protegido contra gravação por um código de acesso específico do usuário e seu valor não pode ser mudado no momento usando a operação local →  116.

A proteção contra gravação do parâmetro através da operação local pode ser desabilitada inserindo o código de acesso específico para o usuário em parâmetro **Inserir código de acesso** através da respectiva opção de acesso.

1. Após pressionar , o prompt de entrada para o código de acesso aparece.

2. Insira o código de acesso.
 - ↳ O símbolo  na frente dos parâmetros desaparece, todos os parâmetros previamente protegidos contra gravação tornam-se reabilitados.

8.3.12 Habilitação e desabilitação do bloqueio do teclado

O bloqueio do teclado permite bloquear o acesso a todo o menu de operação através de operação local. Como resultado, não se torna mais possível navegar pelo menu de operação ou mudar os valores dos parâmetros individuais. Os usuários podem somente ler os valores medidos no display de operação.

O bloqueio do teclado é ativado e desativado no menu de contexto.

Ativação do bloqueio do teclado

 **Somente para o display SD03**

O bloqueio do teclado é ativado automaticamente:

- Se o equipamento não foi operado através do display por > 1 minuto.
- Sempre que o equipamento é reiniciado.

Para ativar o bloqueio manualmente:

1. O equipamento está no display do valor medido.
Pressione as teclas  e  por 3 segundos.

↳ Aparece o menu de contexto.

2. No menu de contexto, selecione **Chave de bloqueio ativadaaa opção**.
↳ O bloqueio do teclado está ativado.

 Se o usuário tentar acessar o menu de operação enquanto o bloqueio estiver ativo, a **Chave de bloqueio ativada** mensagem aparece.

Desativação do bloqueio do teclado

- O bloqueio do teclado está ativado.
Pressione as teclas  e  por 3 segundos.
↳ O bloqueio do teclado está desativado.


8.4 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação

A estrutura do menu operacional nas ferramentas de operação é a mesma para operação através do display local.

8.4.1 Conexão da ferramenta de operação

Pela rede FOUNDATION Fieldbus

Essa interface de comunicação está disponível em versões do equipamento com FOUNDATION Fieldbus.

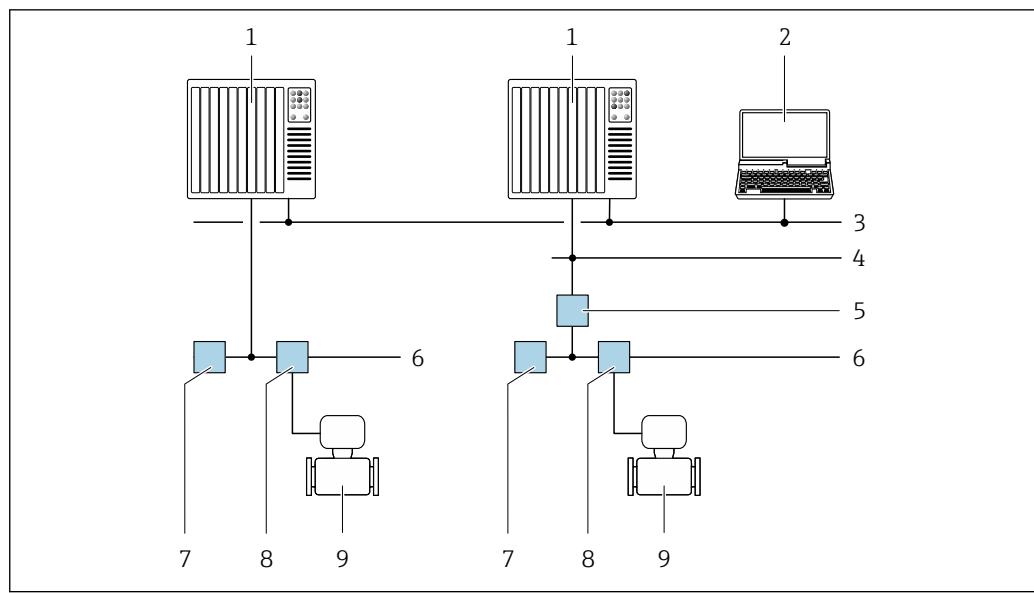


A0028837

16 Opções para operação remota através da rede FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema de automação
- 2 Computador com cartão de rede FOUNDATION Fieldbus
- 3 Rede industrial
- 4 Rede Ethernet de alta velocidade FF-HSE
- 5 Acoplador de segmento FF-HSE/FF-H1
- 6 Rede FOUNDATION Fieldbus FF-H1
- 7 Rede de fonte de alimentação FF-H1
- 8 T-box
- 9 Instrumento de medição

Através da interface de operação (CDI)

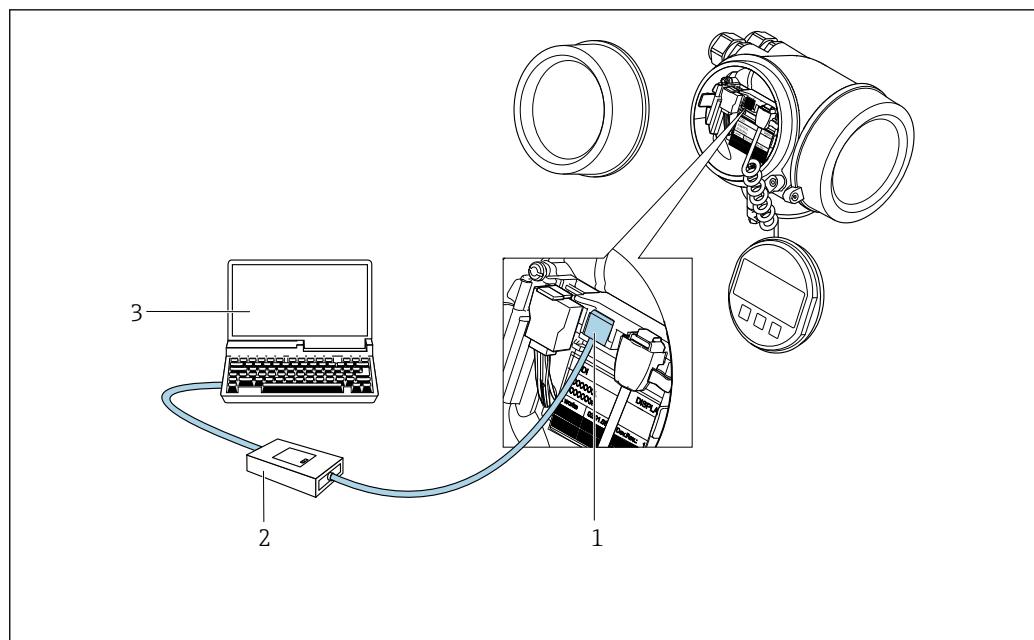

A0034056

- 1 Interface de serviço (CDI = Interface de dados comuns Endress+Hauser) do instrumento de medição
- 2 Commubox FXA291
- 3 Computador com ferramenta de operação (por ex. FieldCare ou DeviceCare) e (CDI) DeviceDTM

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Escopo de função

Field Xpert SFX350 e Field Xpert SFX370 são computadores portáteis para comissionamento e manutenção. Eles permitem configuração e diagnóstico eficientes do equipamento para equipamentos HART e FOUNDATION fieldbus em **área não classificada** (SFX350, SFX370) e **em área classificada** (SFX370).



Para detalhes, consulte Instruções de operação BA01202S

Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte as informações → 65

8.4.3 FieldCare

Faixa de função

Ferramenta de gerenciamento de ativos industriais baseada em FDT (Field Device Technology) da Endress+Hauser. É possível configurar todos os equipamentos de campo inteligentes em um sistema e ajudá-lo a gerenciá-los. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.

Acesso através de:

Funções típicas:

- Configuração de parâmetros do transmissor
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (upload/download)
- Documentação do ponto de medição
- Visualização da memória de valor medido (registrator de linha) e registro de eventos



- Instruções de operação BA00027S
- Instruções de operação BA00059S




Fonte para arquivos de descrição do equipamento → 65

Estabelecimento da conexão



- Instruções de operação BA00027S
- Instruções de operação BA00059S

Interface do usuário

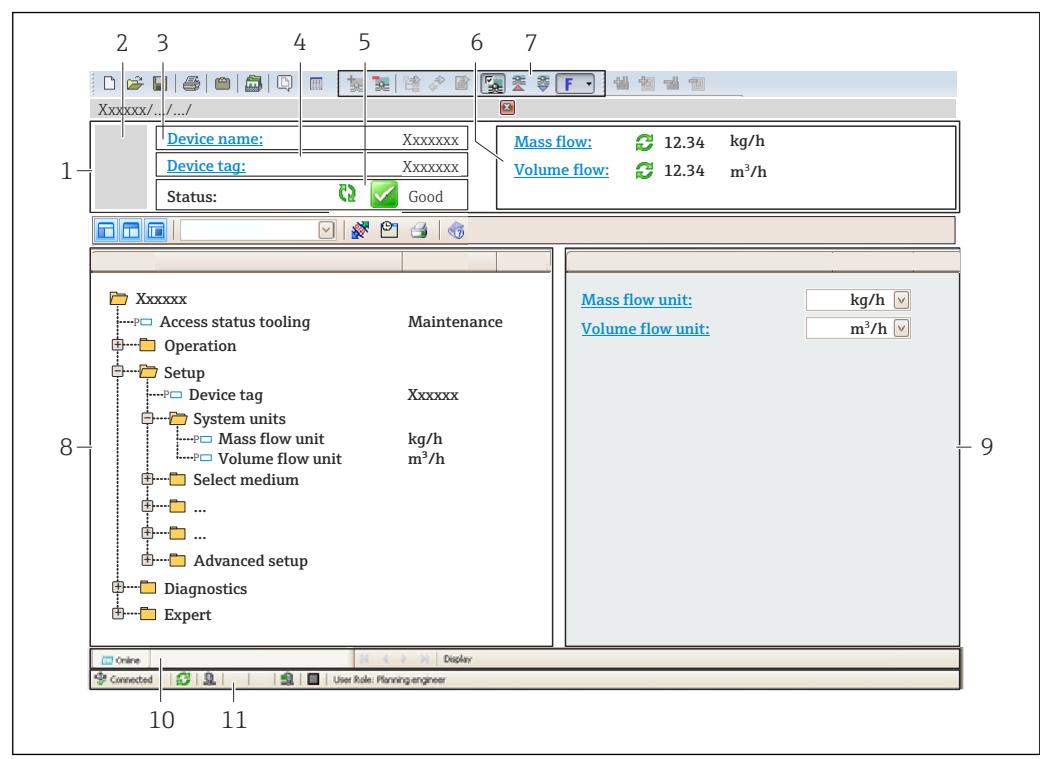

A0021051-PT

- 1 Cabeçalho
- 2 Imagem do equipamento
- 3 Nome do equipamento
- 4 Nome de tag
- 5 Área de status com sinal de status → 146
- 6 Área de exibição para os valores medidos atuais
- 7 Barra de ferramentas de edição com funções adicionais como salvar/carregar, lista de eventos e criar documentação
- 8 Área de navegação com estrutura do menu de operação
- 9 Área de trabalho
- 10 Campo de ação
- 11 Área de status

8.4.4 DeviceCare

Faixa de função

Ferramenta para conectar e configurar os equipamentos de campo Endress+Hauser.

O modo mais rápido de configurar equipamentos de campo Endress+Hauser é com a ferramenta dedicada "DeviceCare". Junto com os gerenciadores de tipo de equipamento (DTMs), ele apresenta uma solução conveniente e abrangente.

Catálogo de inovação IN01047S

Fonte para arquivos de descrição do equipamento → 65

8.4.5 Gerenciador de equipamento AMS

Faixa de função

Programa da Emerson Process Management para operação e configuração de medidores através do protocolo FOUNDATION Fieldbus H1.



Fonte para arquivos de descrição do equipamento → [65](#)

8.4.6 Comunicador de campo 475

Escopo de função

Terminal industrial portátil da Emerson Process Management para configuração remota e exibição do valor medido através do protocolo FOUNDATION Fieldbus H1.

Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Consulte as informações → [65](#)

9 Integração do sistema

9.1 Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento

9.1.1 Dados da versão atual para o equipamento

Versão do firmware	01.01.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na página de rosto das Instruções de operação ■ Na etiqueta de identificação do transmissor ■ Parâmetro Versão do firmware Diagnóstico → Informações do equipamento → Versão do firmware
Data de lançamento da versão do firmware	01.2018	---
ID do fabricante	452B48 hex	Parâmetro ID do fabricante Diagnóstico → Informações do equipamento → ID do fabricante
ID do tipo de equipamento	0x1038	Parâmetro Tipo de equipamento Diagnóstico → Informações do equipamento → Tipo de equipamento
Revisão do equipamento	2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na etiqueta de identificação do transmissor ■ Parâmetro Versão do equipamento Diagnóstico → Informações do equipamento → Versão do equipamento
Revisão DD	Informações e arquivos abaixo:	
Revisão CFF	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com ■ www.fieldbus.org 	



Para uma visão geral das diferentes versões de firmware para o equipamento

9.1.2 Ferramentas de operação

O arquivo de descrição do equipamento adequado para as ferramentas de operação individuais está listado abaixo, juntamente com a informação sobre onde o arquivo pode ser adquirido.

Ferramenta de operação através de FOUNDATION Fieldbus	Fontes para obtenção dos arquivos de descrição do equipamento (DD)
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → Área de download ■ CD-ROM (contate a Endress+Hauser) ■ DVD (contate a Endress+Hauser)
DeviceCare	<ul style="list-style-type: none"> ■ www.endress.com → Área de download ■ CD-ROM (contate a Endress+Hauser) ■ DVD (contate a Endress+Hauser)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Field Xpert SFX350 ■ Field Xpert SFX370 	Use a função atualizar do terminal portátil
Gerenciador de equipamento AMS (Gerência de Processo Emerson)	www.endress.com → Área de download
Comunicador de campo 475 (Gerência de Processo Emerson)	Use a função atualizar do terminal portátil

9.2 Dados de transmissão cíclica

Transmissão cíclica de dados ao usar os arquivos de descrição do equipamento (DD).

9.2.1 Modelo do bloco

O modelo do bloco mostra quais dados de entrada e saída o medidor torna disponível para troca de dados cíclica. A troca de dados cíclica é efetuada com um FOUNDATION Fieldbus principal (classe 1), por exemplo um sistema de controle etc.

Texto no display (xxxx... = número de série)	Índice de base	Descrição
RESOURCE_xxxxxxxxxx	400	Bloco de recurso
SETUP_xxxxxxxxxx	600	Bloco do transdutor de Setup
DISPLAY_xxxxxxxxxx	800	"Display" Bloco do transdutor
HISTOROM_xxxxxxxxxx	1000	"HistoROM" Bloco do transdutor
DIAGNOSTIC_xxxxxxxxxx	1200	Diagnóstico do Bloco do transdutor
EXPERT_CONFIG_xxxxxxxxxx	1400	Configuração especializada do bloco do transdutor
SERVICE_SENSOR_xxxxxxxxxx	1600	Bloco do transdutor do sensor de manutenção
TOTAL_INVENTORY_COUNTER_xxxxxxxx xxx	1800	Totalizador do bloco do transdutor
HEARTBEAT_TECHNOLOGY_xxxxxxxxxx	2000	"Heartbeat" do bloco do transdutor
ANALOG_INPUT_1_xxxxxxxxxx	3600	Bloco de função de Entrada Analógica 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_xxxxxxxxxx	3800	Bloco de função de Entrada Analógica 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_xxxxxxxxxx	4000	Bloco de função de Entrada Analógica 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_xxxxxxxxxx	4200	Bloco de função de Entrada Analógica 4 (AI)
MULTI_ANALOG_OUTPUT_xxxxxxxxxx	4400	Bloco de saída analógica múltipla (MAO)
DIGITAL_INPUT_1_xxxxxxxxxx	4600	Bloco função da entrada discreta 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_xxxxxxxxxx	4800	Bloco função da entrada discreta 2 (DI)
MULTI_DIGITAL_OUTPUT_xxxxxxxxxx	5000	Bloco de saída discreta múltipla (MDO)
PID_xxxxxxxxxx	5200	Bloco de função PID (PID)
INTEGRATOR_xxxxxxxxxx	5400	Bloco de função do Integrador (INTG)

9.2.2 Descrição dos módulos

O valor de entrada de um módulo/função é definido através do parâmetro **Channel**.

Módulo AI (Entrada analógica)

Quatro blocos de entrada analógica estão disponíveis.

Canal	Variável medida
0	Não inicializada (ajuste de fábrica)
7	Temperatura
9	Vazão volumétrica
11	Vazão mássica
13	Vazão volumétrica corrigida
14	Densidade
16	Totalizador 1

Canal	Variável medida
17	Totalizador 2
18	Totalizador 3
20	Pressão
21	Volume específico
37	Velocidade da vazão
38	Vazão de energia
45	Pressão de vapor saturado calculada
46	Vazão mássica total
47	Vazão mássica condensada
49	Diferença de vazão de calor
50	Número Reynolds
74	Grau de superaquecimento

Módulo MAO (saída analógica múltipla)

Canal	Designação
121	Canal_0

Estrutura

Canal_0							
Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8

Valores	Variável medida
Valor 1	Pressão externa ¹⁾
Valor 2	Pressão relativa
Valor 3	Densidade
Valor 4	Temperatura
Valor 5	2ª diferença de calor de temperatura
Valor 6	Não atribuído
Valor 7	Não atribuído
Valor 8	Não atribuído

1) As variáveis de compensação devem ser transmitidas para o equipamento na unidade básica da SI

 A seleção é feita através do: Especialista → Sensor → Compensação externa

Módulo DI (Entrada discreta)

Dois blocos de entrada discreta estão disponíveis.

Canal	Função do equipamento	Estado
0	Não inicializada (ajuste de fábrica)	–
101	Estado de saída comutada	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0 = Inativo ■ 1 = Ativo

Canal	Função do equipamento	Estado
103	Baixa vazão	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0 = Inativo ■ 1 = Ativo
105	Verificação do status ¹⁾	<p>Status da verificação Verificação: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 = Não feito ■ 1 = Falhou ■ 2 = Sendo executado ■ 3 = Concluído </p> <p>Resultado geral da verificação Verificação: <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 = Falhou ■ 5 = Passou ■ 6 = Inativo ■ 7 = Não usado </p> <p>Status; resultado <ul style="list-style-type: none"> ■ 17 = Status: Não feito; Resultado: falhou ■ 18 = Status: falhou; Resultado: falhou ■ 20 = Status: sendo executado; Resultado: falhou ■ 24 = Status: concluído; Resultado: falhou ■ 33 = Status: Não feito; Resultado: passou ■ 34 = Status: falhou; Resultado: passou ■ 36 = Status: sendo executado; Resultado: passou ■ 40 = Status: concluído; Resultado: passou ■ 65 = Status: Não feito; Resultado: Não feito ■ 66 = Status: falhou; Resultado: Não feito ■ 68 = Status: sendo executado; Resultado: Não feito ■ 72 = Status: concluído; Resultado: Não feito </p>

1) Apenas disponível com o pacote de aplicação "Heartbeat Verification"

módulo MDO (Saída Discreta Múltipla)

Canal	Designação
122	Channel_DO

Estrutura

Channel_DO							
Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8

Valor	Função do equipamento	Estado
Valor 1	Reiniciar totalizador 1	0 = off, 1 = executa
Valor 2	Reiniciar totalizador 2	0 = off, 1 = executa
Valor 3	Reiniciar totalizador 3	0 = off, 1 = executa
Valor 4	Controle da vazão	0 = off, 1 = ativo

Valor	Função do equipamento	Estado
Valor 5	Iniciar verificação da heartbeat ¹⁾	0 = off, 1 = inicia
Valor 6	Saída comutada de status	0 = off, 1 = ligado
Valor 7	Não atribuído	-
Valor 8	Não atribuído	-

1) Apenas disponível com o pacote de aplicação "Heartbeat Verification"

9.2.3 Tempos de execução

Bloco de função	Período de execução (ms)
Bloco de função de Entrada Analógica (AI)	14
Bloco função da entrada discreta (DI)	12
Bloco de função PID (PID)	13
Bloco de saída analógica múltipla (MAO)	11
Bloco de saída discreta múltipla (MDO)	14
Bloco de função do Integrador (INTG)	16

9.2.4 Métodos

Método	Bloco	Navegação	Descrição
Definir para modo "AUTO"	Resource block	Através do menu: Especialista → Comunicação → Resource block → Target mode	Este método define o bloco de recurso e todos os blocos do transdutor para o modo AUTO (Automático).
Definir para modo "OOS"	Resource block	Através do menu: Especialista → Comunicação → Resource block → Target mode	Este método define o bloco de recurso e todos os blocos do transdutor para o modo OOS (Fora de serviço).
Reinicialização	Resource block	Através do menu: Especialista → Comunicação → Resource block → Restart	Esse método é usado para selecionar a configuração para o parâmetro Restart no bloco de recurso. Isso redefine os parâmetros do equipamento para um valor específico. As seguintes opções são compatíveis: <ul style="list-style-type: none">▪ Uninitialized▪ Run▪ Resource▪ Defaults▪ Processor▪ Para configurações de entrega
Parâmetro ENP	Resource block	Através do menu: Ações → Métodos → Calibrar → parâmetro ENP	Este método é usado para exibir e configurar os parâmetros da etiqueta de identificação eletrônica (ENP).
Diagnóstico geral - Informações de correção	Bloco do transdutor de diagnóstico	Através do link: Símbolo de Namur	Este método é usado para exibir o diagnóstico de eventos com a prioridade máxima que está atualmente ativo e as medidas corretivas correspondentes.
Diagnósticos reais - Informações de correção	Bloco do transdutor de diagnóstico	Através do menu: <ul style="list-style-type: none">▪ Configurar/Setup → Diagnósticos → Diagnóstico atual▪ Equipamento/Diagnósticos → Diagnósticos	Este método é usado para exibir as medidas corretivas para o diagnóstico de eventos com a prioridade máxima que está atualmente ativo.  Esse método está disponível apenas se tiver ocorrido um evento de diagnóstico apropriado.

Método	Bloco	Navegação	Descrição
Diagnóstico anterior - Informações de correção	Bloco do transdutor de diagnóstico	Através do menu: ■ Configurar/Setup → Diagnósticos → Diagnóstico anterior ■ Equipamento/Diagnósticos → Diagnósticos	Este método é usado para exibir medidas corretivas para o evento de diagnóstico anterior.  Esse método está disponível apenas se tiver ocorrido um evento de diagnóstico apropriado.
Diagnóstico 1 – Informações de correção	Bloco do transdutor de diagnóstico	■ Através do menu: Configurar/Setup → Diagnósticos → Lista de diagnósticos → Diagnósticos 1 ■ Através do menu ■ Equipamento/Diagnóstico → Lista de diagnóstico ■ Status da saúde do instrumento → Lista de diagnóstico	Este método é usado para exibir as medidas corretivas para o diagnóstico de eventos com a prioridade máxima que está atualmente ativo.  Esse método está disponível apenas se tiver ocorrido um evento de diagnóstico apropriado.
Diagnóstico 2 – Informações de correção	Bloco do transdutor de diagnóstico	■ Através do menu: Configurar/Setup → Diagnósticos → Lista de diagnósticos → Diagnósticos 2 ■ Através do menu: ■ Equipamento/Diagnóstico → Lista de diagnóstico ■ Status da saúde do instrumento → Lista de diagnóstico	Este método é usado para exibir medidas corretivas para um evento adicional de diagnóstico.  Esse método está disponível apenas se tiver ocorrido um evento de diagnóstico apropriado.

10 Comissionamento

10.1 Verificação da função

Antes do comissionamento do medidor:

- ▶ Certifique-se de que as verificações da pós-instalação e pós-conexão tenham sido executadas.
- Checklist "Verificação pós-instalação" → [31](#)
- Lista de verificação "Verificação pós-conexão" → [43](#)


10.2 Ativação do medidor

- ▶ Após uma verificação de função bem-sucedida, acione o medidor.
↳ Após uma inicialização correta, o display local alterna automaticamente do display de inicialização para o display operacional.

i Se não aparecer nada no display local ou se for exibida uma mensagem de diagnóstico, consulte a seção "Diagnóstico e localização de falhas" → [141](#).

10.3 Configuração do idioma de operação


Ajuste de fábrica: inglês ou solicitado com o idioma local

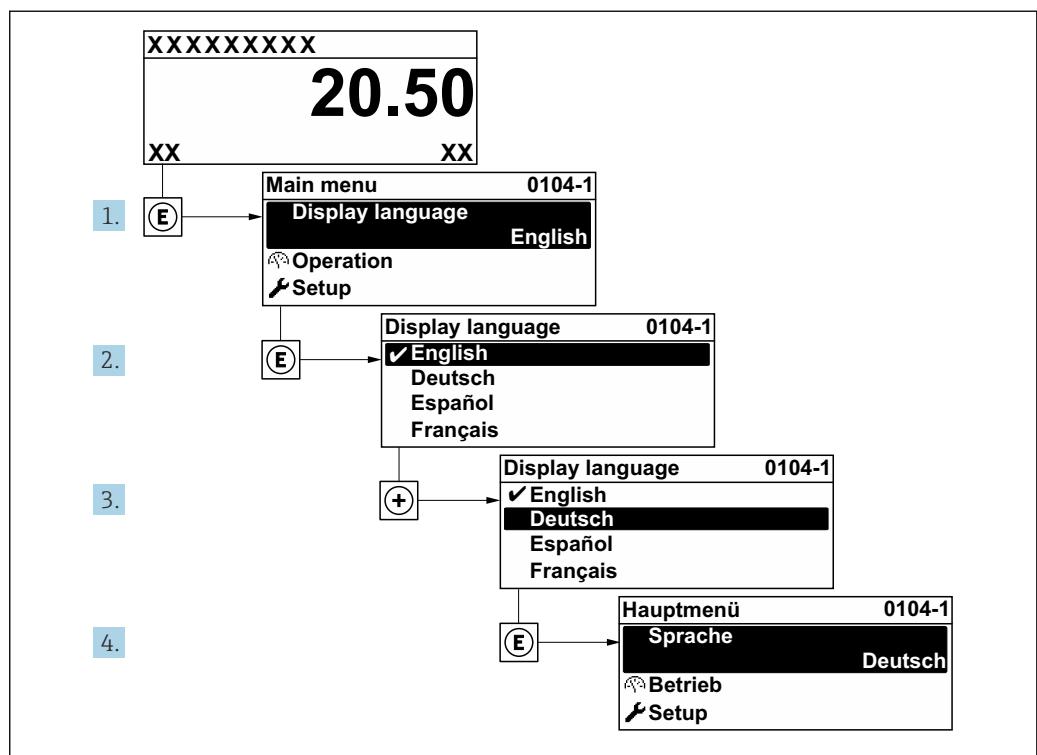

[17 Uso do display local como exemplo](#)

10.4 Configuração do medidor

- A menu **Configuração** com seus assistentes contém todos os parâmetros necessários para a operação padrão.
- Navegação até a menu **Configuração**

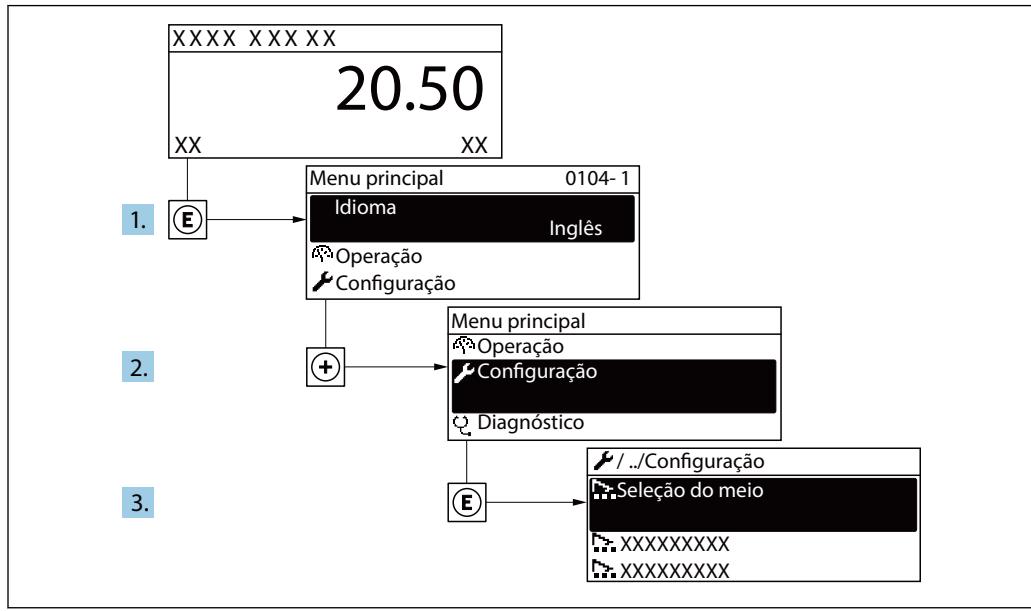


18 Uso do display local como exemplo

Configuração	
Tag do equipamento	→ 73
► Unidades do sistema	→ 73
► Selecionar o meio	→ 77
► Analog inputs	→ 80
► Exibir	→ 80
► Corte de vazão baixa	→ 83
► Configuração avançada	→ 84

10.4.1 Definição do nome de tag

Para habilitar a rápida identificação do ponto de medição junto ao sistema, é possível inserir uma designação exclusiva usando o parâmetro **Tag do equipamento** para mudar o ajuste de fábrica.

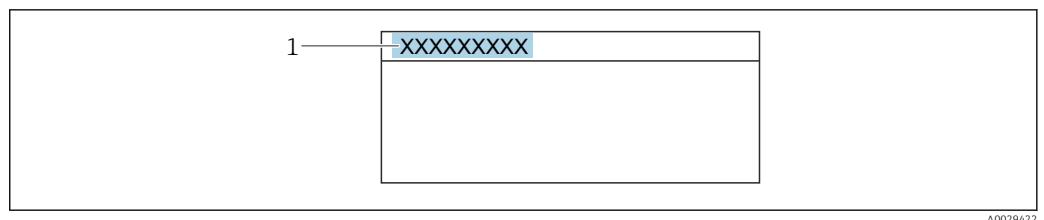

■ 19 Cabeçalho do display de operação com nome de tag

1 Nome de identificação

i Insira o nome do tag na ferramenta de operação "FieldCare" → ■ 63

Navegação

Menu "Configuração" → Tag do equipamento

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário	Ajuste de fábrica
Tag do equipamento	Insira o nome do ponto de medição.	Máx. de 32 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)	EH_Prowirl_200_xxxxxxxxxxxx


10.4.2 Configuração das unidades do sistema

Em submenu **Unidades do sistema** as unidades de todos os valores medidos podem ser ajustadas.

i O número de submenus e parâmetros pode variar dependendo da versão do equipamento. Alguns submenus e parâmetros nesses submenus não estão descritos nas instruções de operação. Em vez disso, uma descrição é fornecida na Documentação Especial do equipamento (→ seção "Documentação Complementar").

Navegação

Menu "Configuração" → Unidades do sistema

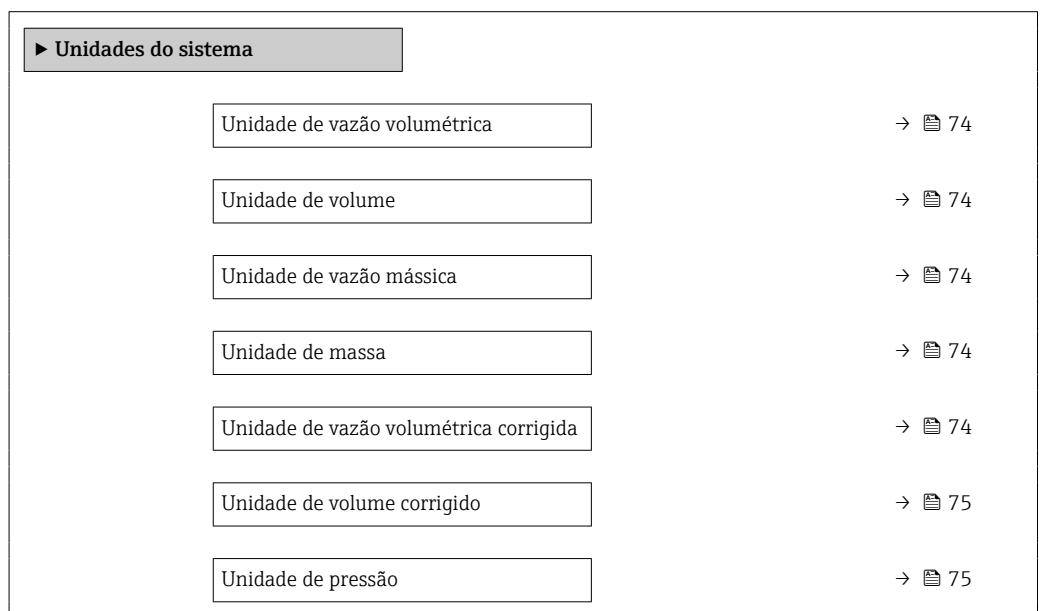

Unidade de temperatura	→ 75
Unidade vazão de energia	→ 75
Unidade Energia	→ 75
Unidade valor calorífico	→ 75
Unidade valor calorífico	→ 76
Unidade de velocidade	→ 76
Unidade de densidade	→ 76
Unidade de volume específico	→ 76
Unidade Viscosidade Dinâmica	→ 76
Unidade de comprimento	→ 76

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Unidade de vazão volumétrica	-	<p>Selecionar unidade de vazão volumétrica.</p> <p><i>Resultado</i></p> <p>A unidade selecionada se aplica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Saída ■ Corte vazão baixo ■ Variável do processo de simulação 	<p>Lista de seleção da unidade</p>	<p>Específico do país:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ m³/h ■ ft³/min
Unidade de volume	-	Selecionar unidade de volume.	<p>Lista de seleção da unidade</p>	<p>Específico do país:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ m³ ■ ft³
Unidade de vazão mássica	-	<p>Selecionar unidade de vazão mássica.</p> <p><i>Resultado</i></p> <p>A unidade selecionada se aplica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Saída ■ Corte vazão baixo ■ Variável do processo de simulação 	<p>Lista de seleção da unidade</p>	<p>Específico do país:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kg/h ■ lb/min
Unidade de massa	-	Selecionar unidade de massa.	<p>Lista de seleção da unidade</p>	<p>Específico do país:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kg ■ lb
Unidade de vazão volumétrica corrigida	-	<p>Selecionar unidade de vazão volumétrica corrigida.</p> <p><i>Resultado</i></p> <p>A unidade selecionada se aplica a:</p> <p>Parâmetro Vazão volumétrica corrigida (→ 133)</p>	<p>Lista de seleção da unidade</p>	<p>Específico do país:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nm³/h ■ Sft³/h

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Unidade de volume corrigido	-	Selecionar unidade de vazão volumétrica corrigido.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: ■ Nm ³ ■ Sft ³
Unidade de pressão	Com o Código do produto para "Versão do sensor": opção "Massa (medição da temperatura integrada)"	Selecionar a unidade de pressão do processo. <i>Resultado</i> A unidade foi obtida de: ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Pressão Atmosférica ■ Valor máximo ■ Valor Pressão Fixo ■ Pressão ■ Pressão de referência	Lista de seleção da unidade	Específico do país: ■ bar ■ psi
Unidade de temperatura	-	Selecionar a unidade de temperatura. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: ■ Temperatura ■ Valor máximo ■ Valor mínimo ■ Valor médio ■ Valor máximo ■ Valor mínimo ■ Valor máximo ■ Valor mínimo ■ 2 diferença de temperatura de calor ■ Temperatura fixa ■ Temperatura de referência de combustão ■ Temperatura de referência ■ Temperatura Saturação	Lista de seleção da unidade	Específico do país: ■ °C ■ °F
Unidade vazão de energia	Com o Código do produto para "Versão do sensor": opção "Massa (medição da temperatura integrada)"	Selecione a unidade de energia de vazão. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: ■ Parâmetro Diferença Caudal calor ■ Parâmetro Fluxo de energia	Lista de seleção da unidade	Específico do país: ■ kW ■ Btu/h
Unidade Energia	Com o Código do produto para "Versão do sensor": opção "Massa (medição da temperatura integrada)"	Selecione a unidade de energia.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: ■ kWh ■ Btu
Unidade valor calorífico	As condições a seguir são atendidas: ■ Código do produto para "Versão do sensor", opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ O opção Volume bruto do poder calorífico ou opção Poder Calorífico do volume é selecionado em parâmetro Tipo de Vapor Calorífico .	Selecionar a unidade de valor calorífico. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: Referência poder calorífico	Lista de seleção da unidade	Específico do país: ■ kJ/Nm ³ ■ Btu/Sft ³


Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Unidade valor calorífico (Massa)	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ O opção Poder Calorífico Bruto Massa ou opção Poder calorífico inferior Massa é selecionado em parâmetro Tipo de Vapor Calorífico. 	Selecionar a unidade de valor calorífico.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ kJ/kg ■ Btu/lb
Unidade de velocidade	-	Selecionar a unidade de velocidade. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> ■ Velocidade de vazão ■ Valor máximo 	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ m/s ■ ft/s
Unidade de densidade	-	Selecionar unidade de densidade. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> ■ Saída ■ Variável do processo de simulação 	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ kg/m³ ■ lb/ft³
Unidade de volume específico	Com o Código do produto para "Versão do sensor": Opção "Massa (medição da temperatura integrada)"	Selecione a unidade para o volume específico. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: Volume específico	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ m³/kg ■ ³pés/lb
Unidade Viscosidade Dinâmica	-	Selecione a unidade da viscosidade dinâmica. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> ■ Parâmetro Viscosidade Dinâmica (gases) ■ Parâmetro Viscosidade Dinâmica (líquidos) 	Lista de seleção da unidade	Pa s
Unidade de comprimento	-	Selecionar unidade de comprimento para diâmetro nominal. <i>Resultado</i> A unidade selecionada se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia á Entrada ■ Diâmetro tubo acasalamento 	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ mm ■ in

10.4.3 Seleccione e configuração do meio

O assistente **Selecionar o meio** guia o usuário sistematicamente por todos os parâmetros que devem ser configurados a fim de selecionar e ajustar a mídia.

Navegação

Menu "Configuração" → Selecionar o meio

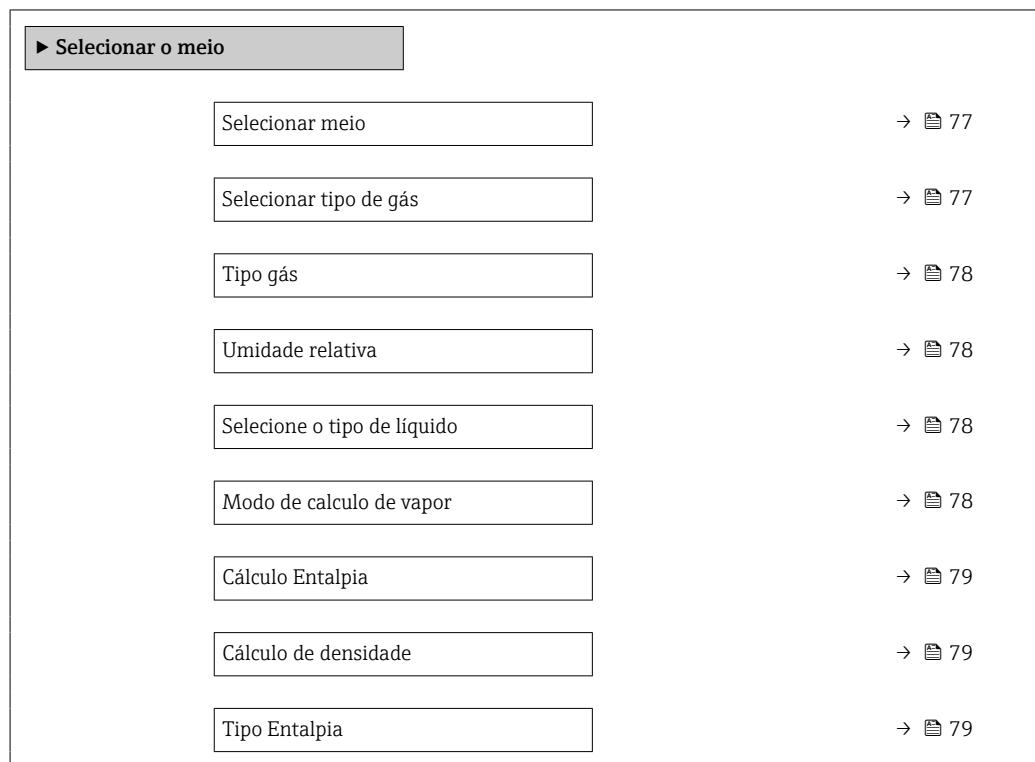

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Selecionar meio	-	Selecionar tipo de produto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gás ■ Líquido ■ Vapor 	Vapor
Selecionar tipo de gás	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", Opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ O opção Gás é selecionado no parâmetro parâmetro Selecionar meio. 	Selecionar tipo de gás medido.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gas Unico ■ Mistura de gases ■ Ar ■ Gás natural ■ Gas Específico 	Gas Específico

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Tipo gás	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none">■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado.■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gas Unico é selecionado.	Selecionar tipo de gás medido.	<ul style="list-style-type: none">■ Hidrogênio H2■ Hélio He■ Neon Ne■ Argônio Ar■ Krypton Kr■ Xenon Xe■ Nitrogênio N2■ Oxigênio O2■ Cloreto Cl2■ Amônia NH3■ Monóxido de carbono CO■ Dióxido de carbono CO2■ O dióxido de enxofre SO2■ Sulfeto de hidrogênio H2S■ Cloreto de hidrogênio HCl■ Metano CH4■ Etano C2H6■ Propano C3H8■ Butano C4H10■ Etileno C2H4■ Vinyl Chloride C2H3Cl	Metano CH4
Umidade relativa	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none">■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado.■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Ar é selecionado.	Entre com a quantidade de umidade no ar em %.	0 para 100 %	0 %
Modo de calculo de vapor	O opção Vapor é selecionado no parâmetro parâmetro Selecionar meio .	Select calculation mode of steam: based on saturated steam (T-compensated) or automatic detection (p-/T-compensated).	<ul style="list-style-type: none">■ Vapor saturado (T-compensada)■ Automatica (p-/T-compensada)	Vapor saturado (T-compensada)
Selecione o tipo de líquido	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none">■ Código do produto para "Versão do sensor", Opção "Massa (medição da temperatura integrada)"■ O opção Líquido é selecionado no parâmetro parâmetro Selecionar meio.	Selecione tipo de líquido a medir.	<ul style="list-style-type: none">■ Água■ LPG (Gás de petróleo liquefeito)■ Líquido Específico	Água
Valor Pressão Fixo	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none">■ Código do produto para "Versão do sensor", Opção "Vazão mássica (medição da temperatura integrada)"■ Em parâmetro Valor externo (→ 99), o opção Pressão não é selecionado.	Digite o valor fixo da pressão de Processo. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de pressão .  Para informações detalhadas sobre o cálculo das variáveis medidas com vapor: → 127	0 para 250 bar abs.	0 bar abs.


Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Cálculo Entalpia	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", Opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado e em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado. 	Seleccione a norma de cálculo da entalpia é baseado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ AGA5 ■ ISO 6976 	AGA5
Cálculo de densidade	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado. 	Seleccione a norma de cálculo da densidade é baseado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ AGA Nx19 ■ ISO 12213- 2 ■ ISO 12213- 3 	AGA Nx19
Tipo Entalpia	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ No parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gas Específico é selecionado. Ou ■ No parâmetro Selecione o tipo de líquido, o opção Líquido Específico é selecionado. 	Definir qual o tipo de entalpia usado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quente ■ Valor calorífico 	Quente

10.4.4 Configurar as entradas analógicas

O submenu **Analog inputs** guia o usuário sistematicamente para o submenu **Analog input 1 para n** individual. A partir daqui você consegue os parâmetros da entrada analógica individual.

Navegação

Menu "Configuração" → Analog inputs

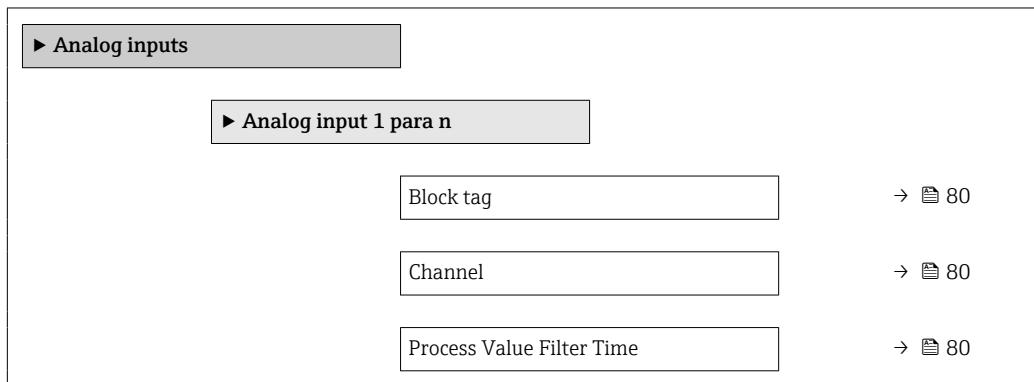

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Entrada do usuário / Seleção	Ajuste de fábrica
Block tag	Nome exclusivo do medidor.	Máximo de 32 caracteres, como letras, números ou caracteres especiais (por ex. @, %, /).	ANALOG_INPUT_1 ... 4_Serial number
Channel	Use essa função para selecionar a variável de processo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uninitialized ■ Vazão mássica ■ Velocidade de vazão ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Temperatura ■ Pressão Vapor saturado calculada * ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * ■ Número de Reynolds * ■ Totalizador 1 ■ Totalizador 2 ■ Totalizador 3 ■ Densidade * ■ Pressão * ■ Volume específico * ■ Graus de superaquecimento * 	Uninitialized
Process Value Filter Time	Entre a especificação de tempo de filtro para a filtragem do valor de entrada não convertido (PV).	Número do ponto flutuante positivo	0 s

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

10.4.5 Configurando o display local

Assistente **Exibir** orienta você sistematicamente por todos os parâmetros que podem ser ajustados para a configuração do display local.

Navegação

Menu "Configuração" → Exibir

► Exibir	
Formato de exibição	→ 82
Exibir valor 1	→ 82
0% do valor do gráfico de barras 1	→ 82
100% do valor do gráfico de barras 1	→ 82
Exibir valor 2	→ 82
Exibir valor 3	→ 82
0% do valor do gráfico de barras 3	→ 82
100% do valor do gráfico de barras 3	→ 82
Exibir valor 4	→ 82

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Formato de exibição	É fornecido um display local.	Selecionar como os valores medidos são exibidos no display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 valor, tamanho máx. ■ 1 gráfico de barras + 1 valor ■ 2 valores ■ 1 valor grande + 2 valores ■ 4 valores 	1 valor, tamanho máx.
Exibir valor 1	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Velocidade de vazão ■ Temperatura ■ Pressão Vapor saturado calculada * ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * ■ Número de Reynolds * ■ Densidade * ■ Pressão * ■ Volume específico * ■ Graus de superaquecimento * ■ Totalizador 1 ■ Totalizador 2 ■ Totalizador 3 	Vazão volumétrica
0% do valor do gráfico de barras 1	É fornecido um display local.	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 pés³/h
100% do valor do gráfico de barras 1	É fornecido um display local.	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	Depende do país e do diâmetro nominal
Exibir valor 2	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 82)	Nenhum
Exibir valor 3	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 82)	Nenhum
0% do valor do gráfico de barras 3	Foi feita uma seleção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 pés³/h
100% do valor do gráfico de barras 3	Foi feita uma seleção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	0
Exibir valor 4	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 82)	Nenhum

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.


10.4.6 Configurar o corte de vazão baixa

O assistente **Corte de vazão baixa** guia o usuário sistematicamente por todos os parâmetros que devem ser definidos para configurar o corte de vazão baixa.

O sinal de medição deve ter uma certa amplitude mínima de sinal para que os sinais possam ser avaliados sem erros. Usando o diâmetro nominal, é possível também derivar a vazão correspondente dessa amplitude. A amplitude mínima do sinal depende da configuração da sensibilidade do(s) sensor(es) DSC, da qualidade do vapor (x) e da força das vibrações presentes (a). O valor mf corresponde à menor velocidade de vazão mensurável sem vibração (sem vapor úmido) a uma densidade de 1 kg/m^3 (0.0624 lbm/ft^3). O valor mf pode ser definido na faixa de 6 para 20 m/s (1.8 para 6 ft/s) (ajuste de fábrica 12 m/s (3.7 ft/s)) com a parâmetro **Sensibilidade** (faixa de valor 1 para 9, ajuste de fábrica 5).

Navegação

Menu "Configuração" → Corte de vazão baixa

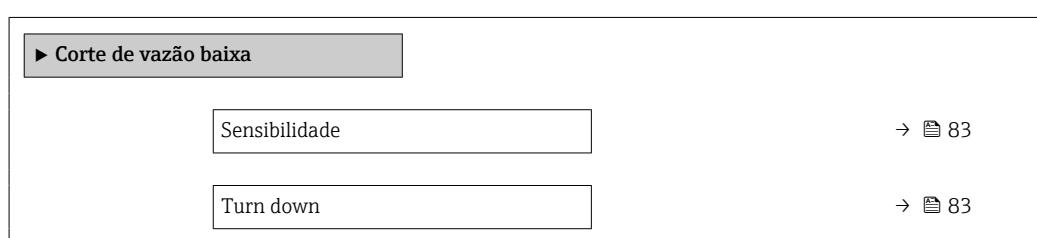


Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Sensibilidade	<p>Adjust sensitivity of the device in the lower flow range. Lower sensitivity leads to more robustness against external interference.</p> <p>O parâmetro determina o nível de sensibilidade na extremidade mais baixa da faixa de medição (início da faixa de medição). Os valores baixos podem melhorar a robustez do equipamento em relação à influências externas. O início da Faixa de medição é então definida como um valor mais alto. A menor faixa de medição especificada é quando a sensibilidade está no máximo.</p>	1 para 9	5
Turn down	<p>Adjust the turn down. Lower turn down increases the minimum measureable flow frequency.</p> <p>A faixa de medição pode ser limitada com esse parâmetro, se necessário. A extremidade superior da faixa de medição não é afetada. O início da extremidade inferior da faixa de medição pode ser alterada para um valor de vazão mais alto, possibilitando cortar vazões baixas, por exemplo.</p>	50 para 100 %	100 %

10.5 Configurações avançadas

A submenu **Configuração avançada** juntamente com seus submenus contém parâmetros para configurações específicas.

Navegação até a submenu "Configuração avançada"

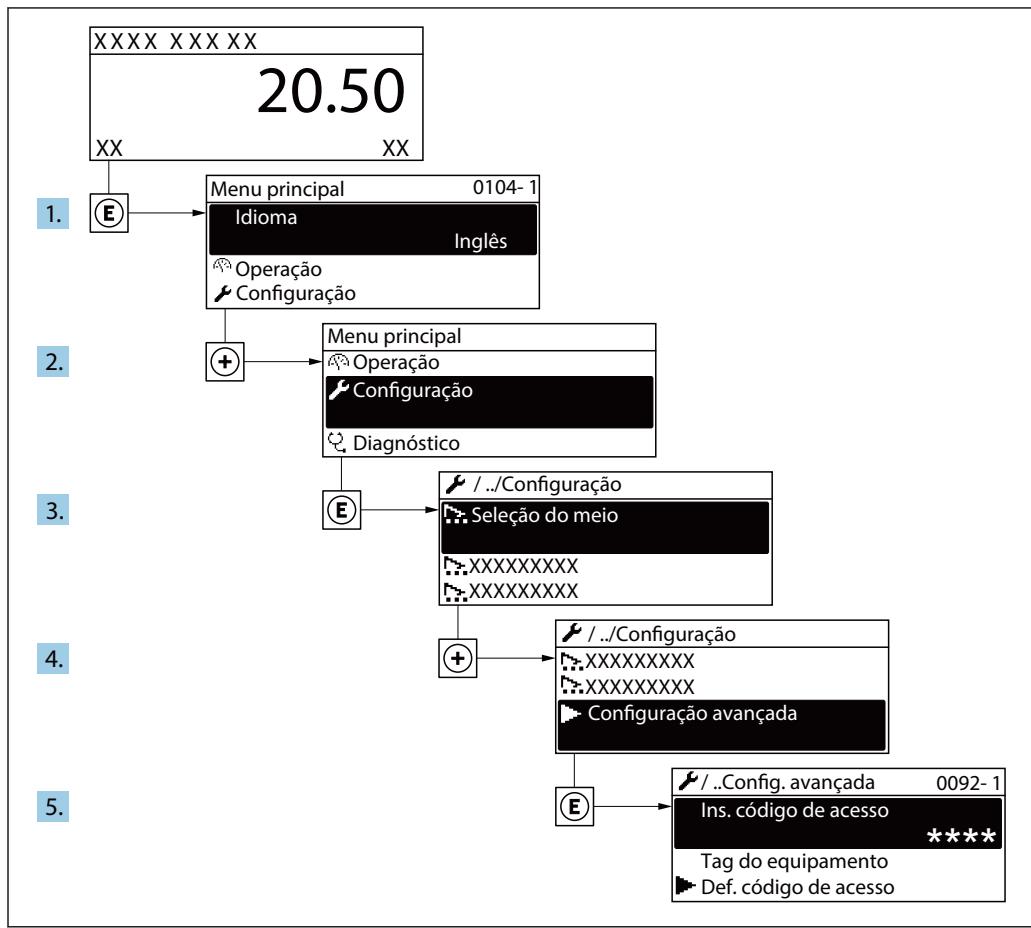


A0034208-PT

i O número de submenus pode variar dependendo da versão do equipamento. Alguns submenus não são abordados nas Instruções de operação. Eles e os parâmetros neles contidos são explicados na Documentação especial para o equipamento.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada

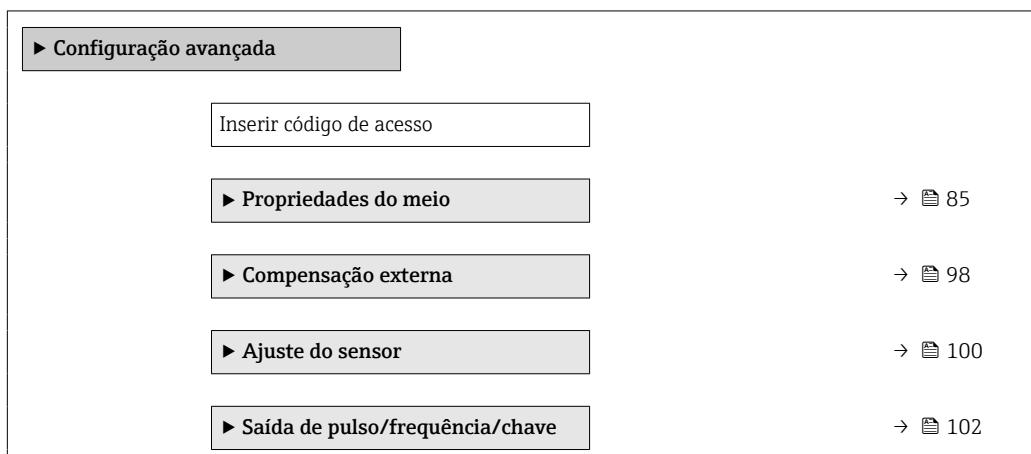

▶ Totalizador 1 para n	→ 107
▶ Exibir	→ 109
▶ Setup do Heartbeat	
▶ Exibição do backup de configuração	→ 112
▶ Administração	→ 113

10.5.1 Configuração das propriedades da mídia

Em submenu **Propriedades do meio** é possível ajustar os valores de referência para a aplicação de medição.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Propriedades do meio

▶ Propriedades do meio	
Tipo Entalpia	→ 86
Tipo de Vapor Calorífico	→ 86
Temperatura de referência de combustão	→ 86
Densidade de referência	→ 86
Referência poder calorífico	→ 86
Pressão de referência	→ 87
Temperatura de referência	→ 87
Z-factor Referência	→ 87
Coeficiente de expansão linear	→ 87
Densidade Relativa	→ 87
Calor específico	→ 87
Valor calorífico	→ 88
Z-factor	→ 88
Viscosidade Dinâmica	→ 88

Viscosidade Dinâmica	→ 88
► Composição Gas	→ 88

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Tipo Entalpia	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none">■ No parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gas Específico é selecionado. Ou■ No parâmetro Selecione o tipo de líquido, o opção Líquido Específico é selecionado.	Definir qual o tipo de entalpia usado.	<ul style="list-style-type: none">■ Quente■ Valor calorífico	Quente
Tipo de Vapor Calorifico	O parâmetro Tipo de Vapor Calorifico está visível.	Selecione o calculo baseado em valor calorífico gross ou valor calorífico net.	<ul style="list-style-type: none">■ Volume bruto do poder calorífico■ Poder Calorífico do volume■ Poder Calorífico Bruto Massa■ Poder calorífico inferior Massa	Poder Calorífico Bruto Massa
Temperatura de referência de combustão	O parâmetro Temperatura de referência de combustão está visivel.	Digite temperatura de combustão de referência para o cálculo do valor energético de gás natural. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de temperatura	-200 para 450 °C	20 °C
Densidade de referência	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none">■ No parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gas Específico é selecionado. Ou■ Em parâmetro Selecione o tipo de líquido, opção Água ou opção Líquido Específico é selecionado.	Inserir valor fixo para densidade de referência. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de densidade	0.01 para 15 000 kg/m³	1 000 kg/m³
Referência poder calorífico	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none">■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado.■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado.■ Em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 3 é selecionado.	Digite valor referência poder calorífico superior do gás natural. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade valor calorífico	Número do ponto flutuante positivo	50 000 kJ/Nm³

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Pressão de referência	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", Opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ O opção Gás é selecionado no parâmetro parâmetro Selecionar meio. 	Entre com a pressão de referência para o cálculo da densidade de referência. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de pressão .	0 para 250 bar	1.01325 bar
Temperatura de referência	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ O opção Gás é selecionado no parâmetro Selecionar meio. Ou ■ O opção Líquido é selecionado no parâmetro Selecionar meio. 	Inserir temperatura de referência para calcular a densidade de referência. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de temperatura	-200 para 450 °C	20 °C
Z-factor Referência	No parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Gas Específico é selecionado.	Digite Z constantes de gás reais para gás sob condições de referência.	0.1 para 2	1
Coeficiente de expansão linear	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ O opção Líquido é selecionado no parâmetro Selecionar meio. ■ O opção Líquido Específico é selecionado no parâmetro Selecione o tipo de líquido. 	Entre com o coeficiente de expansão linear do meio para calculo da densidade de referência.	$1.0 \cdot 10^{-6}$ para $2.0 \cdot 10^{-3}$	$2.06 \cdot 10^{-4}$
Densidade Relativa	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 3 é selecionado. 	Digite uma densidade relativa do gás natural.	0.55 para 0.9	0.664
Calor específico	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Meio selecionado: <ul style="list-style-type: none"> ■ No parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gas Específico é selecionado. Ou ■ No parâmetro Selecione o tipo de líquido, o opção Líquido Específico é selecionado. ■ Em parâmetro Tipo Entalpia, o opção Quente é selecionado. 	Digite o calor específico do meio. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade específica de quantidade Calor	0 para 50 kJ/(kgK)	4.187 kJ/(kgK)

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Valor calorífico	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Meio selecionado: <ul style="list-style-type: none"> ■ No parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gas Específico é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Seleccione o tipo de líquido, a opção Líquido Específico é selecionado. ■ Em parâmetro Tipo Entalpia, a opção Valor calorífico é selecionado. ■ Em parâmetro Tipo de Vapor Calorífico, a opção Volume bruto do poder calorífico ou opção Poder Calorífico Bruto Massa é selecionado. 	Digite o poder calorífico superior para calcular o caudal de energia.	Número do ponto flutuante positivo	50 000 kJ/kg
Z-factor	No parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Gas Específico é selecionado.	Digite constante Z dos gases reais para o gás em condições de operação.	0.1 para 2.0	1
Viscosidade Dinâmica (Gases)	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", <ul style="list-style-type: none"> ■ Opção "Volume" ou ■ Opção "Temperatura alta do volume" ■ A opção Gás ou opção Vapor é selecionado em parâmetro Selecionar meio. ou ■ A opção Gas Específico é selecionada em parâmetro Selecionar tipo de gás. 	Insira o valor fixo para a viscosidade dinâmica para gás/vapor. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade Viscosidade Dinâmica .	Número do ponto flutuante positivo	0.015 cP
Viscosidade Dinâmica (Líquidos)	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", <ul style="list-style-type: none"> ■ Opção "Volume" ou ■ Opção "Temperatura alta do volume" ■ A opção Líquido é selecionado no parâmetro parâmetro Selecionar meio. ou ■ A opção Líquido Específico é selecionada em parâmetro Seleccione o tipo de líquido. 	Insira o valor fixo para a viscosidade dinâmica para um líquido. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade Viscosidade Dinâmica .	Número do ponto flutuante positivo	1 cP

Configurando a composição do gás

Em submenu **Composição Gas** é possível definir a composição do gás para a aplicação de medição.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Propriedades do meio → Composição Gas

► Composição Gas	
Mistura de gases	→ 91
Mol% Ar	→ 91
Mol% C2H3Cl	→ 91
Mol% C2H4	→ 92
Mol% C2H6	→ 92
Mol% C3H8	→ 92
Mol% CH4	→ 92
Mol% Cl2	→ 93
Mol% CO	→ 93
Mol% CO2	→ 93
Mol% H2	→ 93
Mol% H2O	→ 94
Mol% H2S	→ 94
Mol% HCl	→ 94
Mol% He	→ 94
Mol% i-C4H10	→ 95
Mol% i-C5H12	→ 95
Mol% Kr	→ 95
Mol% N2	→ 95
Mol% n-C10H22	→ 95
Mol% n-C4H10	→ 96
Mol% n-C5H12	→ 96

Mol% n-C6H14	→ 96
Mol% n-C7H16	→ 96
Mol% n-C8H18	→ 97
Mol% n-C9H20	→ 97
Mol% Ne	→ 97
Mol% NH3	→ 97
Mol% O2	→ 97
Mol% SO2	→ 98
Mol% Xe	→ 98
%Mol de outros gases	→ 98

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mistura de gases	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Mistura de gases é selecionada. 	Selecione mistura de gás medido.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hidrogênio H2 ■ Hélio He ■ Neon Ne ■ Argônio Ar ■ Krypton Kr ■ Xenon Xe ■ Nitrogênio N2 ■ Oxigênio O2 ■ Cloreto Cl2 ■ Amônia NH3 ■ Monóxido de carbono CO ■ Dióxido de carbono CO2 ■ O dióxido de enxofre SO2 ■ Sulfeto de hidrogênio H2S ■ Cloreto de hidrogênio HCl ■ Metano CH4 ■ Etano C2H6 ■ Propano C3H8 ■ Butano C4H10 ■ Etileno C2H4 ■ Vinyl Chloride C2H3Cl ■ Outros 	Metano CH4
Mol% Ar	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <p>Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases, o opção Argônio Ar é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% C2H3Cl	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases, o opção Vinyl Chloride C2H3Cl é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mol% C2H4	As condições a seguir são atendidas: ■ Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases , o opção Etileno C2H4 é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% C2H6	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases , o opção Etano C2H6 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade , o opção ISO 12213- 2 é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% C3H8	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases , o opção Propano C3H8 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade , o opção ISO 12213- 2 é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% CH4	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases , o opção Metano CH4 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Gás natural é selecionada.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	100 %

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mol% Cl2	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases, o opção Cloreto Cl2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% CO	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases, o opção Monóxido de carbono CO é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% CO2	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases, o opção Dióxido de carbono CO2 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% H2	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases, o opção Hidrogênio H2 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade, o opção AGA Nx19 não é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mol% H2O	As condições a seguir são atendidas: ■ Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade , o opção ISO 12213- 2 é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% H2S	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases , o opção Sulfeto de hidrogênio H2S é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade , o opção ISO 12213- 2 é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% HCl	As condições a seguir são atendidas: ■ Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases , o opção Cloreto de hidrogênio HCl é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% He	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases , o opção Hélio He é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade , o opção ISO 12213- 2 é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mol% i-C4H10	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, a opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, a opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% i-C5H12	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, a opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, a opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% Kr	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, a opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases, o opção Krypton Kr é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% N2	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , a opção Gás é selecionado. <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases, o opção Nitrogênio N2 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade, é o opção AGA Nx19 ou a opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% n-C10H22	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, a opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, a opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mol% n-C4H10	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases, o opção Butano C4H10 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. ■ Ou Em parâmetro Selecionar meio, o opção Líquido é selecionado e em parâmetro Selecione o tipo de líquido, o opção LPG é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% n-C5H12	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% n-C6H14	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% n-C7H16	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mol% n-C8H18	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% n-C9H20	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Gás natural é selecionada. ■ Em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% Ne	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases, o opção Neon Ne é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% NH3	As condições a seguir são atendidas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar meio, o opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases, o opção Amônia NH3 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% O2	As condições a seguir são atendidas: Em parâmetro Selecionar meio , o opção Gás é selecionado. <ul style="list-style-type: none"> ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Mistura de gases é selecionado e em parâmetro Mistura de gases, o opção Oxigênio O2 é selecionado. Ou ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás, o opção Gás natural é selecionado e em parâmetro Cálculo de densidade, o opção ISO 12213- 2 é selecionado. 	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Mol% SO2	As condições a seguir são atendidas: ■ Em parâmetro Selecionar meio , a opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases , a opção O dióxido de enxofre SO2 é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
Mol% Xe	As condições a seguir são atendidas: ■ Em parâmetro Selecionar meio , a opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases , a opção Xenon Xe é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %
%Mol de outros gases	As condições a seguir são atendidas: ■ Em parâmetro Selecionar meio , a opção Gás é selecionado. ■ Em parâmetro Selecionar tipo de gás , a opção Mistura de gases é selecionada. ■ Em parâmetro Mistura de gases , a opção Outros é selecionado.	Digite quantidade de substância para a mistura de gás.	0 para 100 %	0 %

10.5.2 Realização da compensação externa

A submenu **Compensação externa** contém parâmetros que podem ser usados para valores externos ou fixos. Esses valores são usados para cálculos internos.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Compensação externa

► Compensação externa

Valor externo	→ ↗ 99
Pressão Atmosférica	→ ↗ 99
Delta heat calculation	→ ↗ 99
Densidade fixa	→ ↗ 99
Densidade fixa	→ ↗ 99

Temperatura fixa	→ 99
2 diferença de temperatura de calor	→ 100
Valor Pressão Fixo	→ 100

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Valor externo	Com o Código do produto para "Versão do sensor": Opção "Massa (medição da temperatura integrada)"	Definir a variável de um equipamento externo para uma variável de processo. Para informações detalhadas sobre o cálculo das variáveis medidas com vapor: → 127	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Pressão ■ Pressão Relativa ■ Densidade ■ Temperatura ■ 2 diferença de temperatura de calor 	Desl.
Pressão Atmosférica	Em parâmetro Valor externo , o opção Pressão Relativa é selecionado.	Entre com o valor da pressão atmosférica para ser usado na correção. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de pressão	0 para 250 bar	1.01325 bar
Delta heat calculation	O parâmetro Delta heat calculation está visível.	Calculates the transferred heat of a heat exchanger (= delta heat).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Device on cold side ■ Device on warm side 	Device on warm side
Densidade fixa	Com o Código do produto para "Versão do sensor": Opção "Temperatura alta do volume"	Digite o valor fixo da densidade média. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de densidade .	0.01 para 15 000 kg/m ³	1 000 kg/m ³
Densidade fixa	Com o Código do produto para "Versão do sensor": Opção "Temperatura alta do volume"	Digite o valor fixo da densidade média. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de densidade .	0.01 para 15 000 kg/m ³	5 kg/m ³
Temperatura fixa	-	Digite o valor fixo da temperatura de processo. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de temperatura	-200 para 450 °C	20 °C


Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
2 diferença de temperatura de calor	O parâmetro 2 diferença de temperatura de calor está visível.	Introduzir o 2º valor de temperatura para calcular o diferencial de Temperatura. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de temperatura .	-200 para 450 °C	20 °C
Valor Pressão Fixo	As condições a seguir são atendidas: ■ Código do produto para "Versão do sensor", Opção "Vazão mássica (medição da temperatura integrada)" ■ Em parâmetro Valor externo (\rightarrow 99), a opção Pressão não é selecionado.	Digite o valor fixo da pressão de Processo. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de pressão .  Para informações detalhadas sobre o cálculo das variáveis medidas com vapor: \rightarrow 127	0 para 250 bar abs.	0 bar abs.

10.5.3 Execução do ajuste do sensor

O submenu **Ajuste do sensor** contém parâmetros que pertencem à funcionalidade do sensor.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Ajuste do sensor

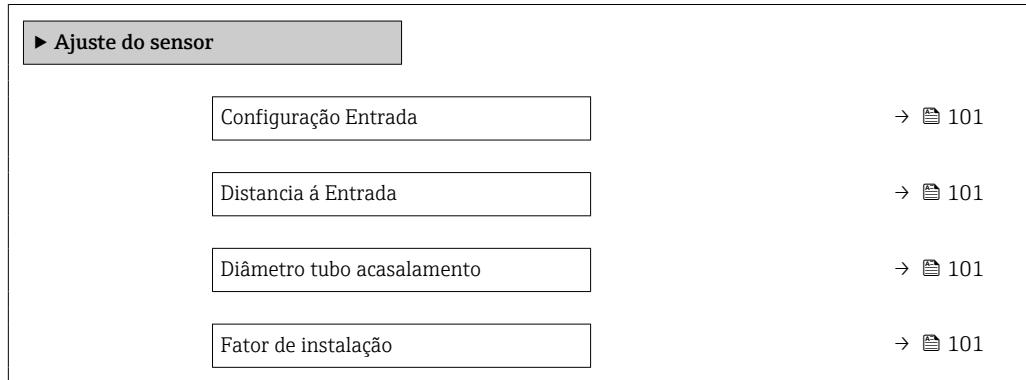

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Configuração Entrada	<p>A função correção do trecho reto a montante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ É um recurso padrão e somente pode ser usado no Prowirl F 200. ■ Pode ser usado para as seguintes classificações de pressão e diâmetros nominais: DN 15 a 150 (1 a 6")<ul style="list-style-type: none"> ■ EN (DIN) ■ ASME B16.5, Sch. 40/80 	Selecione a configuração de entrada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Cotovelo Simples ■ Cotovelo duplo ■ Cotovelo duplo 3D ■ Redução 	Desl.
Distancia á Entrada	<p>A função correção do trecho reto a montante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ É um recurso padrão e somente pode ser usado no Prowirl F 200. ■ Pode ser usado para as seguintes classificações de pressão e diâmetros nominais: DN 15 a 150 (1 a 6")<ul style="list-style-type: none"> ■ EN (DIN) ■ ASME B16.5, Sch. 40/80 	<p>Definir comprimento da reta antes da entrada.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de comprimento</p>	0 para 20 m	0 m
Diâmetro tubo acasalamento	-	<p>Insira o diâmetro da tubulação correspondente para permitir a correção da diferença de diâmetro.</p> <p>Informações detalhadas sobre a correção da diferença de diâmetro: → 101</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de comprimento.</p>	0 para 1 m (0 para 3 ft) Valor de entrada = 0: A correção da diferença de diâmetro está desabilitada.	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m ■ 0 pés
Fator de instalação	-	Digite o fator de ajuste para as condições de instalação.	Número do ponto flutuante positivo	1.0

Correção de incompatibilidade de diâmetro

 O medidor é calibrado de acordo com a conexão de processo solicitada. Essa calibração leva em consideração a extremidade na transição do tubo correspondente à conexão de processo. Se o tubo correspondente usado desviar da conexão de processo solicitada, uma correção da disparidade do diâmetro pode compensar os efeitos. A diferença entre o diâmetro interno da conexão de processo solicitada e o diâmetro interno do tubo correspondente usado deve ser levada em consideração.

O medidor pode corrigir desvios no fator de calibração causados, por exemplo, por uma diferença de diâmetro entre o flange do equipamento (por exemplo, ASME B16.5 /Sch. 80, DN 50 (2")) e o tubo correspondente (por exemplo, ASME B16.5 /Sch. 40, DN 50 (2")). Aplique apenas a correção de incompatibilidade de diâmetro dentro dos seguintes valores limite (listados abaixo) para os quais também foram realizadas medições de teste.

Conexão de flange:

- DN 15 ($\frac{1}{2}$): $\pm 20\%$ do diâmetro interno
- DN 25 (1"): $\pm 15\%$ do diâmetro interno
- DN 40 ($1\frac{1}{2}$): $\pm 12\%$ do diâmetro interno
- DN ≥ 50 (2"): $\pm 10\%$ do diâmetro interno

Se o diâmetro interno padrão da conexão de processo solicitada diferir do diâmetro interno do tubo correspondente, uma incerteza de medição adicional de aprox. 2 % o.r. deve ser esperada.

Exemplo

Influência da incompatibilidade de diâmetro sem usar a função de correção:


- Tubo correspondente DN 100 (4"), Schedule 80
- Flange do equipamento DN 100 (4"), Schedule 40
- Essa posição de instalação resulta em uma disparidade de diâmetro de 5 mm (0.2 in). Se a função de correção não for usada, uma incerteza de medição adicional de aprox. 2 % o.r. deve ser esperada.
- Se as condições básicas forem atendidas e o recurso for habilitado, a incerteza de medição adicional é 1 % o.r.

10.5.4 Configuração do pulso/frequência/saída comutada

A assistente **Saída de pulso/frequência/chave** orienta você sistematicamente por todos os parâmetros que podem ser ajustados para a configuração do tipo de saída selecionado.

Navegação

Menu "Configuração" → Saída de pulso/frequência/chave

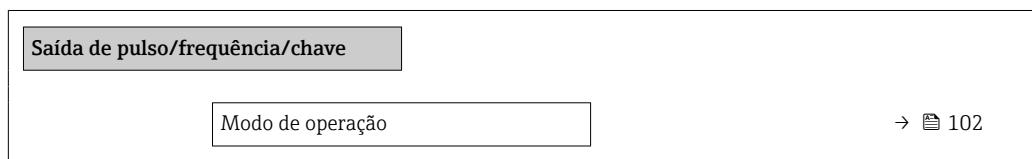


Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Modo de operação	Defina a saída como pulso, frequência ou chave.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impulso ■ Frequência ■ Chave 	Impulso

Configurando o pulso de saída

Navegação

Menu "Configuração" → Saída de pulso/frequência/chave

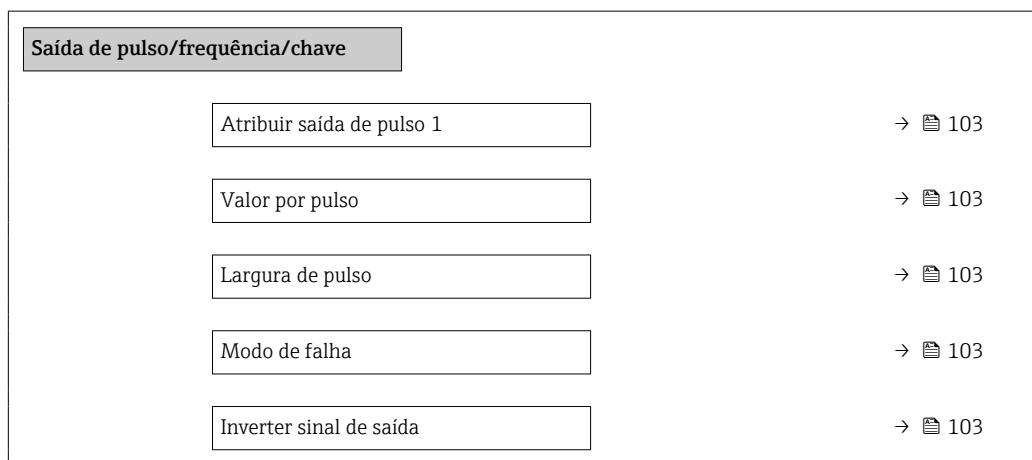

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir saída de pulso	A opção Impulso é selecionada no parâmetro parâmetro Modo de operação .	Selecione a variável de processo para a saída de pulso.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Total de Caudal Mássico* ■ Fluxo de energia* ■ Diferença Caudal calor* 	Vazão volumétrica
Valor por pulso	O opção Impulso é selecionado em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de pulso (→ 103).	Entre com o valor de medição no qual um pulso é enviado.	Número de ponto flutuante positivo	Depende do país e do diâmetro nominal
Largura de pulso	O opção Impulso é selecionado em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de pulso (→ 103).	Defina a largura de pulso de saída.	5 para 2 000 ms	100 ms
Modo de falha	O opção Impulso é selecionado em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de pulso (→ 103).	Defina o comportamento da saída em condição de alarme.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valor atual ■ Sem pulsos 	Sem pulsos
Inverter sinal de saída	–	Inverter o sinal de saída.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não ■ Sim 	Não

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Configuração da saída em frequência

Navegação

Menu "Configuração" → Saída de pulso/frequência/chave

Saída de pulso/frequência/chave	
Atribuir saída de frequência	→ 104
Valor de frequência mínima	→ 104
Valor de frequência máxima	→ 104
Valor de medição na frequência mínima	→ 104
Valor de medição na frequência máxima	→ 104

Modo de falha	→ 104
Frequência de falha	→ 105
Inverter sinal de saída	→ 105

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir saída de frequência	A opção Frequência é selecionada em parâmetro Modo de operação (→ 102).	Selecione a variável de processo para a frequencia de saída.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Velocidade de vazão ■ Temperatura ■ Pressão ■ Pressão Vapor saturado calculada * ■ Total de Caudal Mássico * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * 	Desl.
Valor de frequência mínima	O opção Frequência é selecionado em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de frequência (→ 104).	Entre com a frequência mínima.	0 para 1 000 Hz	0 Hz
Valor de frequência máxima	O opção Frequência é selecionado em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de frequência (→ 104).	Entre com a frequência máxima.	0 para 1 000 Hz	1 000 Hz
Valor de medição na frequência mínima	O opção Frequência é selecionado em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de frequência (→ 104).	Entre com o valor medido para a frequência mínima.	Número do ponto flutuante assinado	Depende do país e do diâmetro nominal
Valor de medição na frequência máxima	A opção Frequência é selecionada em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de frequência (→ 104).	Entre com o valor de medição para a frequência máxima.	Número do ponto flutuante assinado	Depende do país e do diâmetro nominal
Modo de falha	A opção Frequência é selecionada em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de frequência (→ 104).	Defina o comportamento da saída em condição de alarme.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valor atual ■ Valor definido ■ 0 Hz 	0 Hz

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Frequência de falha	A opção Frequência é selecionada em parâmetro Modo de operação (→ 102) e uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir saída de frequência (→ 104).	Entre com o valor da saída de frequência em condição de alarme.	0.0 para 1 250.0 Hz	0.0 Hz
Inverter sinal de saída	–	Inverter o sinal de saída.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não ■ Sim 	Não

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

Configurando a saída comutada

Navegação

Menu "Configuração" → Saída de pulso/frequência/chave

Saída de pulso/frequência/chave	
Função de saída chave	→ 106
Atribuir nível de diagnóstico	→ 106
Atribuir limite	→ 106
Atribuir verificação de direção de vazão	→ 106
Atribuir status	→ 106
Valor para ligar	→ 106
Valor para desligar	→ 106
Atraso para ligar	→ 107
Atraso para desligar	→ 107
Modo de falha	→ 107
Inverter sinal de saída	→ 107

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Função de saída chave	A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação .	Selecione a função para saída como chave.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado ■ Perfil do Diagnóstico ■ Limite ■ Status 	Desl.
Atribuir nível de diagnóstico	<ul style="list-style-type: none"> ■ No parâmetro Modo de operação, a opção Chave é selecionada. ■ No parâmetro Função de saída chave, a opção Perfil do Diagnóstico é selecionada. 	Selecionar o diagnóstico para a saída.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme ■ Alarme ou aviso ■ Advertência 	Alarme
Atribuir limite	<ul style="list-style-type: none"> ■ A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação. ■ A opção Limite é selecionada em parâmetro Função de saída chave. 	Selecione a variável de processo para função limite.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Velocidade de vazão ■ Temperatura ■ Pressão ■ Pressão Vapor saturado calculada * ■ Total de Caudal Mássico * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * ■ Número de Reynolds * ■ Totalizador 1 ■ Totalizador 2 ■ Totalizador 3 	Vazão volumétrica
Atribuir verificação de direção de vazão	<ul style="list-style-type: none"> ■ A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação. ■ A opção Verificação de direção de vazão é selecionada em parâmetro Função de saída chave. 	Selecionar variável para monitoramento de direção de fluxo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão volumétrica ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica corrigida 	Vazão volumétrica
Atribuir status	<ul style="list-style-type: none"> ■ A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação. ■ A opção Status é selecionada em parâmetro Função de saída chave. 	Selecionar status do equipamento para a saída de chave.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Corte de vazão baixa ■ Saída digital 6 	Corte de vazão baixa
Valor para ligar	<ul style="list-style-type: none"> ■ A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação. ■ A opção Limite é selecionada em parâmetro Função de saída chave. 	Inserir valor medido para o ponto de comutação (ligar).	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 pés³/h
Valor para desligar	<ul style="list-style-type: none"> ■ A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação. ■ A opção Limite é selecionada em parâmetro Função de saída chave. 	Inserir valor medido para o ponto de comutação (desligar).	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 pés³/h

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atraso para ligar	<ul style="list-style-type: none"> ■ A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação. ■ A opção Limite é selecionada em parâmetro Função de saída chave. 	Defina o atraso para ligar o status de saída.	0.0 para 100.0 s	0.0 s
Atraso para desligar	<ul style="list-style-type: none"> ■ A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação. ■ A opção Limite é selecionada em parâmetro Função de saída chave. 	Defina o tempo de atraso para desligamento da saída de status.	0.0 para 100.0 s	0.0 s
Modo de falha	-	Defina o comportamento da saída em condição de alarme.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Status atual ■ Abrir ■ Fechado 	Abrir
Inverter sinal de saída	-	Inverter o sinal de saída.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não ■ Sim 	Não


* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

10.5.5 Configuração do totalizador

Em submenu "Totalizador 1 para n" é possível configurar o totalizador individual.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Totalizador 1 para n

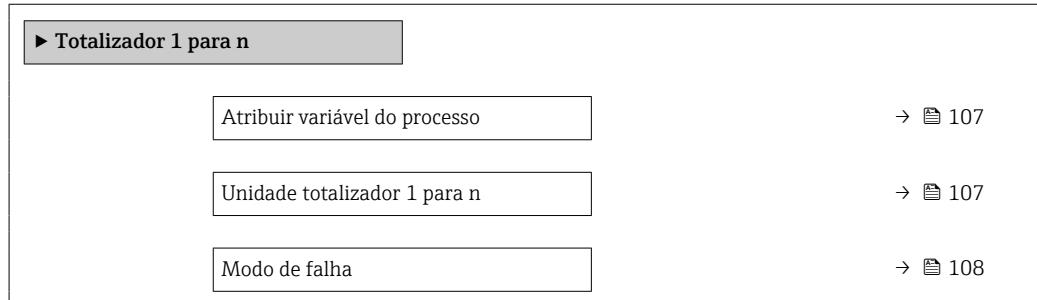

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Atribuir variável do processo	-	Selecionar variável do processo para o totalizador.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Totalizador 1: Vazão volumétrica ■ Totalizador 2: Vazão mássica ■ Totalizador 3: Vazão volumétrica corrigida
Unidade totalizador 1 para n	Uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 107) do submenu Totalizador 1 para n .	Selecionar unidade para variável de processo do totalizador.	Lista de seleção da unidade	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ m³ ■ ft³

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção	Ajuste de fábrica
Modo de operação do totalizador	Uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 107) do submenu Totalizador 1 para n.	Selecionar modo de cálculo do totalizador.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Total líquido (NET) de Vazão ■ Vazão direta total ■ Vazão reversa total 	Total líquido (NET) de Vazão
Modo de falha	Uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 107) do submenu Totalizador 1 para n.	Selecionar o valor do totalizador em uma condição de alarme.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Parar ■ Valor atual ■ Último valor válido 	Parar

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

10.5.6 Execução de configurações de display adicionais

Em submenu **Exibir** é possível ajustar todos os parâmetros associados à configuração do display local.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Exibir

► Exibir	
Formato de exibição	→ 110
Exibir valor 1	→ 110
0% do valor do gráfico de barras 1	→ 110
100% do valor do gráfico de barras 1	→ 110
ponto decimal em 1	→ 110
Exibir valor 2	→ 110
ponto decimal em 2	→ 110
Exibir valor 3	→ 110
0% do valor do gráfico de barras 3	→ 111
100% do valor do gráfico de barras 3	→ 111
ponto decimal em 3	→ 111
Exibir valor 4	→ 111
ponto decimal em 4	→ 111
Language	→ 111
Intervalo exibição	→ 111
Amortecimento display	→ 111
Cabeçalho	→ 111
Texto do cabeçalho	→ 111
Separador	→ 112
Luz de fundo	→ 112

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Formato de exibição	É fornecido um display local.	Selecionar como os valores medidos são exibidos no display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 valor, tamanho máx. ■ 1 gráfico de barras + 1 valor ■ 2 valores ■ 1 valor grande + 2 valores ■ 4 valores 	1 valor, tamanho máx.
Exibir valor 1	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Velocidade de vazão ■ Temperatura ■ Pressão Vapor saturado calculada * ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * ■ Número de Reynolds * ■ Densidade * ■ Pressão * ■ Volume específico * ■ Graus de superaquecimento * ■ Totalizador 1 ■ Totalizador 2 ■ Totalizador 3 	Vazão volumétrica
0% do valor do gráfico de barras 1	É fornecido um display local.	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 m³/h ■ 0 pés³/h
100% do valor do gráfico de barras 1	É fornecido um display local.	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	Depende do país e do diâmetro nominal
ponto decimal em 1	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 1 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ xxxxx 	x.xx
Exibir valor 2	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 82)	Nenhum
ponto decimal em 2	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 2 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ xxxxx 	x.xx
Exibir valor 3	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 82)	Nenhum

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
0% do valor do gráfico de barras 3	Foi feita uma seleção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 0% para gráfico de barra do display.	Número do ponto flutuante assinado	Específico do país: ■ 0 m ³ /h ■ 0 pés ³ /h
100% do valor do gráfico de barras 3	Foi feita uma seleção em parâmetro Exibir valor 3 .	Inserir valor 100% para o gráfico de barras.	Número do ponto flutuante assinado	0
ponto decimal em 3	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 3 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx	x.xx
Exibir valor 4	É fornecido um display local.	Selecionar o valor medido que é mostrado no display local.	Para a lista de opções, consulte parâmetro Exibir valor 1 (→ 82)	Nenhum
ponto decimal em 4	Um valor medido é especificado em parâmetro Exibir valor 4 .	Selecionar o número de casas decimais para o valor do display.	■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx	x.xx
Language	É fornecido um display local.	Definir idioma do display.	■ English ■ Deutsch * ■ Français * ■ Español * ■ Italiano * ■ Nederlands * ■ Portuguesa * ■ Polski * ■ русский язык (Russian) * ■ Svenska * ■ Türkçe * ■ 中文 (Chinese) * ■ 日本語 (Japanese) * ■ 한국어 (Korean) * ■ العربية (Arabic) * ■ Bahasa Indonesia * ■ ภาษาไทย (Thai) * ■ tiếng Việt (Vietnamese) * ■ čeština (Czech) *	English (como alternativa, o idioma solicitado está presente no equipamento)
Intervalo exibição	É fornecido um display local.	Determina o tempo que as variaveis são mostradas no display, se o display altera entre diferentes valores.	1 para 10 s	5 s
Amortecimento display	É fornecido um display local.	Ajustar tempo de reação do display para flutuações no valor medido.	0.0 para 999.9 s	0.0 s
Cabeçalho	É fornecido um display local.	Selecionar conteúdo do cabeçalho no display local.	■ Tag do equipamento ■ Texto livre	Tag do equipamento
Texto do cabeçalho	No parâmetro Cabeçalho , a opção Texto livre é selecionada.	Inserir texto do cabeçalho do display.	Máx. de 12 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)	-----

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Separador	É fornecido um display local.	Selecionar separador decimal para exibição de valores numéricos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ . (ponto) ▪ , (vírgula) 	. (ponto)
Luz de fundo	Código do produto para "Display; operação", opção E "SD03 4 linhas, ilum.; controle touchscreen + função de backup de dados"	Ligar/Desligar a luz de fundo do display.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desabilitar ▪ Habilitar 	Desabilitar

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.


10.5.7 Gerenciamento de configuração

Após o comissionamento, é possível salvar a configuração do equipamento atual, copiá-la para outro ponto de medição ou restaurar a configuração de equipamento anterior.

É possível fazer isso usando o parâmetro **Gerenciamento de configuração** e as respectivas opções encontradas em Submenu **Exibição do backup de configuração**.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Exibição do backup de configuração

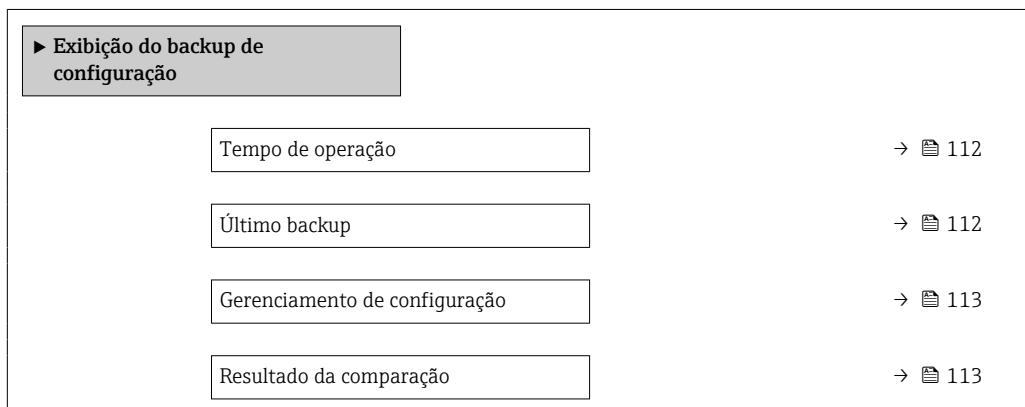

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário / Seleção	Ajuste de fábrica
Tempo de operação	-	Indica por quanto tempo o aparelho esteve em operação.	Dias (d), horas (h), minutos (m) e segundos (s)	-
Último backup	É fornecido um display local.	Indica quando foi feito o último backup para o módulo display.	Dias (d), horas (h), minutos (m) e segundos (s)	-

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário / Seleção	Ajuste de fábrica
Gerenciamento de configuração	É fornecido um display local.	Selecionar ação para gerenciar os dados no módulo display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cancelar ■ Executar backup ■ Restaurar ■ Duplicar ■ Comparar ■ Excluir dados de backup ■ Display incompatible 	Cancelar
Resultado da comparação	É fornecido um display local.	Comparação entre aparelho atual e o backup do display.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Configurações idênticas ■ Configurações não idênticas ■ Nenhum backup disponível ■ Configurações de backup corrompidas ■ Verificação não feita ■ Conjunto de dados incompatíveis 	Verificação não feita

Âmbito da parâmetro "Gerenciamento de configuração"

Opções	Descrição
Cancelar	Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.
Executar backup	Uma cópia backup da configuração atual do equipamento é salva a partir do backup HistoROM para o módulo do display do equipamento. A cópia backup inclui os dados do transmissor do equipamento.
Restaurar	A última cópia backup da configuração do equipamento é restaurada a partir do módulo do display para o backup HistoROM do equipamento. A cópia backup inclui os dados do transmissor do equipamento.
Comparar	A configuração do equipamento salva na memória do equipamento é comparada à configuração atual do equipamento do backup HistoROM .
Duplicar	A configuração do transmissor de outro equipamento é duplicada para o equipamento que está usando o módulo display.
Excluir dados de backup	A cópia de backup da configuração do equipamento é excluída do módulo de display do equipamento.
Display incompatible	<p>Esta opção é exibida se o módulo do display for incompatible. Todas as demais opções não estarão disponíveis. Portanto, não é possível selecioná-las.</p> <p>Esta opção é exibida se não for possível salvar os dados do equipamento e do fieldbus.</p> <p>O módulo do display deve ser atualizado com a versão do software mais recente, de tal forma os dados possam ser salvos.</p>



Backup HistoROM

Um HistoROM é uma memória de equipamento "não-volátil" em forma de um EEPROM.




Enquanto a ação está em andamento, a configuração não pode ser editada através do display local e uma mensagem do status de processamento aparece no display.

10.5.8 Usando os parâmetros para a administração do equipamento

A submenu **Administração** guia o usuário sistematicamente por todos os parâmetro que podem ser usados para fins de administração do equipamento.

Navegação

Menu "Configuração" → Configuração avançada → Administração

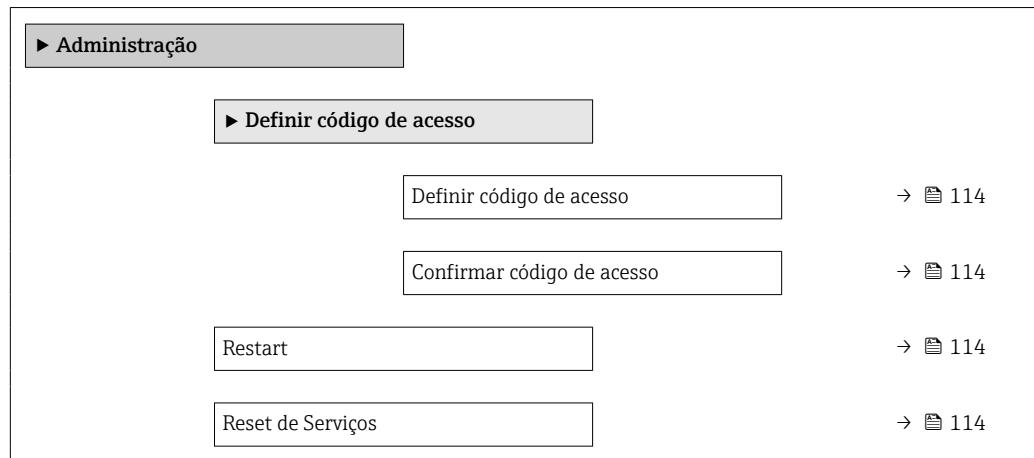**Visão geral dos parâmetros com breve descrição**


Parâmetro	Descrição	Entrada do usuário / Seleção	Ajuste de fábrica
Definir código de acesso	Restringir acesso aos parâmetros para proteger a configuração do instrumento contra alterações não intencionais via display.	0 para 9 999	0
Confirmar código de acesso	Confirmar o código de acesso inserido.	0 para 9 999	0
Restart	Reinic peace ou redefina o equipamento manualmente.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uninitialized ■ Run ■ Resource ■ Defaults ■ Processor ■ Para configurações de entrega 	Uninitialized
Reset de Serviços		<ul style="list-style-type: none"> ■ Uninitialized ■ Para configurações de entrega ■ ENP restart 	Uninitialized

10.6 Simulação

A submenu **Simulação** permite simular, sem uma situação de vazão real, diversas variáveis de processo durante o processo e o modo de alarme do equipamento, além de verificar as correntes de sinal dos circuitos seguintes (válvulas de comutação ou malhas de controle fechado).

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Simulação

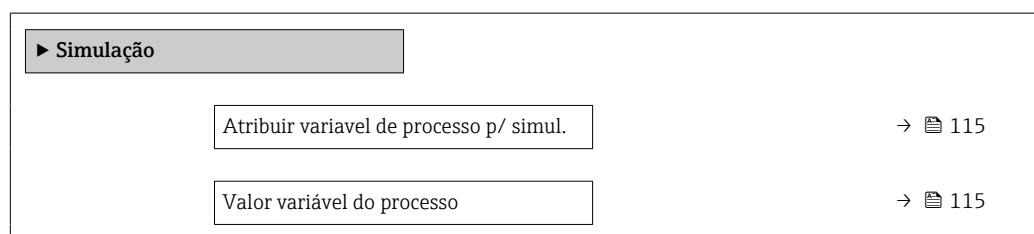

Simulação de saída de frequencia	→ 115
Valor de frequência	→ 115
Simulação de saída de pulso	→ 116
Valor do pulso	→ 116
Simulação saída chave	→ 116
Status da chave (contato)	→ 116
Simulação de alarme	→ 116
Categoria Evento diagnóstico	→ 116
Evento do diagnóstico de simulação	→ 116

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir variavel de processo p/ simul.	-	Selecione a variável de processo para o processo de simulação ativado.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão mássica ■ Velocidade de vazão ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Temperatura ■ Pressão Vapor saturado calculada * ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor * ■ Número de Reynolds 	Desl.
Valor variável do processo	Uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir variavel de processo p/ simul. (→ 115).	Entre com o valor de simulação para a variável de processo selecionada.	Depende da variável de processo selecionada	0
Simulação de saída de frequencia	No parâmetro Modo de operação , a opção Frequênci a é selecionada.	Liga e desliga a simulação da saída de frequência.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado 	Desl.
Valor de frequência	Em Parâmetro Simulação de saída de frequencia , opção Ligado está selecionado.	Entre com o valor de frequência para simulação.	0.0 para 1250.0 Hz	0.0 Hz

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Simulação de saída de pulso	No parâmetro Modo de operação , a opção Impulso é selecionada.	Liga e desliga a simulação da saída de pulso. Para opção Valor Fixo : parâmetro Largura de pulso (\rightarrow 103) define a largura de pulso da saída em pulso.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Valor Fixo ■ Valor contagem regressiva 	Desl.
Valor do pulso	Em Parâmetro Simulação de saída de pulso (\rightarrow 116), opção Valor contagem regressiva está selecionado.	Entre com número de pulsos para simulação.	0 para 65 535	0
Simulação saída chave	No parâmetro Modo de operação , a opção Chave é selecionada.	Liga/Desliga a simulação da saída de status.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado 	Desl.
Status da chave (contato)	Em Parâmetro Simulação saída chave (\rightarrow 116) Parâmetro Simulação saída chave 1 para n Parâmetro Simulação saída chave 1 para n , opção Ligado está selecionado.	Selecione o status da saída de status para simulação.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abrir ■ Fechado 	Abrir
Simulação de alarme	-	Liga/Desliga o alarme do equipamento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Ligado 	Desl.
Categoria Evento diagnóstico	-	Selecione uma categoria de evento de diagnóstico.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensor ■ Componentes eletrônicos ■ Configuração ■ Processo 	Processo
Evento do diagnóstico de simulação	-	Selecione um evento de diagnóstico para simular esse evento.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Lista de opções de evento de diagnóstico (depende da categoria selecionada) 	Desl.

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

10.7 Proteção das configurações contra acesso não autorizado

A opção a seguir existe para proteção da configuração do medidor contra modificação acidental após a atribuição:

- Proteção contra gravação através do código de acesso
- Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação
- Proteção contra gravação através do bloqueio do teclado
- FOUNDATION Fieldbus: proteção contra gravação através de operação de bloqueio \rightarrow 119

10.7.1 Proteção contra gravação através do código de acesso

Os efeitos do código de acesso específico para o usuário são os seguintes:

- Através da operação local, os parâmetros para a configuração do medidor são protegidos contra gravação e seus valores não podem mais ser mudados.
- O acesso ao medidor através de navegador de rede é protegido, assim como os parâmetros para a configuração do medidor.

Definição do código de acesso através do display local


1. Navegue até Parâmetro **Inserir código de acesso**.
2. Define um máx. de 16 caracteres formados por letras, números e caracteres especiais como o código de acesso.
3. Insira novamente o código de acesso em para confirmar o código.
↳ O -símbolo aparece na frente de todos os parâmetros protegidos contra gravação.

O equipamento automaticamente bloqueia os parâmetros protegidos contra gravação novamente se uma tecla não for pressionada por 10 minutos na visualização de navegação e de edição. O equipamento bloqueia os parâmetros protegidos contra gravação automaticamente após 60 s se o usuário voltar para o modo de display de operação a partir da visualização de navegação e de edição.

- Se a proteção contra gravação do parâmetro for ativado através do código de acesso, ele também pode ser desativado somente através do código de acesso → § 59.
- A função de usuário com a qual o usuário está conectado pelo display local → § 59 é indicada pelo parâmetro Parâmetro **Display de status de acesso**. Caminho de navegação: Operação → Display de status de acesso

Parâmetros que podem sempre ser modificados através do display local

Determinados parâmetros que não afetam a medição são excluídos da proteção contra gravação de parâmetro através do display local. Apesar do código de acesso específico para o usuário, estes parâmetros podem sempre ser modificados, mesmo que outros parâmetros estejam bloqueados.

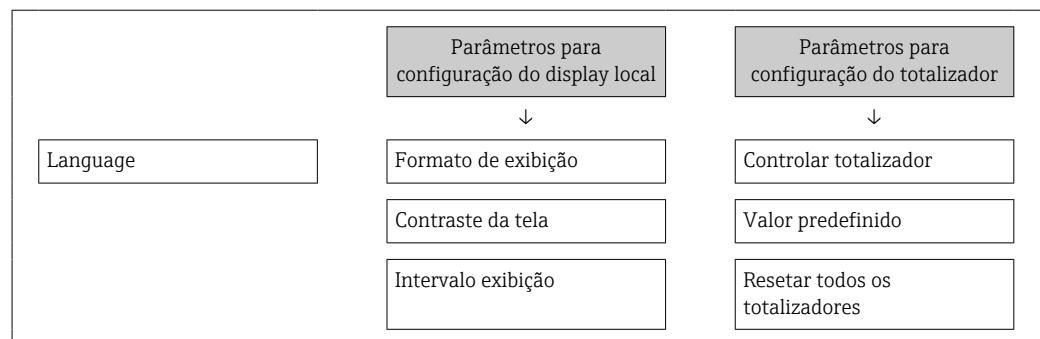


10.7.2 Proteção contra gravação por meio da chave de proteção contra gravação

Diferente da proteção contra gravação do parâmetro através do código de acesso específico para o usuário, isto permite que o acesso de gravação a todo o menu de operação - exceto por parâmetro "Contraste da tela" - seja bloqueado.


Os valores de parâmetro são agora somente leitura e não podem mais ser editados (exceto por parâmetro "Contraste da tela"):

- Através do display local
- Pelo FOUNDATION Fieldbus

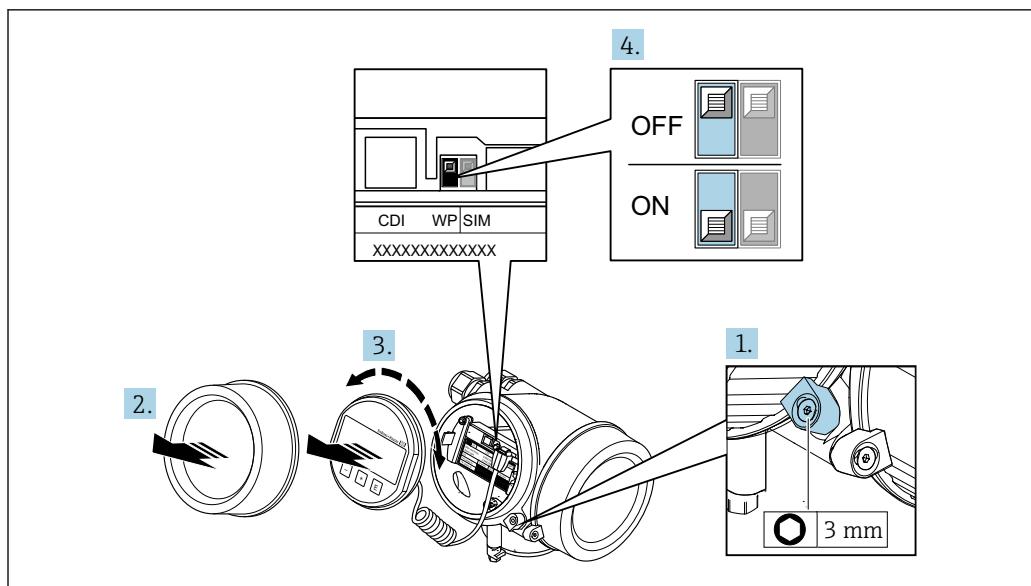


A0032241

1. Solte a braçadeira de fixação.
2. Desaparafuse a tampa do compartimento de componentes eletrônicos.
3. Puxe o módulo do display para fora com um suave movimento de rotação. Para facilitar o acesso à seletora de proteção contra gravação, instale o módulo do display na borda do compartimento de componentes eletrônicos.
→ O módulo de display é instalado na borda do compartimento de componentes eletrônicos.

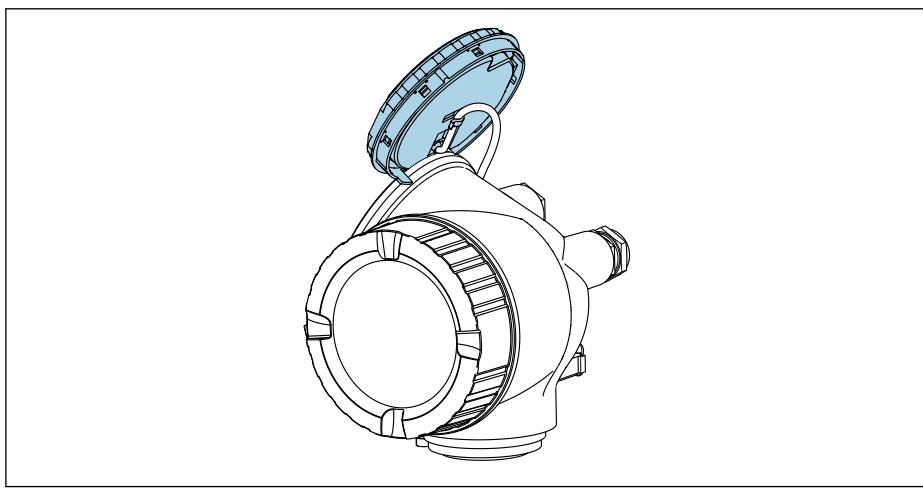

A0032236

4. O ajuste da chave de proteção contra gravação (WP) no módulo de componentes eletrônicos principal para a posição **ON** habilita a proteção contra gravação de hardware. O ajuste da chave de proteção (WP) contra gravação no módulo de componentes eletrônicos principal para a posição **OFF** (ajuste de fábrica) desabilita a proteção contra gravação de hardware.
- ↳ Caso a proteção contra gravação de hardware esteja habilitada, opção **Hardware bloqueado** é exibido no parâmetro **Status de bloqueio**. Além disso, no display local o -símbolo aparece na frente dos parâmetros no cabeçalho do display de operação e na visualização de navegação.

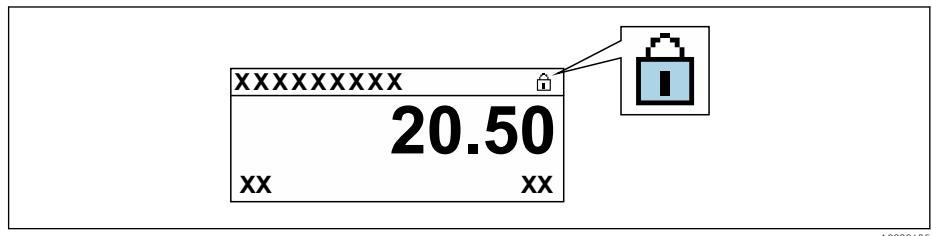

Caso a proteção contra gravação de hardware esteja desabilitada, nenhuma opção é exibida no parâmetro **Status de bloqueio**. No display local o -símbolo desaparece da frente dos parâmetros no cabeçalho do display de operação e na visualização de navegação.

5. Coloque o cabo no vão entre o invólucro e o módulo da eletrônica principal e conecte o módulo do display no compartimento dos componentes eletrônicos na direção desejada até encaixar.
6. Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

10.7.3 Proteção contra gravação através de operação de bloqueio

Bloqueio por meio de operação do bloco:

- Bloco: **DISPLAY (TRDDISP)**; parâmetro: **Define access code**
- Bloco: **EXPERT_CONFIG (TRDEXP)**; parâmetro: **Enter access code**

10.8 Configuração do medidor através do FOUNDATION Fieldbus

10.8.1 Configuração do bloco

Preparação

 Para a preparação, são necessários os arquivos Cff e de descrição do equipamento corretos.

1. Ligue o equipamento.
2. Anote o **DEVICE_ID**.
3. Abra o programa de configuração.
4. Carregue os arquivos Cff e os de descrição do equipamento no sistema host ou o programa de configuração.
5. Identifique o equipamento usando o **DEVICE_ID**.
6. Atribua o nome de tag desejado para o equipamento por meio do parâmetro **Pd-tag/FF_PD_TAG**.

Configuração do Bloco de Recursos

1. Abra o Bloco de Recursos.
2. Desabilite o bloqueio para a operação do equipamento.
3. Altere o nome do bloco (opcional). Ajuste de fábrica: RB-xxxxxxxxxx (RB2)
4. Atribua uma descrição ao bloco por meio do parâmetro **Descrição do tag de identificação/TAG_DESC**.
5. Altere outros parâmetros conforme necessário.

Configuração dos Blocos do Transdutor

Os módulos de medição e de display são configurados usando os blocos do transdutor. O procedimento básico é o mesmo para todos os blocos do transdutor.

1. Abra o bloco transdutor específico.
2. Altere o nome do bloco (opcional).
3. Defina o modo do bloco como **OOS** usando o parâmetro **Block Mode/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.
4. Configure o equipamento de acordo com a tarefa de medição
5. Defina o modo do bloco como **Auto** usando o parâmetro **Block Mode/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.

 O modo do bloco deve ser definido como **Auto** para garantir a operação correta do equipamento.

Configuração dos blocos de entrada analógica

1. Abra o bloco de Entrada Analógica.
2. Altere o nome do bloco (opcional).
3. Defina o modo do bloco como **OOS** usando o parâmetro **Block Mode/MODE_BLK**, elemento **TARGET**.
4. Através do parâmetro **Channel/CHANNEL**, selecione a variável de processo que deverá ser usada como o valor de entrada para o bloco de entrada analógica.


5. Use o parâmetro **Transducer Scale/XD_SCALE** para selecionar a unidade desejada e a faixa de entrada do bloco para a variável de processo . A unidade selecionada deve ser adequada à variável de processo selecionada. Se a variável de processo não se adequar à unidade, o parâmetro **Block Error/BLOCK_ERR** informa *Erro de Configuração do Bloco* e o modo do bloco não pode ser definido como **Auto**.
6. Use o parâmetro **Linearization Type/L_TYPE** para selecionar o tipo de linearização para a variável de entrada (ajuste de fábrica: **Direct**). No modo de linearização **Direto**, as configurações dos parâmetros **Transducer scale/XD_SCALE** e **Output scale/OUT_SCALE** devem ser idênticas. Se os valores forem apropriados para as unidades, o parâmetro **Block Error/BLOCK_ERR** informa *Erro de Configuração do Bloco* e o modo do bloco não pode ser definido como **Auto**.
7. Insira os alarmes e as mensagens de alarme críticas por meio dos parâmetros **High alarm limit/ HI_HI_LIM**, **High early warning limit/HI_LIM**, **Low alarm limit/ LO_LO_LIM** e **Low early warning limit/LO_LIM**. Os valores limite inseridos devem estar dentro da faixa de valor especificada para o parâmetro **Output Scale/OUT_SCALE**.
8. Especifique as prioridades do alarme através do parâmetro **Priority for high limit value alarm/HI_HI_PRI**, **Priority for high early warning/HI_PRI**, **Priority for low limit value alarm/LO_LO_PRI** e **Priority for low limit value early warning/LO_PRI**. O relatório ao sistema host de campo somente é efetuado com alarmes cuja prioridade seja superior a 2.
9. Defina o modo do bloco como **Auto** usando o parâmetro **Block Mode/MODE_BLK**, elemento **TARGET**. Para isto, o bloco de recursos também deverá ser definido como o modo do bloco **Auto**.

Configurações adicionais

1. Conexão dos blocos de funções e dos blocos de saída.
2. Após especificar o LAS ativo, faça o download de todos os dados e parâmetros para o equipamento de campo.

10.8.2 Dimensionamento do valor medido no bloco de entrada analógica

O valor medido pode ser dimensionado se foi selecionado o tipo de linearização **L_TYPE = Indirect** no bloco de entrada analógica. **XD_SCALE** define a faixa de entrada com os elementos **EU_0** e **EU_100**. Ela é mapeada linearmente para a faixa de saída definida pelo **OUT_SCALE** e também com os elementos **EU_0** e **EU_100**.

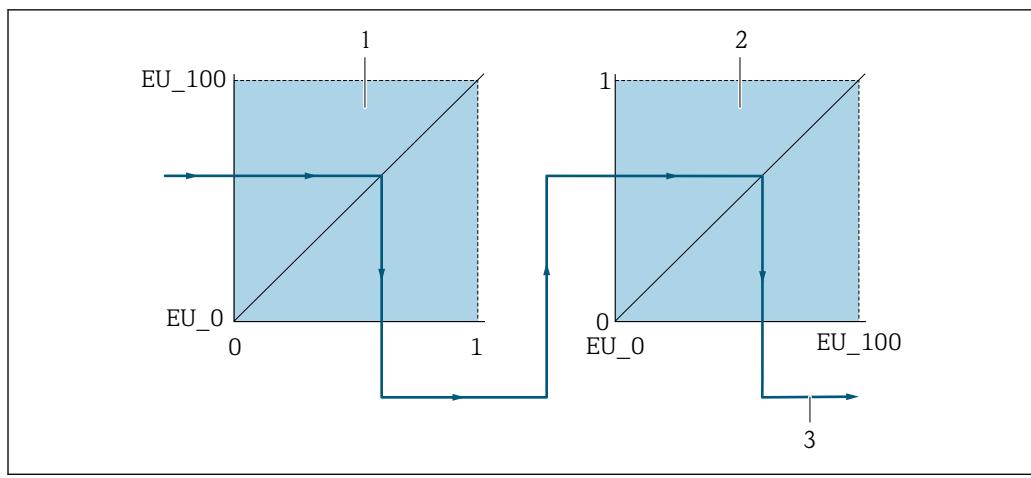

20 Dimensionamento do valor medido no bloco de entrada analógica

- 1 *XD_SCALE*
- 2 *OUT_SCALE*
- 3 *OUT_VALUE*

- i**
- Se o modo **Direto** foi selecionado no parâmetro **L_TYPE**, não é possível alterar os valores e as unidades de **XD_SCALE** e **OUT_SCALE**.
 - Os parâmetros **L_TYPE**, **XD_SCALE** e **OUT_SCALE** somente podem ser alterados no modo de bloco **OOS**.

10.9 Comissionamento para aplicação específica

10.9.1 Aplicações com vapor

Selecionar meio

Navegação:

Configuração → Selecionar o meio

1. Vá para assistente **Selecionar o meio**.
2. Em parâmetro **Selecionar meio**, selecione opção **Vapor**.
3. Quando o valor da pressão medida é lido na ²⁾:
Em parâmetro **Modo de calculo de vapor**, selecione opção **Automatica (p-/T-compensada)**.
4. Se o valor da pressão medida não for lido:
Em parâmetro **Modo de calculo de vapor**, selecione opção **Vapor saturado (T-compensada)**.
5. Em parâmetro **Valor Qualidade Vapor**, insira a qualidade do vapor presente do tubo.
↳ Medidor utiliza esse valor para calcular a vazão mássica de vapor.

Configurando a entrada analógica (AI)

6. Configurando a entrada analógica (AI).

10.9.2 Aplicação em líquido

Líquido específico do usuário, por exemplo, óleo transportador de calor

2) Opção de versão do sensor "massa (Medição de pressão e temperatura integrada)", Pressão lida através da FF

Selecionar meio

Navegação:

Configuração → Selecionar o meio

1. Vá para assistente **Selecionar o meio**.
2. Em parâmetro **Selecionar meio**, selecione opção **Líquido**.
3. Em parâmetro **Selecione o tipo de líquido**, selecione opção **Líquido Específico**.
4. Em parâmetro **Tipo Entalpia**, selecione opção **Quente**.
 - ↳ Opção **Quente**: líquido não inflamável que serve como transportador de calor.
 - Opção **Valor calorífico**: líquido inflamável cuja energia de combustão é calculada.

Configurando propriedades do fluido

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio

5. Vá para submenu **Propriedades do meio**.
6. Em parâmetro **Densidade de referência**, insira a densidade de referência do fluido.
7. Em parâmetro **Temperatura de referência**, insira a temperatura do fluido associada à densidade de referência.
8. Em parâmetro **Coeficiente de expansão linear**, insira o coeficiente de expansão do fluido.
9. Em parâmetro **Calor específico**, insira o calor específico do fluido.
10. Em parâmetro **Viscosidade Dinâmica**, insira a viscosidade do fluido.

10.9.3 Aplicações gasosas

i Para a medição precisa de massa ou de volume corrigido, recomenda-se a utilização da versão do sensor compensado por pressão/temperatura. Se esta versão do sensor não estiver disponível, leia a pressão através da FF. Se nenhuma dessas opções for possível, a pressão também pode ser inserida como um valor fixo em parâmetro **Valor Pressão Fixo**.

i Computador de vazão disponível apenas com o código de pedido para "Versão do sensor", opção "massa" (medição de temperatura integrada)" ou opção "massa (medição de pressão/temperatura integrada)".

Gás único

Gás de combustão, por exemplo, metano CH₄

Selecionar meio

Navegação:

Configuração → Selecionar o meio

1. Vá para assistente **Selecionar o meio**.
2. Em parâmetro **Selecionar meio**, selecione opção **Gás**.
3. Em parâmetro **Selecionar tipo de gás**, selecione opção **Gas Unico**.
4. Em parâmetro **Tipo gás**, selecione opção **Metano CH4**.

Configurando propriedades do fluido

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio

5. Vá para submenu **Propriedades do meio**.

6. Em parâmetro **Temperatura de referência de combustão**, insira a temperatura de referência de combustão do fluido.

7.

Configurando a entrada analógica (AI)

8. Configure a entrada analógica (AI) para a variável de processo "fluxo de energia".

Configurando as propriedades do fluido opcional para a saída da vazão volumétrica corrigida

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio

9. Vá para submenu **Propriedades do meio**.
10. Em parâmetro **Pressão de referência**, insira a pressão de referência do fluido.
11. Em parâmetro **Temperatura de referência**, insira a temperatura de referência do fluido.

Mistura de gases

Formação de gás para usinas siderúrgicas e laminadores, e. g. N₂/H₂

Selecionar meio

Navegação:

Configuração → Selecionar o meio

1. Vá para assistente **Selecionar o meio**.
2. Em parâmetro **Selecionar meio**, selecione opção **Gás**.
3. Em parâmetro **Selecionar tipo de gás**, selecione opção **Mistura de gases**.

Configurando a composição do gás

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio → Composição Gas

4. Vá para submenu **Composição Gas**.
5. Em parâmetro **Mistura de gases**, selecione opção **Hidrogênio H2** e opção **Nitrogênio N2**.
6. Em parâmetro **Mol% H2**, insira a quantidade de hidrogênio.
7. Em parâmetro **Mol% N2**, insira a quantidade de nitrogênio.
 - ↳ A soma das quantidades deve ser de até 100 %.
 - A densidade é determinada de acordo com NEL 40.

Configurando as propriedades do fluido opcional para a saída da vazão volumétrica corrigida

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio

8. Vá para submenu **Propriedades do meio**.
9. Em parâmetro **Pressão de referência**, insira a pressão de referência do fluido.
10. Em parâmetro **Temperatura de referência**, insira a temperatura de referência do fluido.

Ar

Selecionar meio

Navegação:

Configuração → Selecionar o meio

1. Vá para assistente **Selecionar o meio**.
2. Em parâmetro **Selecionar meio** (→ 77), selecione opção **Gás**.
3. Em parâmetro **Selecionar tipo de gás** (→ 77), selecione opção **Ar**.
 - ↳ A densidade é determinada de acordo com NEL 40.
4. Insira o valor em parâmetro **Umidade relativa** (→ 78).
 - ↳ A umidade relativa é inserida como %. A umidade relativa é convertida internamente em umidade absoluta e então incluída no cálculo da densidade de acordo com NEL 40.
5. Em parâmetro **Valor Pressão Fixo** (→ 78), insira o valor da pressão presente no processo.

Configurando propriedades do fluido

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio

6. Vá para submenu **Propriedades do meio**.
7. Em parâmetro **Pressão de referência** (→ 87), insira a pressão de referência para calcular a densidade de referência.
 - ↳ Pressão que é utilizada como referência estática para combustão. Isso permite comparar os processos de combustão em diferentes pressões.
8. Em parâmetro **Temperatura de referência** (→ 87), insira a temperatura para calcular a densidade de referência.

 Endress+Hauser recomenda o uso de compensação ativa de pressão. Isso exclui completamente o risco de erros de medição devido a variações de pressão e registros incorretos.

Gás natural

Selecionar meio

Navegação:

Configuração → Selecionar o meio

1. Vá para assistente **Selecionar o meio**.
2. Em parâmetro **Selecionar meio** (→ 77), selecione opção **Gás**.
3. Em parâmetro **Selecionar tipo de gás** (→ 77), selecione opção **Gás natural**.
4. Em parâmetro **Valor Pressão Fixo** (→ 78), insira o valor da pressão presente no processo.
5. Em parâmetro **Cálculo Entalpia** (→ 79), selecione uma das opções a seguir:
 - ↳ AGA5
 - Opção **ISO 6976** (contém GPA 2172)
6. Em parâmetro **Cálculo de densidade** (→ 79), selecione uma das opções a seguir.
 - ↳ AGA Nx19
 - Opção **ISO 12213- 2** (contém AGA8-DC92)
 - Opção **ISO 12213- 3** (contém SGERG-88, AGA8 método bruto 1)

Configurando propriedades do fluido

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio

7. Vá para submenu **Propriedades do meio**.
8. Em parâmetro **Tipo de Vapor Calorífico**, selecione uma das opções.
9. Em parâmetro **Referência poder calorífico**, insira o valor calorífico bruto de referência do gás natural.
10. Em parâmetro **Pressão de referência** (→ 87), insira a pressão de referência para calcular a densidade de referência.
 - ↳ Pressão que é utilizada como referência estática para combustão. Isso permite comparar os processos de combustão em diferentes pressões.
11. Em parâmetro **Temperatura de referência** (→ 87), insira a temperatura para calcular a densidade de referência.
12. Em parâmetro **Densidade Relativa**, insira a densidade relativa do gás natural.

i Endress+Hauser recomenda o uso de compensação ativa de pressão. Isso exclui completamente o risco de erros de medição devido a variações de pressão e registros incorretos.

Gás ideal

A unidade "vazão volumétrica corrigida" é frequentemente usada para medir misturas de gases industriais, em particular de gás natural. Para fazer isso, a vazão mássica calculada é dividida por uma densidade de referência. Para calcular a vazão mássica, é essencial conhecer a composição exata do gás. Na prática, no entanto, esta informação geralmente não está disponível (por exemplo, a forma que ela varia ao longo do tempo). Neste caso, pode ser útil considerar o gás como um gás ideal. Isso significa que apenas as variáveis de temperatura operacional e de pressão operacional, bem como as variáveis de temperatura de referência e de pressão de referência são necessárias para calcular a vazão volumétrica corrigida. O erro resultante (tipicamente 1 para 5 %) dessa suposição geralmente é consideravelmente menor do que o erro causado por dados imprecisos de composição. Esse método não deve ser utilizado para gases que condensam (p. ex., vapor saturado).

Selecionar meio

Navegação:

Configuração → Selecionar o meio

1. Vá para assistente **Selecionar o meio**.
2. Em parâmetro **Selecionar meio**, selecione opção **Gás**.
3. Em parâmetro **Selecionar tipo de gás**, selecione opção **Gas Específico**.
4. Para gás não inflamável:
Em parâmetro **Tipo Entalpia**, selecione opção **Quente**.

Configurando propriedades do fluido

Navegação:

Configuração → Configuração avançada → Propriedades do meio

5. Vá para submenu **Propriedades do meio**.
6. Em parâmetro **Densidade de referência**, insira a densidade de referência do fluido.
7. Em parâmetro **Pressão de referência**, insira a pressão de referência do fluido.
8. Em parâmetro **Temperatura de referência**, insira a temperatura do fluido associada à densidade de referência.
9. Em parâmetro **Z-factor Referência**, insira o valor **1**.

10. Se será medido o calor específico:
Em parâmetro **Calor específico**, insira o calor específico do fluido.
11. Em parâmetro **Z-factor**, insira o valor **1**.
12. Em parâmetro **Viscosidade Dinâmica**, insira a viscosidade do fluido sob condições operacionais.

10.9.4 Cálculo das variáveis medidas

É possível encontrar um computador de vazão nos componentes eletrônicos do medidor com o código de pedido para "Versão do sensor", opção "massa (medição da temperatura integrada)" e a opção "massa (medição de pressão/temperatura integrada)". Esse computador pode calcular as seguintes variáveis medidas secundárias diretamente a partir das variáveis medidas primárias registradas usando o valor de pressão (admissão ou saída) e/ou o valor de temperatura (medido ou inserido).

Vazão mássica e vazão volumétrica corrigida

Meio	Fluido	Padrões	Explicação
Vapor ¹⁾	Vapor de água	IAPWS-IF97/ ASME	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para a medição da temperatura integrada ■ Para a pressão de processo fixa, pressão medida diretamente no corpo do medidor ou se a pressão for lida através da FOUNDATION Fieldbus
Gás	Gás único	NEL40	Para a pressão de processo fixa, pressão medida diretamente no corpo do medidor ou se a pressão for lida através da Fieldbus
	Mistura de gases	NEL40	
	Ar	NEL40	
	Gás natural	ISO 12213-2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contém AGA8-DC92 ■ Para a pressão de processo fixa, pressão medida diretamente no corpo do medidor ou se a pressão for lida através da Fieldbus
		AGA NX-19	Para a pressão de processo fixa, pressão medida diretamente no corpo do medidor ou se a pressão for lida através da Fieldbus
		ISO 12213-3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contém SGERG-88, AGA8 método bruto 1 ■ Para a pressão de processo fixa, pressão medida diretamente no corpo do medidor ou se a pressão for lida através da Fieldbus
Líquidos	Outros gases	Equação linear	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gases ideais ■ Para a pressão de processo fixa, pressão medida diretamente no corpo do medidor ou se a pressão for lida através da Fieldbus
	Água	IAPWS-IF97/ ASME	-
	Gás liquefeito	Tabelas	Mistura de propano e butano
Outros líquidos	Outros líquidos	Equação linear	Líquidos ideais

- 1) O medidor consegue calcular a vazão volumétrica e outras variáveis medidas derivadas da vazão volumétrica, em todos os tipos de vapor com compensação total, usando pressão e temperatura. Para configurar o comportamento do equipamento → 98

Cálculo da vazão mássica

Vazão volumétrica × densidade de operação

- Densidade de operação para vapor saturado, água e outros líquidos: depende da temperatura
- Densidade de operação para vapor superaquecido e todos os outros gases: depende da temperatura e da pressão de processo

Cálculo da vazão volumétrica corrigida

(Vazão volumétrica × densidade de operação)/densidade de referência

- Densidade de operação para água e outros líquidos: depende da temperatura
- Densidade de operação para todos outros gases: depende da temperatura e da pressão de processo

Vazão de energia

Meio	Fluido	Padrões	Explicação	Opção calor/energia
Vapor ¹⁾	-	IAPWS-IF97/ ASME	Para pressão de processo fixa ou se a pressão for lida através da Fieldbus PROFIBUS	
Gás	Gás único	ISO 6976	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contém GPA 2172 ■ Para pressão de processo fixa ou se a pressão for lida através da Fieldbus PROFIBUS 	Calor Valor calorífico bruto ²⁾ em relação à massa Valor calorífico líquido ³⁾ em relação à massa Valor calorífico bruto ²⁾ em relação ao volume corrigido Valor calorífico líquido ³⁾ em relação ao volume corrigido
	Mistura de gases	ISO 6976	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contém GPA 2172 ■ Para pressão de processo fixa ou se a pressão for lida através da Fieldbus PROFIBUS 	
	Ar	NEL40	Para pressão de processo fixa ou se a pressão for lida através da Fieldbus PROFIBUS	
	Gás natural	ISO 6976	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contém GPA 2172 ■ Para pressão de processo fixa ou se a pressão for lida através da Fieldbus PROFIBUS 	
	AGA 5	-	-	
Líquidos	Água	IAPWS-IF97/ ASME	-	
	Gás liquefeito	ISO 6976	Contém GPA 2172	
	Outros líquidos	Equação linear	-	

1) O medidor consegue calcular a vazão volumétrica e outras variáveis medidas derivadas da vazão volumétrica, em todos os tipos de vapor com compensação total, usando pressão e temperatura. Para configurar o comportamento do equipamento → 98

2) Valor calorífico bruto : energia de combustão + energia de condensação do gás de combustão (valor calorífico bruto > valor calorífico líquido)

3) Valor calorífico líquido: somente energia de combustão

Cálculo da vazão mássica e da vazão de energia

O vapor é calculado com base nos seguintes fatores:

- Cálculo de densidade totalmente compensada usando as variáveis medidas "pressão" e "temperatura"
- Cálculo baseado no vapor superaquecido até que o ponto de saturação seja atingido
Configuração do comportamento de diagnóstico da mensagem de diagnóstico
△S871 Limite de saturação de vapor perto parâmetro **Atribuir nível de evento nº 871**
definido como opção **Desl.** (ajuste de fábrica) por padrão → [152](#)
Configuração opcional do comportamento de diagnóstico para a opção opção **Alarme** ou opção **Advertência** → [147](#).
Na saturação acima 2 K, ativação da mensagem de diagnóstico **△S871 Limite de saturação de vapor perto**.
- O valor menor dos dois seguintes valores de pressão é sempre usado para calcular a densidade:
 - Pressão medida diretamente no corpo do medidor ou na pressão lida através da Fieldbus PROFIBUS
 - A pressão do vapor saturado determinada a partir da linha de vapor saturado (IAPWS-IF97/ASME)
- Depende da configuração no parâmetro **Modo de cálculo de vapor** (→ [78](#))
 - Se for selecionado a opção **Vapor saturado (T-compensada)**, o medidor calcula apenas a curva de vapor saturado usando a compensação de temperatura.
 - Se for selecionado a opção **Automatica (p-/T-compensada)**, o equipamento calcula usando a compensação total ao longo da linha de saturação ou na região superaquecida, dependendo do estado do vapor.

 Para informações mais detalhadas sobre como executar a compensação externa, consulte → [98](#).

Valor calculado

A unidade calcula a vazão mássica, vazão de calor, vazão de energia, densidade e entalpia específica a partir da vazão volumétrica medida e a temperatura medida e/ou a pressão, com base no padrão internacional IAPWS-IF97/ASME.

Fórmula para cálculo:

- Vazão mássica: $\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho (T, p)$
- Vazão de calor: $\dot{Q} = \dot{V} \cdot \rho (T, p) \cdot h_D (T, p)$

\dot{m} = Vazão mássica

\dot{Q} = Vazão de calor

\dot{V} = Vazão volumétrica (medida)

h_D = Entalpia específica

T = Temperatura do processo (medida)

p = Pressão de processo

ρ = Densidade ³⁾ especificada

Gases pré-programados

Os seguintes gases são pré-programados no computador de vazão:

Hidrogênio ¹⁾	Hélio 4	Neon	Árgon
Crípton	Xenônio	Nitrogênio	Oxigênio
Cloro	Amônia	Monóxido de carbono ¹⁾	Dióxido de carbono
Dióxido de enxofre	Sulfato de hidrogênio ¹⁾	Cloreto de hidrogênio	Metano ¹⁾

3) A partir dos dados de vapor, de acordo com IAPWS-IF97 (ASME), para a temperatura medida e a pressão

Etano ¹⁾	Propano ¹⁾	Butano ¹⁾	Etileno (eteno) ¹⁾
Cloreto de vinilo	Misturas de até 8 componentes desses gases ¹⁾		

- 1) A vazão de energia é calculada de acordo com ISO 6976 (contém GPA 2172) ou AGA5 - em relação ao valor calorífico líquido ou o valor calorífico bruto .

Cálculo da vazão de energia

Vazão volumétrica × densidade de operação × entalpia específica

- Densidade de operação para vapor saturado e água: depende da temperatura
- Densidade de operação para vapor superaquecido, gás natural ISO 6976 (contém GPA 2172), gás natural AGA5: depende da temperatura e da pressão

Diferença de vazão de calor

- Entre a vapor saturado ascendente de um trocador de calor e o condensado descendente do trocador de calor (segunda temperatura lida através da Fieldbus PROFIBUS) de acordo com IAPWS-IF97/ASME
- Entre água quente e fria (segunda temperatura lida através da Fieldbus PROFIBUS) de acordo com IAPWS-IF97/ASME

Pressão do vapor e temperatura do vapor

O medidor pode realizar as seguintes medições no vapor saturado entre a linha de alimentação e a de retorno de qualquer líquido de aquecimento (segunda temperatura lida através da Fieldbus PROFIBUS e valor Cp inserido):

- Cálculo da pressão de saturação do vapor a partir da temperatura medida e da saída de acordo com IAPWS-IF97/ASME
- Cálculo da temperatura de saturação do vapor a partir da pressão predefinida e da saída de acordo com IAPWS-IF97/ASME

11 Operação

11.1 Leitura do status de bloqueio do equipamento

Proteção contra gravação no equipamento ativa: parâmetro **Status de bloqueio**

Operação → Status de bloqueio

Âmbito da parâmetro "Status de bloqueio"

Opções	Descrição
Nenhum	O status de acesso exibido em Parâmetro Display de status de acesso é aplicável → 59. Aparece apenas no display local.
Hardware bloqueado	A minisseletora para o bloqueio do hardware é ativada na placa PCB do . Isso bloqueia o acesso à gravação dos parâmetros (por exemplo, através do display local ou ferramenta de operações) → 117.
Temporariamente bloqueado	O acesso à gravação dos parâmetros está temporariamente bloqueado por conta de processos internos em andamento no equipamento (por exemplo, upload/download de dados, reset etc.). Uma vez que o processamento interno esteja completo, os parâmetros podem ser alterados novamente.

11.2 Ajuste do idioma de operação



Informações detalhadas:

- Para configurar o idioma de operação → 71
- Para mais informações sobre os idiomas de operação compatíveis no medidor → 223

11.3 Configuração do display

Informações detalhadas:


- Nas configurações básicas do display local → 80
- Nas configurações avançadas do display local → 109

11.4 Leitura dos valores medidos

Com o submenu **Valor medido**, é possível ler todos os valores medidos.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Valor medido → Variáveis de processo

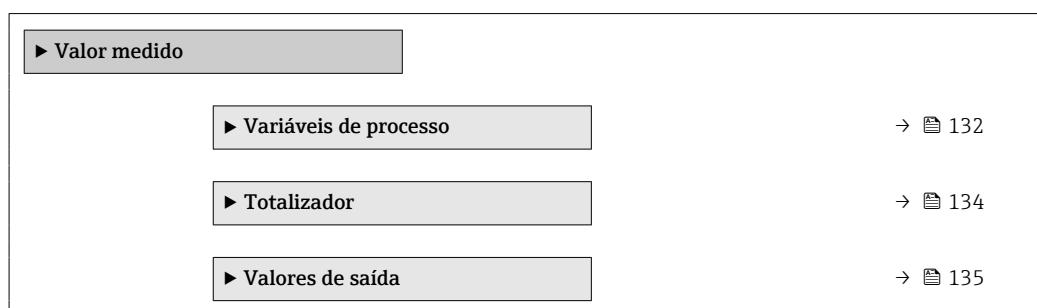

11.4.1 Variáveis de processo

As Submenu **Variáveis de processo** contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para cada variável de processo.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Valor medido → Variáveis de processo

► Variáveis de processo	
Vazão volumétrica	→ 133
Vazão volumétrica corrigida	→ 133
Vazão mássica	→ 133
Velocidade de vazão	→ 133
Temperatura	→ 133
Pressão Vapor saturado calculada	→ 133
Fluxo de energia	→ 133
Diferença Caudal calor	→ 133
Número de Reynolds	→ 133
Densidade	→ 134
Volume específico	→ 134
Pressão	→ 134
Fator compressibilidade	→ 134
Graus de superaquecimento	→ 134

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Vazão volumétrica	-	<p>Exibe a vazão volumétrica atualmente medida.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de vazão volumétrica (→ 74).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Vazão volumétrica corrigida	-	<p>Exibe a vazão volumétrica corrigida atualmente calculada.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de vazão volumétrica corrigida (→ 74).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Vazão mássica	-	<p>Exibe a vazão mássica atualmente calculada.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de vazão mássica (→ 74).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Velocidade de vazão	-	<p>Exibe a velocidade de vazão que está sendo calculada no momento.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de velocidade (→ 76).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Temperatura	-	<p>Exibe a temperatura que está sendo medida no momento.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de temperatura (→ 75).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Pressão Vapor saturado calculada	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ A opção Vapor é selecionada em parâmetro Selecionar meio (→ 77). 	<p>Exibe a pressão de vapor saturado atualmente calculada.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de pressão (→ 75).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Fluxo de energia	<p>Com o Código do produto para "Versão do sensor":</p> <p>opção "Massa (medição da temperatura integrada)"</p>	<p>Exibe a vazão de energia que está sendo calculada no momento.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade vazão de energia (→ 75).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Diferença Caudal calor	<p>As condições a seguir são atendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor" opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ No parâmetro Selecionar tipo de gás (→ 77), uma das opções seguintes é selecionada: Gas Unico Mistura de gases Gás natural Gas Específico 	<p>Exibe a diferença de vazão de calor que está sendo calculada no momento.</p> <p><i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade vazão de energia (→ 75).</p>	Número do ponto flutuante assinado
Número de Reynolds	<p>Com o Código do produto para "Versão do sensor":</p> <p>opção "Massa (medição da temperatura integrada)"</p>	Exibe o número Reynolds que está sendo calculado no momento.	Número do ponto flutuante assinado


Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Densidade	Com o Código do produto para "Versão do sensor": Opção "Massa (medição da temperatura integrada)"	Exibe a densidade atualmente medida. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de densidade .	Número do ponto flutuante positivo
Volume específico	Com o Código do produto para "Versão do sensor": Opção "Massa (medição da temperatura integrada)"	Exibe o valor atual para o volume específico. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de volume específico .	Número do ponto flutuante positivo
Pressão	Uma das condições a seguir é atendida: <ul style="list-style-type: none"> ■ Código do produto para "Versão do sensor", <ul style="list-style-type: none"> ■ Opção "Massa (medição da temperatura integrada)" ■ ou ■ O opção Pressão é selecionado no parâmetro parâmetro Valor externo. 	Exibe a pressão de processo atual. <i>Dependência</i> A unidade foi obtida de parâmetro Unidade de pressão .	0 para 250 bar
Fator compressibilidade	As condições a seguir são atendidas: Código do produto para "Versão do sensor" Opção "Massa (medição da temperatura integrada)" O opção Gás ou opção Vapor é selecionado em parâmetro Selecionar meio .	Exibe o fator de compressibilidade atualmente calculado.	0 para 2
Graus de superaquecimento	Em parâmetro Selecionar meio , o opção Vapor é selecionado.	Exibe o grau de superaquecimento atualmente calculado.	0 para 500 K

11.4.2 Submenu "Totalizador"

O submenu **Totalizador** contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para cada totalizador.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Valor medido → Totalizador

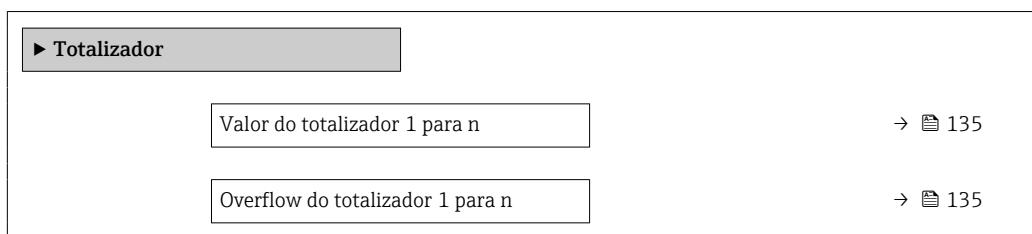

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Valor do totalizador 1 para n	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (\rightarrow 107) do submenu Totalizador 1 para n : <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * 	Exibe o valor atual do contador do totalizador.	Número do ponto flutuante assinado
Overflow do totalizador 1 para n	Uma das opções a seguir está selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (\rightarrow 107) do submenu Totalizador 1 para n : <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * 	Exibe o transbordamento do totalizador atual.	Inteiro com sinal


* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

11.4.3 Valores de Saída

O submenu **Valores de saída** contém todos os parâmetros necessários para exibir os valores medidos da corrente para cada saída.

Navegação

Menu "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Valores de saída

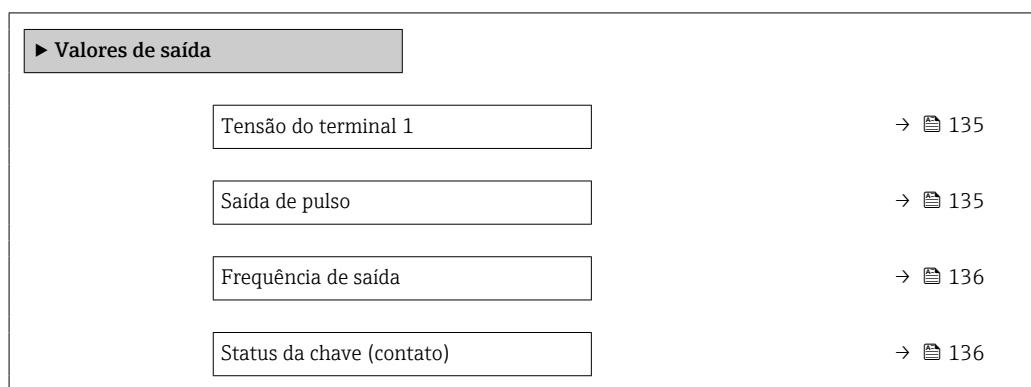

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Tensão do terminal 1	-	Exibe a tensão atual do terminal que é aplicada à saída.	0.0 para 50.0 V
Saída de pulso	A opção Impulso é selecionada no parâmetro parâmetro Modo de operação .	Exibe a frequência de pulso produzida no momento.	Número do ponto flutuante positivo

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Frequência de saída	No parâmetro Modo de operação , a opção Frequência é selecionada.	Exibe o valor de corrente medido para a saída em frequência.	0 para 1250 Hz
Status da chave (contato)	A opção Chave é selecionada em parâmetro Modo de operação .	Exibe o status da saída comutada atual.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abrir ▪ Fechado

11.5 Adaptação do medidor às condições de processo

As seguintes opções estão disponíveis para isso:

- Configurações básicas usando menu **Configuração** (→ 72)
- Configurações avançadas usando submenu **Configuração avançada** (→ 84)


11.6 Reinicialização do totalizador

Os totalizadores são reinicializados em submenu **Operação**:

- Controlar totalizador
- Resetar todos os totalizadores

Navegação

Menu "Operação" → Manuseio do totalizador

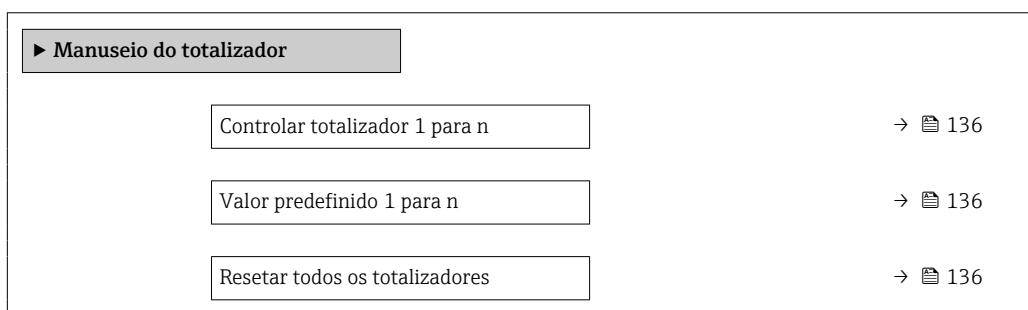

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Controlar totalizador 1 para n	Uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 107) do submenu Totalizador 1 para n .	Controlar valor do totalizador.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Totalizar ▪ Reset + Reter ▪ Predefinir + reter ▪ Reset + totalizar ▪ Predefinir + totalizar ▪ hold 	Totalizar
Valor predefinido 1 para n	Uma variável de processo é selecionada em parâmetro Atribuir variável do processo (→ 107) do submenu Totalizador 1 para n .	Especificar valor inicial para totalizador. <i>Dependência</i> [i] A unidade da variável de processo selecionada é especificada para o totalizador em parâmetro Unidade totalizador (→ 107).	Número do ponto flutuante assinado	Especifico do país: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 m³ ▪ 0 pés³
Resetar todos os totalizadores	-	Reset todos os totalizadores para 0 e iniciar.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancelar ▪ Reset + totalizar 	Cancelar

11.6.1 Escopo de função de parâmetro "Controlar totalizador"

Opções	Descrição
Totalizar	O totalizador é iniciado ou continua operação.
Reset + Reter	O processo de totalização é interrompido e o totalizador é reiniciado com 0.
Predefinir + reter	O processo de totalização é interrompido e o totalizador é definido com seu valor inicial definido em parâmetro Valor predefinido .
Reset + totalizar	O totalizador é reiniciado como 0 e o processo de totalização é reiniciado.
Predefinir + totalizar	O totalizador é ajustado com o valor inicial definido em parâmetro Valor predefinido e o processo de totalização é reiniciado.

11.6.2 Âmbito da parâmetro "Resetar todos os totalizadores"

Opções	Descrição
Cancelar	Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.
Reset + totalizar	Reinicia todos os totalizadores com 0 e reinicia o processo de totalização. Exclui todos os valores de vazão totalizados anteriormente.


11.7 Exibição do registro de dados

O pacote de aplicativo **HistoROM estendido** deve ser habilitado no equipamento (opção de pedido) para que submenu **Registro de dados** apareça. Ele contém todos os parâmetros do histórico de valor medido.

i O registro de dados também está disponível em:
Ferramenta de Gerenciamento de ativos de fábrica FieldCare → 62.

Faixa de função

- Podem ser armazenados um total de 1000 valores medidos
- 4 canais de registro
- Intervalo de registro ajustável para o registro de dados
- Exibe a tendência de valor medido para cada canal de registro na forma de um gráfico

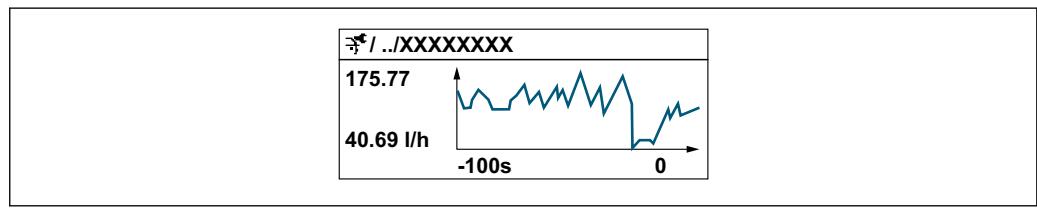

A0034352

- eixo x: dependendo do número de canais selecionados, exibe de 250 a 1000 valores medidos de uma variável do processo.
- eixo y: exibe a amplitude aproximada do valor medido e adapta isso de modo constante à medição em andamento.

i Se a duração do intervalo de registro ou a atribuição das variáveis de processo para os canais for alterada, o conteúdo dos registros de dados é excluído.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Registro de dados

► Registro de dados	
Atribuir canal 1	→ 139
Atribuir canal 2	→ 139
Atribuir canal 3	→ 139
Atribuir canal 4	→ 139
Intervalo de registr	→ 140
Limpar dados do registro	→ 140
► Exibir canal 1	
► Exibir canal 2	
► Exibir canal 3	
► Exibir canal 4	

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Atribuir canal 1	O pacote de aplicativo HistoROM estendido está disponível.	Atribua a variável de processo ao canal de registro.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desl. ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Velocidade de vazão ■ Temperatura ■ Pressão Vapor saturado calculada * ■ Qualidade de Vapor * ■ Total de Caudal Mássico * ■ Caudal massico condensado * ■ Fluxo de energia * ■ Diferença Caudal calor * ■ Número de Reynolds * ■ Densidade * ■ Pressão * ■ Volume específico ■ Frequencia Vortex ■ Temperatura da eletrônica ■ Densidade de referência 	Desl.
Atribuir canal 2	O pacote de aplicativo HistoROM estendido está disponível. [i] As opções de software habilitadas no momento são exibidas em parâmetro Opção de SW overview ativo .	Atribua a variável de processo ao canal de registro.	Lista de opções, consulte parâmetro Atribuir canal 1 (→ 139)	Desl.
Atribuir canal 3	O pacote de aplicativo HistoROM estendido está disponível. [i] As opções de software habilitadas no momento são exibidas em parâmetro Opção de SW overview ativo .	Atribua a variável de processo ao canal de registro.	Lista de opções, consulte parâmetro Atribuir canal 1 (→ 139)	Desl.
Atribuir canal 4	O pacote de aplicativo HistoROM estendido está disponível. [i] As opções de software habilitadas no momento são exibidas em parâmetro Opção de SW overview ativo .	Atribua a variável de processo ao canal de registro.	Lista de opções, consulte parâmetro Atribuir canal 1 (→ 139)	Desl.

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Seleção / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Intervalo de registr	O pacote de aplicativo HistoROM estendido está disponível.	Defina o intervalo de registro para o registro de dados. Este valor define o intervalo de tempo entre os pontos de dados individuais na memória.	1.0 para 3 600.0 s	1.0 s
Limpar dados do registro	O pacote de aplicativo HistoROM estendido está disponível.	Apagar todos os dados do registro.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cancelar ■ Limpar dados 	Cancelar

* Visibilidade depende das opções ou configurações do equipamento.

12 Diagnóstico e solução de problemas

12.1 Localização geral de falhas

Para o display local

Erro	Possíveis causas	Solução
Display local escuro e sem sinais de saída	A fonte de alimentação não corresponde ao valor indicado na etiqueta de identificação.	Aplique a fonte de alimentação correta → 37 .
Display local escuro e sem sinais de saída	A polaridade da fonte de alimentação está errada.	Corrija a polaridade.
Display local escuro e sem sinais de saída	Sem contato entre os cabos de conexão e os terminais.	Verifique a conexão dos cabos e corrija, se necessário.
Display local escuro e sem sinais de saída	Os terminais não estão conectados corretamente ao módulo de componentes eletrônicos I/O.	Verifique os terminais.
Display local escuro e sem sinais de saída	O módulo dos componentes eletrônicos I/O está com falha.	Solicite a peça de reposição → 193 .
Display local escuro e sinais de saída em corrente de falha	Curto-circuito do sensor, curto-circuito do módulo eletrônico	1. Contate a manutenção.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O display está ajustado para muito brilhante ou muito escuro.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuste o display para mais brilhante, pressionando simultaneamente + . ▪ Ajuste o display para mais escuro, pressionando simultaneamente + .
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O cabo do módulo do display não está conectado corretamente.	Insira o conector corretamente ao módulo principal dos componentes eletrônicos e ao módulo do display.
O display local está escuro, mas a saída do sinal está dentro da faixa válida	O módulo do display está com falha.	Solicite a peça de reposição → 193 .
A luz de fundo do display local é vermelha	Um evento diagnóstico com comportamento diagnóstico de "Alarme" ocorreu.	Tome as medidas corretivas → 152
O texto no display local aparece em idioma estrangeiro e não pode ser entendido.	Um idioma de operação incorreto está configurado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione + para 2 s ("posição inicial"). 2. Pressione . 3. Ajuste o idioma desejado em parâmetro Display language (→ 111).
Mensagem no display local: "Erro de Comunicação" "Verifique os Componentes Eletrônicos"	A comunicação entre o módulo do display e os componentes eletrônicos foi interrompida.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifique o cabo e o conector entre o módulo principal de componentes eletrônicos e o módulo do display. ▪ Solicite a peça de reposição → 193.

Para os sinais de saída

Erro	Possíveis causas	Solução
Saída do sinal fora da faixa válida	O módulo principal dos componentes eletrônicos está com falha.	Solicite a peça de reposição → 193.
O equipamento exibe o valor correto no display local, mas a saída do sinal é incorreta, apesar de estar na faixa válida.	Erro de configuração	Verifique e corrija a configuração do parâmetro.
O equipamento faz medições incorretamente.	Erro de configuração ou o equipamento está sendo operado fora de sua aplicação.	1. Verifique e corrija a configuração do parâmetro. 2. Observe os valores limite especificados em "Dados Técnicos".


Para acesso

Erro	Possíveis causas	Solução
Sem acesso de escrita aos parâmetros	Proteção contra gravação de hardware habilitada	Ajuste a seletora de proteção contra gravação no módulo principal dos componentes eletrônicos para OFF posição → 117.
Sem acesso de escrita aos parâmetros	O papel atual do usuário possui autorização de acesso limitada	→ 591. Verifique o papel do usuário. 2. Insira o código de acesso correto específico do cliente → 59.
Sem conexão através da interface de operação	Configuração incorreta da interface USB no PC ou driver não instalado corretamente.	Observe a documentação para Commubox.  FXA291: Documento "Informações Técnicas" TI00405C

12.2 Informações de diagnóstico no display local

12.2.1 Mensagem de diagnóstico

Os erros detectados pelo sistema de auto-monitoramento do medidor são exibidos como mensagem de diagnóstico, alternando com o display de operação.

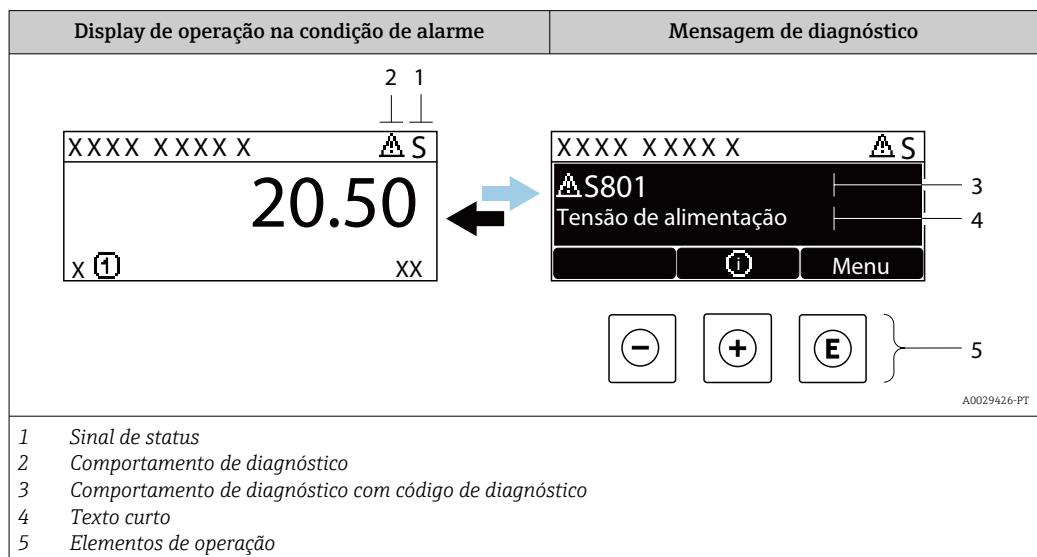

Caso dois ou mais eventos de diagnósticos estejam pendentes simultaneamente, somente a mensagem do evento de diagnóstico com o nível de prioridade máxima será mostrada.

- i** Outros eventos de diagnósticos ocorridos podem ser exibidos em menu **Diagnóstico**:
- Através do parâmetro → [185](#)
 - Através de submenus → [186](#)

Sinais de status

Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).

- i** Os sinais de status são classificados de acordo com VDI/VDE 2650 e NAMUR Recomendação NE 107:F = falha, C = verificação da função, S = fora de especificação, M = manutenção necessária


Símbolo	Significado
F	Falha Ocorreu uma falha no equipamento. O valor medido não é mais válido.
C	Verificação da função O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
S	Fora da especificação O equipamento é operado: Fora dos seus limites de especificação técnica (por exemplo, fora da faixa de temperatura do processo)
M	Manutenção requerida A manutenção é necessária. O valor medido permanece válido.

Comportamento de diagnóstico

Símbolo	Significado
	Alarme <ul style="list-style-type: none"> ■ A medição é interrompida. ■ As saídas do sinal e totalizadores assumem a condição de alarme definida. ■ É gerada uma mensagem de diagnóstico. ■ Para o display local com controle touchscreen: a iluminação de fundo muda para vermelho.
	Aviso Medição é retomada. As saídas de sinal e os totalizadores não são afetados. É gerada uma mensagem de diagnóstico.

Informações de diagnóstico


O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro. Além disso, o símbolo correspondente para o comportamento de diagnóstico é exibido na frente das informações de diagnóstico no display local.

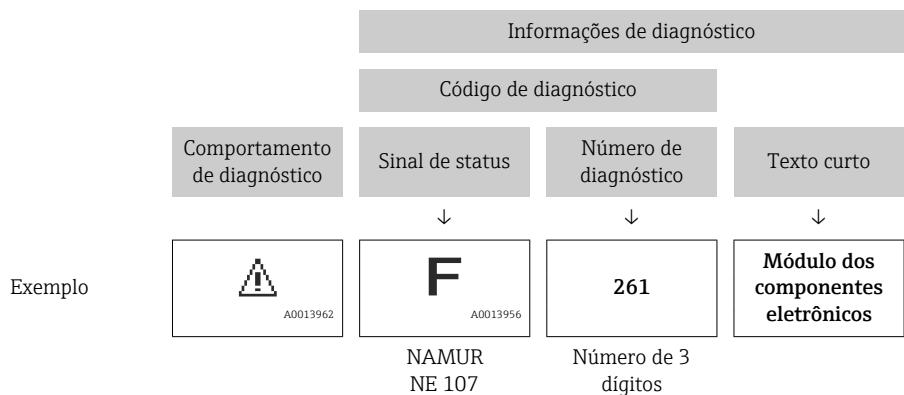

Elementos de operação

Tecla	Significado
	Tecla mais <i>Em um menu, submenu</i> Abre a mensagem sobre informações de correção.
	Tecla Enter <i>Em um menu, submenu</i> Abre o menu de operações.

12.2.2 Recorrendo a medidas corretivas

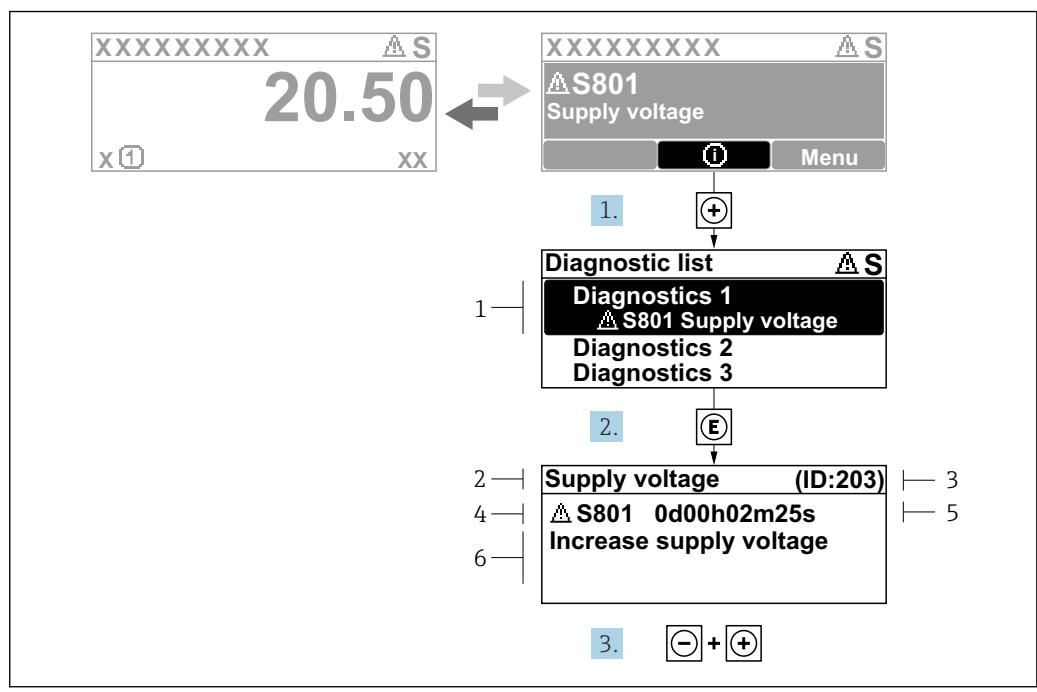

21 Mensagem para medidas corretivas

- 1 Informações de diagnóstico
- 2 Texto curto
- 3 Identificação do Serviço
- 4 Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico
- 5 Horário da ocorrência da operação
- 6 Medidas corretivas

1. O usuário está na mensagem de diagnóstico.
Pressione **+** (símbolo ①).
↳ A submenu **Lista de diagnóstico** é aberta.
2. Selecione o evento de diagnóstico com **+** ou **-** e pressione **E**.
↳ Abre a mensagem sobre medidas corretivas.
3. Pressione **-** + **+** simultaneamente.
↳ A mensagem sobre medidas corretivas fecha.


O usuário está em menu **Diagnóstico** em uma entrada para um evento de diagnóstico, ex.: em submenu **Lista de diagnóstico** ou parâmetro **Diagnóstico anterior**.

1. Pressione **E**.
↳ Abre a mensagem para medidas corretivas para o evento de diagnóstico selecionado.
2. Pressione **-** + **+** simultaneamente.
↳ A mensagem para medidas corretivas fecha.

12.3 Informações de diagnóstico em FieldCare ou DeviceCare

12.3.1 Opções de diagnóstico

Qualquer falha detectada pelo medidor é exibida na página inicial da ferramenta de operação, uma vez que a conexão seja estabelecida.

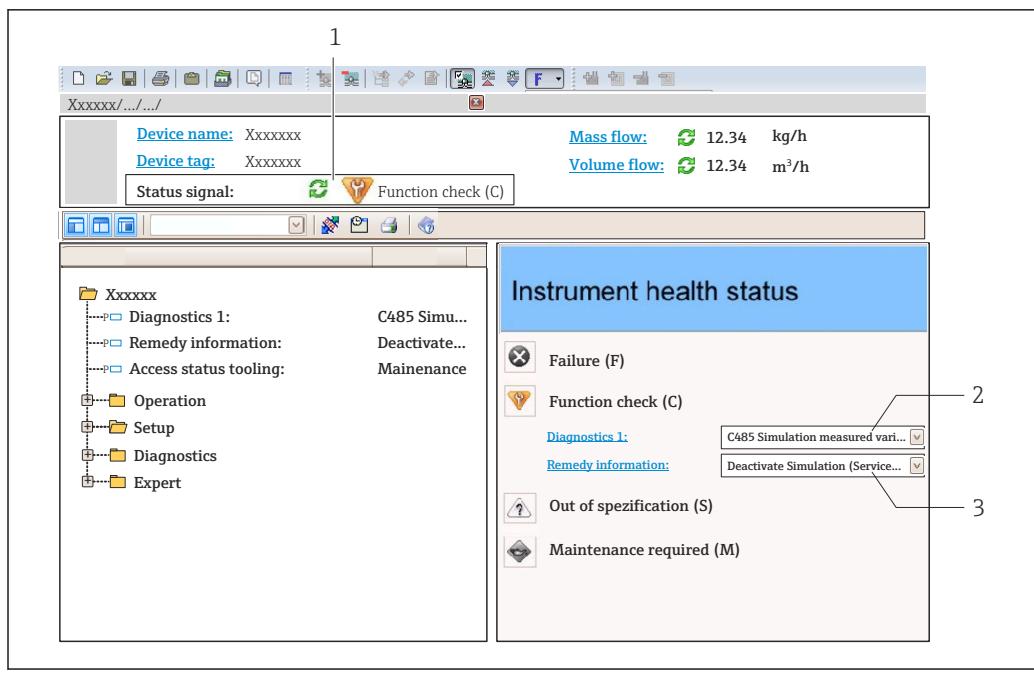

A0021799-PT

- 1 Área de status com sinal de status → [143](#)
- 2 Informações de diagnóstico → [144](#)
- 3 Informação de soluções com Serviço ID

i Além disso, os eventos de diagnóstico que ocorreram podem ser exibidos em menu **Diagnóstico:**

- Através do parâmetro → [185](#)
- Através do submenu → [186](#)

Sinais de status


Os sinais de status fornecem informações sobre o estado e confiabilidade do equipamento, categorizando o motivo da informação de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Ícone	Significado
	Falha Ocorreu uma falha no equipamento. O valor medido não é mais válido.
	Verificação da função O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
	Fora da especificação O equipamento é operado: Fora dos seus limites de especificação técnica (por exemplo, fora da faixa de temperatura do processo)
	Manutenção requerida A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

i Os sinais de status são categorizados de acordo com VDI/VDE 2650 e Recomendação NAMUR NE 107.

Informações de diagnóstico

O erro pode ser identificado usando as informações de diagnósticos. O texto curto auxilia oferecendo informações sobre o erro. Além disso, o símbolo correspondente para o comportamento de diagnóstico é exibido na frente das informações de diagnóstico no display local.

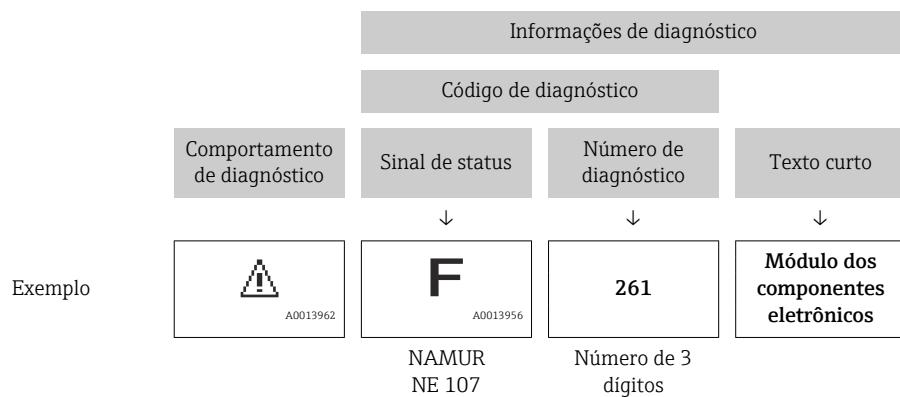

12.3.2 Acessar informações de correção

A informação de correção fornecida é fornecida para cada evento de diagnósticos para garantir que problemas podem ser rapidamente corrigidos:

- Na página inicial
A informação de correção é exibida em um campo separado abaixo da informação de diagnósticos.
- No menu **Diagnóstico**
A informação de correção pode ser acessada na área de trabalho na interface de usuário.

O usuário está em menu **Diagnóstico**.


1. Acesse o parâmetro desejado.
2. À direita na área de trabalho, posicione o mouse sobre o parâmetro.
↳ Aparece uma dica com informação de correção para o evento de diagnósticos.

12.4 Adaptação das informações de diagnóstico

12.4.1 Adaptação do comportamento de diagnóstico

Para cada informação de diagnóstico é atribuído de fábrica um comportamento de diagnóstico específico. O usuário pode alterar esta atribuição para informações de diagnóstico específicas em submenu **Nível de evento**.

Especialista → Sistema → Manuseio de diagnóstico → Nível de evento

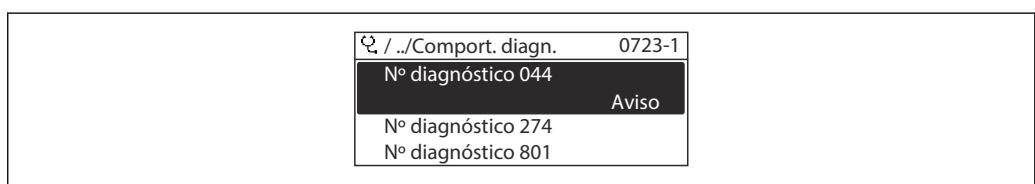

22 Uso do display local como exemplo

É possível atribuir as seguintes opções ao número de diagnóstico como o comportamento de diagnóstico:

Opções	Descrição
Alarme	O equipamento para a medição. As saídas do sinal e totalizadores assumem a condição de alarme definida. É gerada uma mensagem de diagnóstico. Para o display local com controle touchscreen: a iluminação de fundo muda para vermelho.
Advertência	O equipamento continua a medir. As saídas de sinal e os totalizadores não são afetados. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Apenas entrada no livro de registro	O equipamento continua a medir. A mensagem de diagnóstico é exibida somente em submenu Livro de registro de eventos (submenu Lista de eventos) e não é exibida como uma alternância com o display de operação.
Desl.	O evento de diagnóstico é ignorado e nenhuma mensagem de diagnóstico é gerada ou inserida.

12.4.2 Adaptação do sinal de status

Para cada informação de diagnóstico é atribuído de fábrica um sinal de status específico . O usuário pode alterar esta atribuição para informações de diagnóstico específicas em submenu **Categoria Evento diagnóstico**.

Especialista → Comunicação → Categoria Evento diagnóstico

Sinais de status disponíveis

Configurações de acordo com a Especificação FOUNDATION Fieldbus (FF912), conforme NAMUR NE107.

Símbolo	Significado
F A0013956	Falha Existe um erro de equipamento. O valor medido não é mais válido.
C A0013959	Verificação da função O equipamento está em modo de serviço (por exemplo, durante uma simulação).
S A0013958	Fora da especificação O equipamento está sendo operado: <ul style="list-style-type: none">▪ Fora dos seus limites de especificação técnica (por exemplo, fora da faixa de temperatura do processo)▪ Fora da configuração realizada pelo usuário (por ex.: vazão máxima no parâmetro valor 20 mA)
M A0013957	Manutenção requerida A manutenção é necessária. O valor medido ainda é válido.

Habilitar a configuração de informação de diagnóstico de acordo com a FF912

Por motivos de compatibilidade, a configuração de informação de diagnóstico conforme a Especificação FOUNDATION Fieldbus FF912 não está disponível quando o equipamento é entregue direto da fábrica.

Habilitar a configuração de informação de diagnóstico de acordo com a Especificação FOUNDATION Fieldbus FF912

1. Abra o Resource block.
2. Em parâmetro **Feature Selection**, selecione opção **Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support**.
 - ↳ A informação de diagnóstico pode ser configurada de acordo com a Especificação FOUNDATION Fieldbus FF912.

Agrupamento das informações de diagnóstico

Informações de diagnóstico são especificadas a diferentes grupos. Os grupos diferem dependendo do peso (gravidade) do caso diagnosticado:

- Maior peso
- Alto peso
- Baixo peso

Atribuição das informações de diagnóstico (ajuste de fábrica)

A atribuição das informações de diagnóstico é indicada nas seguintes tabelas.

As faixas individuais de informação de diagnóstico podem ser especificadas a outro sinal de status → 150.

Algumas informações de diagnóstico podem ser especificadas individualmente, independente de sua faixa → 151.

Visão geral e descrição de todas as informações de diagnóstico → 152

Peso	Sinal de status (ajuste de fábrica)	Alocação	Faixa de informações de diagnóstico
Maior	Falha (F)	Sensor	F000 a 199
		Componentes eletrônicos	F200 a 399
		Configuração	F400 a 700
		Processo	F800 a 999

Peso	Sinal de status (ajuste de fábrica)	Alocação	Faixa de informações de diagnóstico
Alto	Verificação da função (C)	Sensor	C000 a 199
		Componentes eletrônicos	C200 a 399
		Configuração	C400 a 700
		Processo	C800 a 999

Peso	Sinal de status (ajuste de fábrica)	Alocação	Faixa de informações de diagnóstico
Baixo	Fora de especificação (S)	Sensor	S000 a 199
		Componentes eletrônicos	S200 a 399
		Configuração	S400 a 700
		Processo	S800 a 999

Peso	Sinal de status (ajuste de fábrica)	Alocação	Faixa de informações de diagnóstico
Baixo	Manutenção necessária (M)	Sensor	M000 a 199
		Componentes eletrônicos	M200 a 399
		Configuração	M400 a 700
		Processo	M800 a 999

Mudando a atribuição das informações de diagnóstico

As faixas individuais de informação de diagnóstico podem ser especificadas a outro sinal de status. Isso é feito alterando o bit no parâmetro associado. A alteração do bit sempre se aplica para toda a faixa de informações de diagnóstico.

i Algumas informações de diagnóstico podem ser especificadas individualmente, independente de sua faixa → [151](#)

Cada sinal de status tem um parâmetro no Resource Block (Bloqueio de Recursos), no qual é possível definir o caso diagnosticado para o qual o sinal de status está sendo transmitido:

- Falha (F): parâmetro **FD_FAIL_MAP**
- Verificação da função (C): parâmetro **FD_CHECK_MAP**
- Sem especificações (S): parâmetro **FD_OFFSPEC_MAP**
- Necessária manutenção (M): parâmetro **FD_MAINT_MAP**

Estrutura e atribuição dos parâmetros para os sinais de status (ajuste de fábrica)

Peso	Alocação	Bit	FD_FAIL_MAP	FD_CHECK_MAP	FD_OFFSPEC_MAP	FD_MAINT_MAP
Maior	Sensor	31	1	0	0	0
	Componentes eletrônicos	30	1	0	0	0
	Configuração	29	1	0	0	0
	Processo	28	1	0	0	0
Alto	Sensor	27	0	1	0	0
	Componentes eletrônicos	26	0	1	0	0
	Configuração	25	0	1	0	0
	Processo	24	0	1	0	0
Baixo	Sensor	23	0	0	1	0
	Componentes eletrônicos	22	0	0	1	0
	Configuração	21	0	0	1	0
	Processo	20	0	0	1	0
Baixo	Sensor	19	0	0	0	1
	Componentes eletrônicos	18	0	0	0	1
	Configuração	17	0	0	0	1
	Processo	16	0	0	0	1
Faixa configurável → 151		15 a 1	0	0	0	0
Reservado (Fieldbus Foundation)		0	0	0	0	0

Mudando o sinal de status para uma faixa de informações de diagnóstico

Exemplo: o sinal de status para a informação de diagnóstico para componentes eletrônicos com o "Maior" peso deve ser alterado de falha (F) para verificação da função (C).

1. Ajuste o Resource Block (Bloqueio de Recursos) para o modo de bloqueio **OOS**.
2. Abra o parâmetro **FD_FAIL_MAP** no Resource Block.
3. Mude **Bit 30** para **0** no parâmetro.
4. Abra o parâmetro **FD_CHECK_MAP** no Resource Block.

5. Mude **Bit 26** para **1** no parâmetro.
 - ↳ Se um evento de diagnóstico ocorre para componentes eletrônicos com o "Maior peso", a informação de diagnóstico para este efeito é exibida com o sinal de status verificação de função (C).
6. Ajuste o Resource Block (Bloqueio de Recursos) para o modo de bloqueio **AUTO**.

AVISO

Nenhum status de sinal é especificado para uma área de informação de diagnóstico.

Se um evento de diagnóstico ocorrer nessa área, nenhum sinal será transmitido para o sistema de controle.

- Se você está alterando os parâmetros, assegure-se de que um sinal de status está especificado para todas as áreas.

-  Se o FieldCare é utilizado, o status de sinal é habilitado e desabilitado usando a caixa de seleção do parâmetro específico.

Atribuindo informações de diagnóstico individualmente para um status de sinal

Algumas informações de diagnóstico podem ser especificadas individualmente para um status de sinal, independente de sua faixa original.

Atribuindo informações de diagnóstico individualmente para um status de sinal através do FieldCare.

1. Na janela de navegação do FieldCare : **Especialista** → **Comunicação** → **Diagnóstico de campo** → **Detecção de alarme habilitada**
2. Selecione as informações de diagnóstico desejadas em um dos campos **Bits de área configurável 1** a **Bits de área configurável 15**.
3. Aperte Enter para confirmar.
4. Quando estiver selecionando o sinal de status desejado (por exemplo, Offspec Map), também selecione o **Bit de área configurável 1** a **Bit de área configurável 15** que foi especificado anteriormente à informação de diagnóstico (passo 2).
5. Aperte Enter para confirmar.
 - ↳ O evento de diagnóstico da informação de diagnóstico selecionada é registrado.
6. Na janela de navegação do FieldCare : **Especialista** → **Comunicação** → **Diagnóstico de campo** → **Transmissão de alarme habilitada**
7. Selecione as informações de diagnóstico desejadas em um dos campos **Bits de área configurável 1** a **Bits de área configurável 15**.
8. Aperte Enter para confirmar.
9. Quando estiver selecionando o sinal de status desejado (por exemplo, Offspec Map), também selecione o **Bit de área configurável 1** a **Bit de área configurável 15** que foi especificado anteriormente à informação de diagnóstico (passo 7).
10. Aperte Enter para confirmar.
 - ↳ A informação de diagnóstico selecionada é transmitida através do barramento quando um evento de diagnóstico para este efeito ocorre.

-  Uma mudança no status de sinal não afeta informações de diagnóstico já existentes. O novo status de sinal somente é especificado se este erro ocorrer novamente após a mudança de status de sinal.

Transmitindo as informações de diagnóstico através do barramento

Priorizando informações de diagnóstico para transmissão através do barramento

Informações de diagnóstico somente são transmitidas através do barramento se sua prioridade estiver entre 2 e 15. Eventos de prioridade 1 são exibidos mas não são

transmitidos através do barramento. Informações de diagnóstico com prioridade 0 (ajuste de fábrica) são ignoradas.

É possível mudar a prioridade individualmente para diferentes sinais de status. Os parâmetros do Resource Block a seguir são usados para este propósito:

- FD_FAIL_PRI
- FD_CHECK_PRI
- FD_OFSPEC_PRI
- FD_MAINT_PRI

Omitindo certas informações de diagnóstico

É possível omitir certos eventos durante a transmissão através do barramento usando uma máscara. Enquanto estes eventos estiverem sendo exibidos, eles não serão transmitidos através do barramento. Esta máscara está em FieldCare : **Especialista → Comunicação → Diagnóstico de campo → Transmissão de alarme habilitada**. A máscara é uma máscara de seleção negativa, isto é, se um campo é selecionado a informação de diagnóstico associada não é transmitida através do barramento.

12.5 Visão geral das informações de diagnóstico

i A quantidade de informações de diagnóstico e o número de variáveis medidas afetadas aumenta se o medidor tiver um ou mais pacotes de aplicativo.

i Em caso algumas informações de diagnóstico, o sinal de status e o comportamento de diagnóstico podem ser alterados. Altere as informações de diagnóstico →  147

12.5.1 Diagnóstico do sensor

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas
	Texto resumido			
004	Sensor com defeito			
	Status da variável de medição			
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Sensor failure		
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F		
	Comportamento do diagnóstico	Alarm		

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
022	Sensor de Temperatura com Defeito		1. Verificar conetores de ligacao 2. Trocar pre-ampificadora 3. Trocar sensor DSC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Alarm				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
046	Limites Sensor excedidos		1. Verificar conetores de ligacao 2. Trocar pre-ampificadora 3. Trocar sensor DSC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
062	Ligaçao ao sensor Em Defeito		1. Verificar conetores de ligacao 2. Trocar pre-ampificadora 3. Trocar sensor DSC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Sensor failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
082	Armazenamento de dados		1. Checar o modulo de conexões 2. Contactar suporte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Sensor failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
083	Conteúdo da memória		1. Reiniciar aparelho 2. Restaurar dados do S-Dat 3. Alterar sensor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Sensor failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
114	Fuga Sensor		Mudar sensor DSC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Sensor failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
122	Sensor de Temperatura com Defeito		1. Verificar conetores de ligacao 2. Trocar pre-ampificadora 3. Trocar sensor DSC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	M				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

- 1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.
 2) O sinal de status pode ser alterado.
 3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
170	Conexão da célula de pressão danificada		1. Check plug connections 2. Replace pressure cell	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Sensor failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

- 1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
171	Temperatura Ambiente demasiado Baixa		Aumentar temperatura ambiente	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

- 1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
172	Temperatura ambiente demasiado Alta		Reducir temperatura ambiente	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
173	Range do Sensor excedido		1. Verificar cond. processo 2. Aumentar pressão do sistema	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fluxo de energia ▪ Diferença Caudal calor ▪ Opção Corte de vazão baixa ▪ Vazão mássica ▪ Caudal massico condensado ▪ Total de Caudal Mássico ▪ Opção Status da saída chaveada ▪ Número de Reynolds ▪ Vazão volumétrica corrigida ▪ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Uncertain				
	Quality substatus	Sensor conversion not accurate				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
174	Eletr da célula de pressão danificada		Replace pressure cell	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fluxo de energia ▪ Diferença Caudal calor ▪ Opção Corte de vazão baixa ▪ Vazão mássica ▪ Caudal massico condensado ▪ Total de Caudal Mássico ▪ Opção Status da saída chaveada ▪ Número de Reynolds ▪ Vazão volumétrica corrigida ▪ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Sensor failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
175	Celula de pressão desativada		Enable pressure cell	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	M				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

12.5.2 Diagnóstico dos componentes eletrônicos

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
242	Software incompatível		1. Verificar software 2. Atualizar ou alterar módulo eletrônico principal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
252	Módulos incompatíveis		1. Checar se o módulo eletrônico correto está plugado 2. Substituir módulo eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
261	Módulos eletrônicos		1. Reiniciar aparelho 2. Verificar módulos eletrônicos 3. Alterar módulo E/S ou eletrônico principal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
262	Módulo de conexão		1. Verificar conexões do módulo 2. Alterar módulos eletrônicos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
270	Falha eletrônica principal		Alterar módulo eletrônico principal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
271	Falha eletrônica principal		1. Reiniciar equip. 2. Alterar módulo eletrônico principal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
272	Falha eletrônica principal		1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
272	Configurações ECC com falhas		1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
273	Falha eletrônica principal		1. Operação de emergência via display 2. Alterar eletrônicas principais	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
275	Modulo I/O defeituoso		Alterar módulo de E/S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
276	Modulo I/O falha		1. Reiniciar aparelho 2. Alterar módulo de E/S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
276	Modulo I/O em falha		1. Reiniciar aparelho 2. Alterar módulo de E/S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
277	Electronica em Defeito		1. Mudar Pre-amplificador 2. Mudar electronica principal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
282	Armazenamento de dados		1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
283	Conteúdo da memória		1. Transferir dados ou resetar o aparelho 2. Contatar suporte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
302	Verificação do equipamento ativa		Verificação do equipamento ativa, favor aguarde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
311	Falha da eletrônica		Manutenção necessária! 1. Não executar reset 2. Contatar manutenção	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	M				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
350	Pré-Amplificadora em Defeito		Mudar Pré-Amplificador	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Alarm				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
351	Pré-Amplificadora em Defeito		Mudar Pré-Amplificador	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
370	Pré-Amplificadora em Defeito		1. Verificar conetores 2. Verificar cabo de ligação remota 3. Verificar pre-amplificadora e carta principal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Device failure				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
371	Sensor de Temperatura com Defeito		1. Verificar conetores de ligacao 2. Trocar pre-amplicadora 3. Trocar sensor DSC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	M				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

12.5.3 Diagnóstico de configuração

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
410	Transferência de dados		1. Verificar conexão 2. Tentar transferência de dados	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Configuration error				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
412	Processamento de download		Download ativo, favor aguarde	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
437	Configuração incompatível		1. Reiniciar aparelho 2. Contactar suporte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Configuration error				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
438	Conjunto de dados		1. Verificar arquivo de conjunto de dados 2. Verificar configuração do equipamento 3. Up- e download uma nova configuração	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Uncertain				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	M				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
442	Saída de frequência		1. Verificar o processo 2. Verificar as configurações de saída de frequência	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ²⁾	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

2) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
443	Saída de pulso		1. Verificar o processo 2. Verificar as configurações de saída de pulso	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ²⁾	Warning				

- 1) O sinal de status pode ser alterado.
 2) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
453	Override de vazão		Desativar override de vazão	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

- 1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
484	Modo de simulação de falha		Desativar simulação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Configuration error				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

- 1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
485	Simulação de variável de medição		Desativar simulação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
492	Simulação da frequência de saída		Desativar simulação da saída de frequência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
493	Simulação saída de pulso		Desativar simulação da saída de pulso	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
494	Simulação saída chave		Desativar simulação da saída de chave	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
495	Evento do diagnóstico de simulação		Desativar simulação	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
497	Bloqueio de saída simulação		Desativar simulação	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	C				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
538	Configuração da unidade incorrecta		Verificar valor (pressão e temperatura)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
539	Configuração da unidade incorrecta		1. verificar valor de (pressão e temperatura) 2. Verificar valores desejado do meio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Configuration error				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
540	Configuração da unidade incorrecta		Verifique os valores de entrada usando documento Instruções de Operação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
570	Diferencial de Temperatura invertido		Verificar configuração e condições de montagem (Verificar direcção de instalação)	Diferença Caudal calor		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Configuration error				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

12.5.4 Diagnóstico do processo

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
801	Tensão de alimentação muito baixa		Tensão de alimentação muito baixa, aumentar tensão de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Alarm				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
828	Temperatura Ambiente demasiado Baixa		Aumentar a temperatura ambiente de pré-amplificador	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
829	Temperatura ambiente demasiado Alta		Reducir a temperatura ambiente de pré-amplificador	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
832	Temperatura da eletrônica muito alta		Reducir temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
833	Temperatura da eletrônica muito baixa		Aumentar temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
834	Temperatura de processo Alta		Reducir temperatura do processo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
835	Temperatura de processo Baixa		Aumentar temperatura do processo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
841	Velocidade do Caudal Alta		Reducir velocidade do Caudal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
842	Processo limite		Corte de vazão baixa ativo! 1. Verificar configuração de corte de vazão baixa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
844	Range do Sensor excedido		Reducir velocidade do Caudal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
870	Imprecisão de medição aumentada		1. Verificar Processo 2. Aumentar caudal volumetrico	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
871	Limite de saturação de vapor perto		Verificar condicoes processo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
872	Vapor humido detectado		1. Verificar Processo 2. Verificar instalacao	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
873	umidade detectada		Verificar Processo (agua na tubagem)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
874	X% especificação inválida		1. Verificar pressão e temperatura 2. Verificar velocidade do caudal 3. Verificar flutuação do caudal	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Uncertain				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
882	Entrada de sinal		1. Verificar configuração de entrada 2. Verificar dispositivo externo ou condições de processo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Temperatura ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Bad				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	F				
	Comportamento do diagnóstico	Alarm				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
945	Range do Sensor excedido		Verificar imediatamente condicoes de processo (pressão e temperatura)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Warning				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
946	Vibração Detectada		Verificar instalacao	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Uncertain				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
947	Vibração Excessiva		Verificar instalacao	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição [da fábrica] ¹⁾					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ²⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ³⁾	Alarm				

1) A qualidade pode ser alterada. Isso altera o status geral da variável medida.

2) O sinal de status pode ser alterado.

3) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
948	Qualidade de sinal ruim		<ol style="list-style-type: none"> 1. Check process conditions: wet gas, pulsation 2. Check installation: vibration 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Velocidade de vazão ■ Diferença Caudal calor ■ Opção Corte de vazão baixa ■ Vazão mássica ■ Caudal massico condensado ■ Total de Caudal Mássico ■ Opção Status da saída chaveada ■ Número de Reynolds ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Qualidade de Vapor ■ Vazão volumétrica 		
	Status da variável de medição					
	Quality	Uncertain				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

Nº	Informação sobre diagnóstico		Ação de reparo	Variáveis de medição influenciadas		
	Texto resumido					
972	Grau de superaquecimento excedido		<ol style="list-style-type: none"> 1. Controll process conditions 2. Install pressure transmitter or enter correct fixed pressure value 	-		
	Status da variável de medição					
	Quality	Good				
	Quality substatus	Non specific				
	Sinal de status [da fábrica] ¹⁾	S				
	Comportamento do diagnóstico [da fábrica] ²⁾	Warning				

1) O sinal de status pode ser alterado.

2) O comportamento de diagnóstico pode ser alterado.

12.5.5 Condições de operação para exibição das seguintes informações de diagnóstico



Condições de operação para exibição das seguintes informações de diagnóstico:

- Mensagem de diagnóstico 871 **Límite de saturação de vapor perto**: A temperatura do processo é inferior a 2K a partir da linha de vapor saturada.
- Informações de diagnóstico 872: A qualidade de vapor medida caiu abaixo do valor limite configurado para a qualidade de vapor (valor limite: Especialista → Sistema → Manuseio de diagnóstico → Limites - diagnostico → Limite Qualidade Vapor).
- Informações de diagnóstico 873: a temperatura do processo é $\leq 0^{\circ}\text{C}$.
- Informações de diagnóstico 972: O grau de superaquecimento excede o valor limite configurado (valor limite: Especialista → Sistema → Manuseio de diagnóstico → Limites - diagnostico → Limite de graus de superaquecimento).

12.5.6 Modo de emergência no caso de compensação de temperatura

- ▶ Alteração da medição da temperatura: PT1+PT2 para a opção **PT1**, opção **PT2** ou a opção **Off**.
 - ↳ Se a opção **Off** for selecionada, o medidor calcula usando a pressão de processo fixa.

12.6 Eventos de diagnóstico pendentes

O menu **Diagnóstico** permite ao usuário visualizar o evento de diagnóstico atual e o evento de diagnóstico anterior separadamente.



Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do display local → [145](#)
- Através da ferramenta de operação "FieldCare" → [147](#)
- Através da ferramenta de operação "DeviceCare" → [147](#)



Outros eventos de diagnóstico pendentes podem ser exibidos em submenu **Lista de diagnóstico** → [186](#)

Navegação

Menu "Diagnóstico"

Diagnóstico	
Diagnóstico atual	→ 186
Diagnóstico anterior	→ 186
Tempo de operação desde reinício	→ 186
Tempo de operação	→ 186

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Pré-requisitos	Descrição	Interface do usuário
Diagnóstico atual	Ocorreu um evento de diagnóstico.	Mostra o evento de diagnóstico atual juntamente com a informação de diagnóstico. [i] Caso duas ou mais mensagens ocorram ao mesmo tempo, somente será exibida a mensagem com o nível de prioridade mais alto.	Símbolo para o comportamento de diagnóstico, código de diagnóstico e mensagem curta.
Diagnóstico anterior	Já ocorreram dois eventos de diagnóstico.	Mostra o evento de diagnóstico anterior ao evento atual juntamente com as informações de diagnóstico.	Símbolo para o comportamento de diagnóstico, código de diagnóstico e mensagem curta.
Tempo de operação desde reinício	-	Mostra o período que o medidor esteve em operação desde a última reinicialização.	Dias (d), horas (h), minutos (m) e segundos (s)
Tempo de operação	-	Indica por quanto tempo o aparelho esteve em operação.	Dias (d), horas (h), minutos (m) e segundos (s)

12.7 Mensagens de diagnóstico no Bloco Transdutor de DIAGNÓSTICO


- O parâmetro **Diagnóstico atual (diagnóstico atual)** exibe a mensagem com prioridade máxima.
- Uma lista dos alarmes ativos pode ser visualizada através do parâmetro **Diagnóstico 1 (diagnósticos_1)** a Diagnóstico 5 (**diagnósticos_5**). Se mais de 5 mensagens estiverem pendentes, o display exibe as de prioridade máxima.
- Você pode visualizar o último alarme que não está mais ativo em parâmetro **Diagnóstico anterior (diagnósticos_anteriores)**.

12.8 Lista de diag

É possível exibir até 5 eventos de diagnóstico pendentes no momento em submenu **Lista de diagnóstico** juntamente com as informações de diagnóstico associadas. Se mais de 5 eventos de diagnóstico estiverem pendentes, o display exibe os eventos de prioridade máxima.

Caminho de navegação

Diagnóstico → Lista de diagnóstico

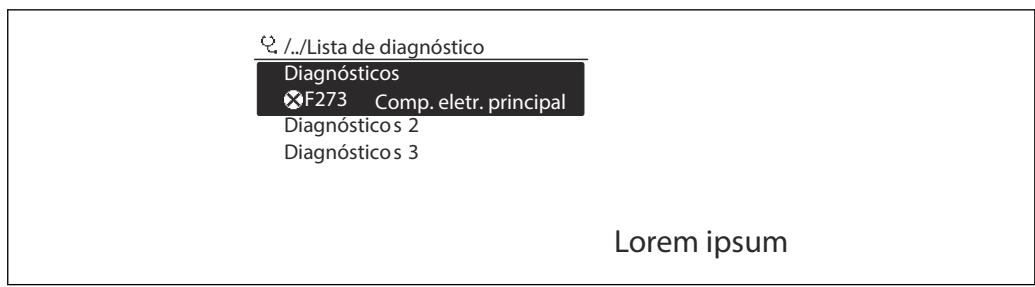

23 Uso do display local como exemplo

Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do display local → 145
- Através da ferramenta de operação "FieldCare" → 147
- Através da ferramenta de operação "DeviceCare" → 147


12.9 Registro de eventos

12.9.1 Leitura do registro de eventos

O submenu **Lista de eventos** fornece uma visão geral cronológica das mensagens de evento que ocorreram.

Caminho de navegação

Menu **Diagnóstico** → submenu **Livro de registro de eventos** → **Lista de eventos**

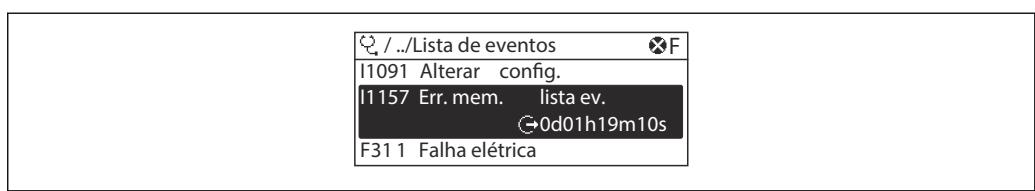

24 Uso do display local como exemplo

- Um máximo de 20 mensagens de evento podem ser exibidas em ordem cronológica.
- Se o pacote de aplicativo **HistoROM estendido** (opção de pedido) estiver habilitado no equipamento, a lista de eventos pode conter até 100 entradas.

O histórico de evento inclui entradas para:

- Eventos de diagnóstico → 152
- Informação de eventos → 188

Além da hora de operação em que ocorreu, cada evento recebe também um símbolo que indica se o evento ocorreu ou foi concluído:

- Evento de diagnóstico
 - ⊖: Ocorrência do evento
 - ⊗: Fim do evento
- Evento de informação
 - ⊖: Ocorrência do evento

Para chamar as medidas para corrigir um evento de diagnóstico:

- Através do display local → 145
- Através da ferramenta de operação "FieldCare" → 147
- Através da ferramenta de operação "DeviceCare" → 147

Para filtragem das mensagens de evento exibidas → 188

12.9.2 Filtragem do registro de evento

Usando parâmetro **Opções de filtro** é possível definir qual categoria de mensagem de evento é exibida no submenu **Lista de eventos**.

Caminho de navegação

Diagnóstico → Livro de registro de eventos → Opções de filtro

Categorias de filtro

- Todos
- Falha (F)
- Verificação da função (C)
- Fora de especificação (S)
- Necessário Manutenção (M)
- Informação (I)

12.9.3 Visão geral dos eventos de informações

Diferente de um evento de diagnóstico, um evento de informação é exibido no registro de eventos somente e não na lista de diagnóstico.

Número da informação	Nome da informação
I1000	----- (Instrumento ok)
I1079	Sensor alterado
I1089	Ligado
I1090	Reset da configuração
I1091	Configuração alterada
I1092	HistoROM backup apagado
I1110	Chave de proteção de escrita alterada
I1137	Eletrônica alterada
I1151	Reset do histórico
I1154	Reset da tensão mín./máx. do terminal
I1155	Reset da temperatura da eletrônica
I1156	Trend do erro de memória
I1157	Lista de eventos de erros na memória
I1185	Backup do display concluído
I1186	Restauração via display concluído
I1187	Configurações baixadas com o display
I1188	Dados do display removidos
I1189	Backup comparado
I1227	Modo de emergência do sensor ativado
I1228	Falha no modo de emergência do sensor
I1256	Display: direito de acesso alterado
I1335	Firmware Alterado
I1397	Fieldbus: direito de acesso alterado
I1398	CDI: direito de acesso alterado
I1444	Verificação do equipamento aprovada
I1445	Verificação do equipamento falhou
I1459	Falha: verificação modulo I/O
I1461	Falha: Verificação do sensor

Número da informação	Nome da informação
I1512	Download iniciado
I1513	Download finalizado
I1514	Upload iniciado
I1515	Upload finalizado
I1552	Falha: Verificação da eletr principal
I1553	Falha: Verificação da pré-amplificadora

12.10 Reinicialização do medidor

Com o uso deParâmetro **Restart** (→ 114) é possível reiniciar toda a configuração ou parte da configuração do equipamento com um estado definido.

12.10.1 Escopo de função da parâmetro "Restart"

Opções	Descrição
Uninitialized	A seleção não tem efeito no equipamento.
Run	A seleção não tem efeito no equipamento.
Resource	A seleção não tem efeito no equipamento.
Defaults	Todos os blocos FOUNDATION Fieldbus são redefinidos para o ajuste de fábrica. Exemplo: Canal de entrada analógica para o opção Uninitialized .
Processor	O equipamento é reiniciado.
Para configurações de entrega	Parâmetros avançados FOUNDATION Fieldbus (blocos FOUNDATION Fieldbus, informação agendada) e parâmetros do aparelho para os quais uma configuração padrão específica do cliente foi solicitada são redefinidos para este valor específico do cliente.

12.10.2 Escopo de função de parâmetro "Reset de Serviços"

Opções	Descrição
Uninitialized	A seleção não tem efeito no equipamento.
Para configurações de entrega	Parâmetros avançados FOUNDATION Fieldbus (blocos FOUNDATION Fieldbus, informação agendada, etiqueta de equipamento e endereço de equipamento) e os parâmetros de equipamento para qual uma configuração padrão específica do cliente foi solicitada, são redefinidos para esse valor específico do cliente.
ENP restart	Os parâmetros da etiqueta de identificação eletrônica são reiniciados. O equipamento é reiniciado.

12.11 Informações do equipamento

O submenu **Informações do equipamento** contém todos os parâmetros que exibem informações diferentes para a identificação do equipamento.

Navegação

Menu "Diagnóstico" → Informações do equipamento

▶ Informações do equipamento
Tag do equipamento
→ 190

Número de série	→ 190
Versão do firmware	→ 190
Código do equipamento	→ 190
Código estendido do equipamento 1	→ 190
Código estendido do equipamento 2	→ 190
Versão ENP	→ 190
Device revision	→ 191
Device type	→ 191

Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Tag do equipamento	Insira o nome do ponto de medição.	Máx. de 32 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)	EH_Prowirl_200xxxxxxxx
Número de série	Exibe o número de série do medidor.	Máx. grupo de caracteres de 11 dígitos que compreende letras e números.	-
Versão do firmware	Mostra a versão de firmware instalada no equipamento.	Linha de caracteres com o seguinte formato: xx.yy.zz	-
Código do equipamento	Mostra o order code do equipamento.  O código do produto pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código do produto".	Linha de caracteres composta de letras, números e certos símbolos de pontuação	-
Código estendido do equipamento 1	Mostra a primeira parte do order code estendido.  O código do produto estendido também pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código de pedido estendido".	Cadeia de caracteres	-
Código estendido do equipamento 2	Mostra a segunda parte do order code estendido.  O código do produto estendido também pode ser encontrado na etiqueta de identificação do sensor e do transmissor no campo "Código de pedido estendido".	Cadeia de caracteres	-
Versão ENP	Mostra a versão da placa de identificação da eletrônica (ENP).	Grupo de caracteres no formato xx.yy.zz	-

Parâmetro	Descrição	Interface do usuário / Entrada do usuário	Ajuste de fábrica
Device type	Mostra o tipo de equipamento com o qual o equipamento de medição está registrado na FOUNDATION Fieldbus.	Prowirl 200	-
Device revision	Manufacturer revision number associated with the resource - used by an interface device to locate the DD file for the resource.	0 para 255	2

12.12 Histórico do firmware

Data de lançamento	Versão do firmware	Código de pedido para "Versão do firmware"	Alterações de firmware	Tipo de documentação	Documentação
01.2018	01.01.zz	Opção 71	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não é necessário reiniciar o equipamento após fazer o download do parâmetro ■ Variáveis de processo adicionais: <ul style="list-style-type: none"> ■ Densidade ■ Vazão mássica condensada ■ Pressão ■ Grau de superaquecimento ■ Volume específico ■ Variáveis de processo interconectáveis com o display local e registro de dados (tendência) ■ Indicador de progresso de verificação (0 para 100 %) ■ Novo pacote de aplicativo de medição do vapor molhado ■ Operação simplificada no vapor ■ Processamento de sinal mais robusto no caso de baixas taxas de vazão em vapor molhado ■ Atualização do pacote FF Atualize o pacote de aplicação da Heartbeat Verification Nova estrutura do menu da vazão baixa Nova estrutura do bloco do transdutor Livro de registros de eventos e exibição de tendência 	Instruções de operação	BA01695D/06/PT/01.18

 É possível piscar o firmware para a versão atual ou para a versão anterior usando a interface de operação.

 Para a compatibilidade da versão do firmware com a versão anterior, os arquivos de descrição de equipamento instalados e as ferramentas de operação, observe as informações referentes ao equipamento no documento "Informações do fabricante".

-  As informações do fabricante estão disponíveis:
- Na área de download no site da Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads
 - Especifique os dados a seguir:
 - Raiz do produto: ex.: 7F2C
A raiz do produto é a primeira parte do código do produto: consulte a etiqueta de identificação no equipamento.
 - Pesquisa de texto: Informações do fabricante
 - Tipo de meio: Documentação – Documentação técnica

13 Manutenção

13.1 Tarefas de manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido.

13.1.1 Limpeza externa

Ao limpar a parte externa do medidor, use sempre agentes de limpeza que não ataquem a superfície do invólucro ou as vedações.

13.1.2 Limpeza interior

AVISO

O uso de equipamentos inadequados ou líquidos de limpeza pode danificar o transdutor.

- Não utilize pigs para limpar o tubo.

13.1.3 Substituição das vedações

Substituição das vedações do sensor

AVISO

Vedações em contato com o fluido devem sempre ser substituídas!

- Somente as vedações do sensor Endress+Hauser devem ser utilizadas: substituição de vedações

Substituição das vedações do invólucro

AVISO

Ao utilizar o equipamento em atmosfera com poeira:

- utilize somente as vedações de invólucro associadas à Endress+Hauser.

1. Substitua as vedações defeituosas somente com vedações originais da Endress +Hauser.
2. As vedações do invólucro devem estar limpas e não danificadas ao serem inseridas nas ranhuras.
3. Seque, limpe ou substitua as vedações, se necessário.

13.2 Medição e teste do equipamento

A Endress+Hauser oferece uma variedade de medição e equipamento de teste, como o Netilion ou os testes de equipamento.

-  Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

Lista de alguns dos equipamentos de medição e teste: →  198

13.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de serviços para manutenção, como recalibração, serviço de manutenção ou testes de equipamento.

-  Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

14 Reparo

14.1 Notas gerais

14.1.1 Conceito de reparo e conversão

O conceito de reparo e conversão da Endress+Hauser considera os seguintes aspectos:

- O medidor tem um projeto modular.
- Peças sobressalentes são agrupadas em kits lógicos com as instruções de instalação associadas.
- Reparos executados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou por clientes devidamente treinados.
- Equipamentos certificados somente podem ser convertidos em outros equipamentos certificados pela assistência técnica da Endress+Hauser ou pela fábrica.

14.1.2 Observações sobre reparo e conversão

Para o reparo e a conversão de um medidor, observe o seguinte:


- ▶ Use somente peças de reposição originais da Endress+Hauser.
- ▶ Faça o reparo de acordo com as instruções de instalação.
- ▶ Observe as normas aplicáveis, as regulamentações federais/nacionais, documentação Ex (XA) e certificados.
- ▶ Documente todos os reparos e conversões e insira os detalhes no Netilion Analytics.

14.2 Peças de reposição

Alguns componentes intercambiáveis do medidor estão listados em uma etiqueta de descrição na tampa do compartimento de conexão.

A etiqueta de descrição da peça de reposição contém as seguintes informações:

- Uma lista das peças de reposição mais importantes para o medidor, incluindo suas informações para pedido.
- A URL para o *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer):
Todas as peças de reposição do medidor, junto com o código de pedido, são listadas aqui e podem ser solicitados. Se estiver disponível, os usuários também podem fazer o download das Instruções de Instalação associadas.

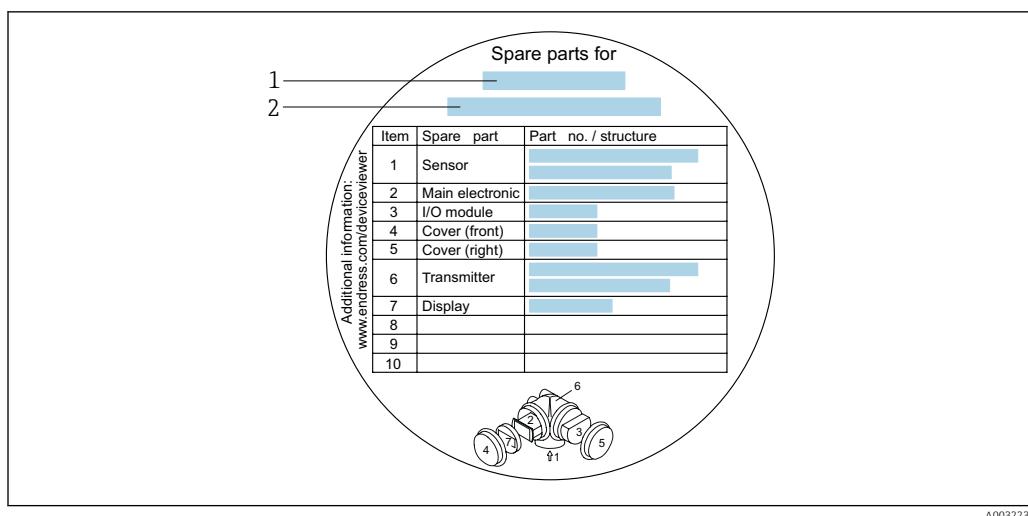

25 Exemplo para "Etiqueta de descrição da peça de reposição " na tampa do compartimento de conexão

- 1 Nome do medidor
2 Número de série do medidor

i Número de série do medidor:

- Está localizado na etiqueta de identificação do equipamento e na etiqueta de descrição de peça sobressalente.
- Pode ser lido através do parâmetro **Número de série** em submenu **Informações do equipamento**.

14.3 Assistência técnica da Endress+Hauser

A Endress+Hauser oferece uma grande abrangência de serviços.

i Sua Central de vendas Endress+Hauser pode fornecer informações detalhadas sobre os serviços.

14.4 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

1. Consulte a página na internet para mais informações:
<https://www.endress.com/support/return-material>
↳ Selecione a região.
2. Se estiver devolvendo o equipamento, embale-o de maneira que ele esteja protegido com confiança contra impactos e influências externas. A embalagem original oferece a melhor proteção.

14.5 Descarte

Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.

14.5.1 Remoção do medidor

1. Desligue o equipamento.

⚠ ATENÇÃO

Perigo às pessoas pelas condições do processo!

- Cuidado com as condições perigosas do processo como a pressão no equipamento de medição, a alta temperatura ou meios agressivos.

2. Faça as etapas de instalação e de conexão das seções "Instalação do medidor" e "Conexão com o medidor" na ordem inversa. Observe as instruções de segurança.

14.5.2 Descarte do medidor

⚠ ATENÇÃO

Risco para humanos e para o meio ambiente devido a fluidos que são perigosos para a saúde.

- Certifique-se de que o medidor e todas as cavidades estão livres de resíduos de fluidos que são danosos à saúde ou ao meio ambiente, como substâncias que permearam por frestas ou difundiram pelo plástico.

Siga as observações seguintes durante o descarte:

- Verifique as regulamentações federais/nacionais.
- Garanta a separação adequada e o reuso dos componentes do equipamento.

15 Acessórios

Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress +Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Acessórios específicos do equipamento

15.1.1 Para o transmissor

Acessórios	Descrição
TransmissorProwirl 200	<p>Transmissor para substituição ou armazenamento. Use o código de pedido para definir as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aprovações ■ Saída, entrada ■ Display/operação ■ Invólucro ■ Software  Instruções de instalação EA01056D  (Número de pedido: 7X2CXX)
Display remoto FHX50	<p>Invólucro FHX50 para acomodar um módulo do display .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Invólucro FHX50 adequado para: <ul style="list-style-type: none"> ■ Módulo de exibição SD02 (botões) ■ Módulo de exibição SD03 (controle touchscreen) ■ Comprimento do cabo de conexão: até no máx. 60 m (196 ft) (comprimentos de cabo disponíveis para pedido 5 m (16 ft) 10 m (32 ft) 20 m (65 ft) 30 m (98 ft)) <p>O instrumento de medição pode ser solicitado com o invólucro FHX50 e um módulo de exibição. As opções a seguir devem ser selecionadas nos códigos de pedido separados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Código de pedido para o instrumento de medição, recurso 030: Opção L ou M "Preparada para o display FHX50" ■ Código do pedido para o invólucro FHX50, recurso 050 (versão do equipamento): Opção A "Preparada para o display FHX50" ■ Código de pedido para o invólucro FHX50, dependendo do módulo de display desejado no recurso 020 (display, operação): <ul style="list-style-type: none"> ■ Opção C: para um módulo de display SD02 (botões) ■ Opção E: para um módulo de display SD03 (controle touch) <p>O alojamento FHX50 também pode ser solicitado como um kit de retrofit. O módulo de exibição do instrumento de medição é usado no invólucro FHX50. As opções a seguir devem ser selecionadas nos códigos de pedido do invólucro FHX50:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Recurso 050 (versão do instrumento de medição): opção B "Não preparada para o display FHX50" ■ Recurso 020 (display, operação): opção A "Nenhum, display existente utilizado"  Documentação especial SD01007F (Número de pedido: FHX50)
Proteção contra sobretensão para equipamentos com 2 fios	<p>O ideal seria que o módulo de proteção contra sobretensão seja pedido diretamente com o equipamento. Ver a estrutura do produto, recurso 610 "Acessório montado", opção NA "Proteção contra sobretensão". Só é necessário fazer um pedido em separado no caso de retrofit.</p> <p>OVP10: para equipamentos de 1 canal (recurso 020, opção A):</p>  Documentação especial SD01090F (Número de pedido OVP10: 71128617) (Número de pedido OVP20: 71128619)

Acessórios	Descrição
Tampa de proteção	<p>A tampa de proteção é usada para proteger contra luz solar direta, precipitação e gelo.</p> <p>Ela pode ser solicitada junto com o equipamento através da estrutura do produto: Código de pedido para "Acessórios incluídos" opção PB "Tampa de proteção"</p>  <p>(Número de pedido: 71162242)</p>
Suporte do transmissor (instalação da tubulação)	<p>Para fixar a versão remota à tubulação DN 20 a 80 (3/4 a 3")</p> <p>Código de pedido para "Acessório acompanha", opção PM</p>

15.1.2 Para o sensor

Acessórios	Descrição
Condicionador de vazão	<p>É usado para encurtar a operação de entrada necessária.</p> <p>(Número de pedido: DK7ST)</p> 

15.2 Acessórios específicos de comunicação

Acessórios	Descrição
Commubox FXA291	<p>Conecta os equipamentos de campo da Endress+Hauser com uma interface CDI (= Interface de Dados Comuns da Endress+Hauser) e a porta USB de um computador ou laptop.</p> 
Fieldgate FXA42	<p>Transmissão dos valores medidos dos instrumentos de medição analógicos de 4 a 20 mA conectados, bem como instrumentos de medição digitais</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informações técnicas TI01297S ▪ Instruções de operação BA01778S ▪ Página do produto: www.endress.com/fxa42
Field Xpert SMT50	<p>O PC tablet Field Xpert SMT50 para configuração do equipamento permite o gerenciamento de ativos da planta móvel em áreas não classificadas. Ele é adequado para que a equipe de comissionamento e de manutenção gerencie os instrumentos de campo com uma interface de comunicação digital e para registrar o progresso.</p> <p>Esse tablet é projetado como uma solução multifuncional com uma biblioteca de driver pré-instalada e é uma ferramenta touch fácil de usar que pode ser utilizada para gerenciar os instrumentos de campos por todo o ciclo de vida dos instrumentos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informações Técnicas TI01555S ▪ Instruções de operação BA02053S ▪ Página do produto: www.endress.com/smt50

Field Xpert SMT70	<p>O tablet Field Xpert SMT70 para configuração do equipamento permite o gerenciamento de ativos de fábrica de forma móvel em áreas classificadas e não classificadas. Ele é adequado para que a equipe de comissionamento e de manutenção gerencie os instrumentos de campo com uma interface de comunicação digital e para registrar o progresso.</p> <p>Esse tablet é projetado como uma solução multifuncional com uma biblioteca de driver pré-instalada e é uma ferramenta touch fácil de usar que pode ser utilizada para gerenciar os instrumentos de campos por todo o ciclo de vida dos instrumentos.</p> <p> ■ Informações técnicas TI01342S ■ Instruções de operação BA01709S ■ Página do produto: www.endress.com/smt70</p>
Field Xpert SMT77	<p>O tablet Field Xpert SMT77 para configuração de equipamentos permite o gerenciamento de ativos industriais de forma móvel, em áreas classificadas como Ex Zona 1.</p> <p> ■ Informações técnicas TI01418S ■ Instruções de operação BA01923S ■ Página do produto: www.endress.com/smt77</p>

15.3 Acessórios específicos para serviço

Acessórios	Descrição
Applicator	<p>Software para seleção e dimensionamento de instrumentos de medição Endress+Hauser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Escolha de instrumentos de medição para especificações industriais ■ Cálculo de todos os dados necessários para identificar o medidor de vazão ideal: por exemplo, diâmetro nominal, perda de pressão, velocidade da vazão e precisão. ■ Exibição gráfica dos resultados dos cálculos ■ Determinação do código de pedido parcial, administração, documentação e acesso a todos os dados e parâmetros relacionados ao processo durante toda a duração do projeto. <p>OApplicator está disponível: Através da Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator</p>
Netilion	<p>Ecossistema de IloT: Obtenha conhecimento</p> <p>Com o ecossistema de IloT Netilion, a Endress+Hauser possibilita que você otimize o desempenho da sua indústria, digitalize fluxos de trabalho, compartilhe conhecimento e melhore a colaboração.</p> <p>Com base em décadas de experiência em automação de processos, a Endress+Hauser oferece às indústrias de processos um ecossistema de IloT que fornece aos clientes informações baseadas em dados. Essas informações permitem a otimização do processo, levando a uma maior disponibilidade, eficiência e confiabilidade da fábrica - resultando, assim, em uma indústria mais lucrativa.</p> <p>www.netilion.endress.com</p>
FieldCare	<p>Ferramenta de gestão de ativos industriais baseada em FDT da Endress+Hauser.</p> <p>Ele configura todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajuda você a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.</p> <p> Instruções de operação BA00027S e BA00059S</p>
DeviceCare	<p>Ferramenta para conectar e configurar equipamentos de campo Endress+Hauser.</p> <p> Brochura sobre inovação IN01047S</p>

15.4 Componentes do sistema

Acessórios	Descrição
Gerenciador de dados gráficos Memograph M	O gerenciador de dados gráficos Memograph M fornece informações sobre todas as variáveis medidas relevantes. Os valores medidos são corretamente gravados, os valores limite são monitorados e os pontos de medição são analisados. Os dados são armazenados na memória interna de 256 MB, bem como em um cartão SD ou pendrive USB.  ■ Informações técnicas TI00133R ■ Instruções de operação BA00247R

16 Dados técnicos

16.1 Aplicação

O medidor somente é destinado à medição da vazão de líquidos, gases e vapor.

Para garantir que o equipamento permaneça em condições de operação apropriada para sua vida útil, use o medidor apenas com um meio para o qual as partes molhadas do processo sejam suficientemente resistentes.

16.2 Função e projeto do sistema

Princípio de medição	Medidores vórtex trabalham com o princípio de vértices alternados de Karman.
----------------------	--

Sistema de medição	O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.
--------------------	---

Duas versões do equipamento estão disponíveis:

- Versão compacta - o transmissor e o sensor formam uma unidade mecânica.
- Versão remota - o transmissor e o sensor são montados em locais separados.

Para informações sobre a estrutura do instrumento de medição → 13

16.3 Entrada

Variável de medição	Variáveis de medição diretas
---------------------	-------------------------------------

Código de pedido para "Versão do sensor; sensor DSC; tubo de medição"		
Opção	Descrição	Variável de medição
BD	Volume de alta temperatura; Liga 718; 316L	Vazão volumétrica

Código de pedido para "Versão do sensor; sensor DSC; tubo de medição"		
Opção	Descrição	Variável de medição
CD	Massa; Liga 718; 316L (medição da temperatura integrada)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Temperatura

Variáveis de medição calculadas

Código de pedido para "Versão do sensor; sensor DSC; tubo de medição"		
Opção	Descrição	Variável de medição
BD	Volume de alta temperatura; Liga 718; 316L	<p>Em condições de processo constantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão mássica ¹⁾ ■ Vazão volumétrica corrigida <p>Os valores totalizados para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica corrigida

1) Uma densidade fixa deve ser inserida para calcular a vazão mássica (menu **Configuração** → submenu **Configuração avançada** → submenu **Compensação externa** → parâmetro **Densidade fixa**).

Código de pedido para "Versão do sensor; sensor DSC; tubo de medição"

Opção	Descrição	Variável de medição
CD	Massa; Liga 718; 316L (medição da temperatura integrada)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mísica ■ Pressão Vapor saturado calculada ■ Fluxo de energia ■ Diferença Caudal calor ■ Volume específico ■ Graus de superaquecimento

Faixa de medição

A faixa de medição depende do diâmetro nominal, do fluido e de influências ambientais.



Os seguintes valores especificados são as maiores faixas possíveis de medição de vazão (Q_{\min} a Q_{\max}) para cada diâmetro nominal. Dependendo das propriedades do fluido e influências ambientais, a faixa de medição pode estar sujeita a restrições adicionais. Restrições adicionais se aplicam ao valor da faixa inferior e ao valor da faixa superior.


Faixas de medição de vazão em unidades SI

DN [mm]	Líquidos [m³/h]	Gás/vapor [m³/h]
15	0.1 para 4.9	0.52 para 25
25	0.32 para 15	1.6 para 130
40	0.63 para 30	3.1 para 250
50	0.99 para 47	4.9 para 620
80	2.4 para 110	12 para 1 500
100	4.1 para 190	20 para 2 600
150	9.3 para 440	47 para 5 900
200	18 para 760	90 para 10 000
250	28 para 1 200	140 para 16 000
300	40 para 1 700	200 para 22 000

Faixas de medição de vazão em unidades US

DN [pol.]	Líquidos [ft³/min]	Gás/vapor [ft³/min]
½	0.061 para 2.9	0.31 para 15
1	0.19 para 8.8	0.93 para 74
1½	0.37 para 17	1.8 para 150
2	0.58 para 28	2.9 para 370
3	1.4 para 67	7 para 900
4	2.4 para 110	12 para 1 500
6	5.5 para 260	27 para 3 500
8	11 para 450	53 para 6 000
10	17 para 700	84 para 9 300
12	24 para 1 000	120 para 13 000

Velocidade da vazão

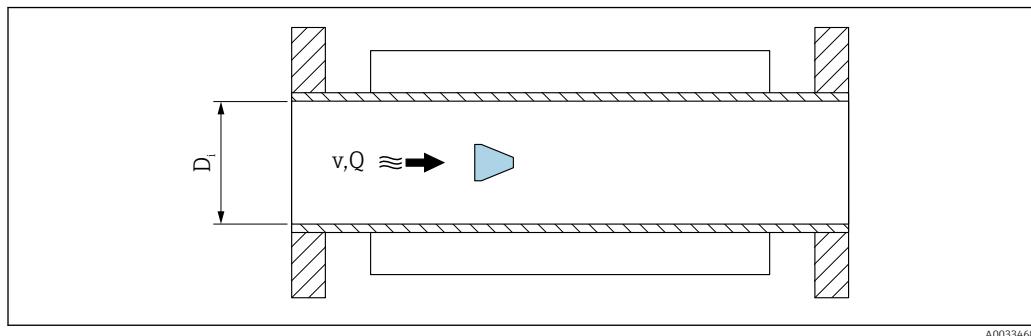

A0033468

D_i Diâmetro interno do tubo de medição (corresponde à dimensão K)

v Velocidade no tubo de medição

Q Vazão

O diâmetro interno do tubo de medição D_i é indicado nas dimensões como dimensão K.

Para informações detalhadas, consulte as informações técnicas → 228

Cálculo da velocidade da vazão:

$$v \text{ [m/s]} = \frac{4 \cdot Q \text{ [m}^3/\text{h]}}{\pi \cdot D_i \text{ [m]}^2} \cdot \frac{1}{3600 \text{ [s/h]}}$$

$$v \text{ [ft/s]} = \frac{4 \cdot Q \text{ [ft}^3/\text{min]}}{\pi \cdot D_i \text{ [ft]}^2} \cdot \frac{1}{60 \text{ [s/min]}}$$

A0034301

Menor valor da faixa

Número Reynolds

Uma restrição se aplica ao menor valor da faixa devido ao perfil de vazão turbulenta, que ocorre apenas com números de Reynolds maiores que 5 000. O número de Reynolds é adimensional e indica a razão da força de inércia de um fluido para sua força viscosa ao fluir, sendo usado como uma variável característica para vazões da tubulação. No caso de vazões da tubulação com números de Reynolds menores que 5 000, os vórtices periódicos não são mais gerados e a medição da taxa de vazão não é mais possível.

O número de Reynolds é calculado da seguinte forma:

$$Re = \frac{4 \cdot Q \text{ [m}^3/\text{s]}}{\pi \cdot D_i \text{ [m]} \cdot \mu \text{ [Pa} \cdot \text{s]}}$$

$$Re = \frac{4 \cdot Q \text{ [ft}^3/\text{s]}}{\pi \cdot D_i \text{ [ft]} \cdot \mu \text{ [lbf} \cdot \text{s/ft}^2]}$$

A0034291

Re Número Reynolds

Q Vazão

D_i Diâmetro interno do tubo de medição (corresponde à dimensão K)

μ Viscosidade dinâmica

ρ Densidade

O número de Reynolds 5 000, junto com a densidade e a viscosidade do fluido e o diâmetro nominal, é usado para calcular a taxa de vazão correspondente.

$$Q_{Re=5000} \text{ [m}^3/\text{h}] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_i \text{ [m]} \cdot \mu \text{ [Pa} \cdot \text{s]}}{4 \cdot \rho \text{ [kg/m}^3\text{]}} \cdot 3600 \text{ [s/h]}$$

$$Q_{Re=5000} \text{ [ft}^3/\text{h}] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_i \text{ [ft]} \cdot \mu \text{ [lbf} \cdot \text{s/ft}^2\text{]}}{4 \cdot \rho \text{ [lbm/ft}^3\text{]}} \cdot 60 \text{ [s/min]}$$

A0034302

$Q_{Re=5000}$ Taxa de vazão depende do número de Reynolds

D_i Diâmetro interno do tubo de medição (corresponde à dimensão K)

μ Viscosidade dinâmica

ρ Densidade

Velocidade mínima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

O sinal de medição deve ter uma certa amplitude mínima de sinal para que os sinais possam ser avaliados sem erros. Usando o diâmetro nominal, é possível também derivar a vazão correspondente dessa amplitude.

A amplitude mínima do sinal depende da configuração de sensibilidade do sensor DSC, da qualidade do vapor **x** e da força das vibrações presentes **a**.

O valor **mf** corresponde à velocidade de vazão mensurável mais baixa sem vibração (sem vapor úmido) para uma densidade de 1 kg/m³ (0.0624 lbm/ft³).

O valor **mf** pode ser definido na faixa de 20 para 6 m/s (6 para 1.8 ft/s) (ajuste de fábrica 12 m/s (3.7 ft/s)) com a parâmetro **Sensibilidade** (faixa de valor 1 para 9, ajuste de fábrica 5).

$$v_{AmpMin} \text{ [m/s]} = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{mf \text{ [m/s]}}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho \text{ [kg/m}^3\text{]}}{1 \text{ [kg/m}^3\text{]}}}} \\ \frac{\sqrt{50 \text{ [m]} \cdot a \text{ [m/s}^2\text{]}}}{x^2} \end{array} \right.$$

$$v_{AmpMin} \text{ [ft/s]} = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{mf \text{ [ft/s]}}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho \text{ [lbm/ft}^3\text{]}}{0.0624 \text{ [lbm/ft}^3\text{]}}}} \\ \frac{\sqrt{164 \text{ [ft]} \cdot a \text{ [ft/s}^2\text{]}}}{x^2} \end{array} \right.$$

A0034303

v_{AmpMin} Velocidade mínima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

mf Sensibilidade

x Qualidade de vapor

ρ Densidade

Taxa mínima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

$$Q_{AmpMin} [\text{m}^3/\text{h}] = \frac{v_{AmpMin} [\text{m}/\text{s}] \cdot \pi \cdot (D_i [\text{m}])^2}{4} \cdot 3600 [\text{s}/\text{h}]$$

$$Q_{AmpMin} [\text{ft}^3/\text{min}] = \frac{v_{AmpMin} [\text{ft}/\text{s}] \cdot \pi \cdot (D_i [\text{ft}])^2}{4} \cdot 60 [\text{s}/\text{min}]$$

A0034304

Q_{AmpMin} Taxa mínima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

v_{AmpMin} Velocidade mínima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

D_i Diâmetro interno do tubo de medição (corresponde à dimensão K)

ρ Densidade

Menor valor efetivo da faixa

O valor efetivo faixa inferior Q_{Baixa} é determinado através do maior dos três valores Q_{min} , $Q_{Re=5000}$ e Q_{AmpMin} .

$$Q_{Low} [\text{m}^3/\text{h}] = \max \begin{cases} Q_{min} [\text{m}^3/\text{h}] \\ Q_{Re=5000} [\text{m}^3/\text{h}] \\ Q_{AmpMin} [\text{m}^3/\text{h}] \end{cases}$$

$$Q_{Low} [\text{ft}^3/\text{min}] = \max \begin{cases} Q_{min} [\text{ft}^3/\text{min}] \\ Q_{Re=5000} [\text{ft}^3/\text{min}] \\ Q_{AmpMin} [\text{ft}^3/\text{min}] \end{cases}$$

A0034313

Q_{Baixa} Valor efetivo da faixa inferior

Q_{min} Taxa de vazão mínima mensurável

$Q_{Re=5000}$ Taxa de vazão depende do número de Reynolds

Q_{AmpMin} Taxa mínima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

 O Applicator está disponível para cálculos.

Maior valor da faixa

Taxa máxima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

A amplitude do sinal de medição deve estar abaixo de um determinado valor limite para garantir que os sinais possam ser avaliados sem erros. Isso resulta em uma taxa de fluxo máxima permitida Q_{AmpMax} .

$$Q_{AmpMax} \text{ [m}^3/\text{h}] = \frac{\text{URV} \text{ [m/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [m]}^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \text{ [kg/m}^3\text{]}}{1 \text{ [kg/m}^3\text{]}}}} \cdot 3600 \text{ [s/h]}$$

$$Q_{AmpMax} \text{ [ft}^3/\text{min}] = \frac{\text{URV} \text{ [ft/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [ft]}^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \text{ [lbm/ft}^3\text{]}}{0.0624 \text{ [lbm/ft}^3\text{]}}}} \cdot 60 \text{ [s/min]}$$

A0034316

Q_{AmpMax} Taxa máxima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

D_i Diâmetro interno do tubo de medição (corresponde à dimensão K)

ρ Densidade

URV Valor-limite para determinar a taxa de vazão máxima:

- DN 15 para 40: URV = 350
- DN 50 para 300: URV = 600
- NPS ½ to 1½: URV = 1148
- NPS 2 to 12: URV = 1969

O maior valor restrito da faixa depende do número Mach

Para aplicações de gás, uma restrição adicional se aplica ao maior valor da faixa em relação ao número Mach no instrumento de medição, que deve ser menor que 0.3. O número Mach Ma descreve a razão da velocidade da vazão v com a velocidade do som c no fluido.

$$Ma = \frac{v \text{ [m/s]}}{c \text{ [m/s]}}$$

$$Ma = \frac{v \text{ [ft/s]}}{c \text{ [ft/s]}}$$

A0034321

Ma Número Mach

v Velocidade da vazão

c Velocidade do som

A taxa de vazão correspondente pode ser derivada utilizando-se o diâmetro nominal.

$$Q_{Ma=0.3} \text{ [m}^3/\text{h}] = \frac{0.3 \cdot c \text{ [m/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [m]}^2}{4} \cdot 3600 \text{ [s/h]}$$

$$Q_{Ma=0.3} \text{ [ft}^3/\text{min}] = \frac{0.3 \cdot c \text{ [ft/s]} \cdot \pi \cdot D_i \text{ [ft]}^2}{4} \cdot 60 \text{ [s/min]}$$

A0034337

$Q_{Ma=0.3}$ O valor restrito da faixa superior depende do número Mach

c Velocidade do som

D_i Diâmetro interno do tubo de medição (corresponde à dimensão K)

ρ Densidade

Maior valor efetivo da faixa

O valor efetivo da faixa superior Q_{Alta} é determinado através do menor dos três valores Q_{min} , Q_{AmpMax} e $Q_{Ma=0,3}$.

$$Q_{High} [m^3/h] = \min \begin{cases} Q_{max} [m^3/h] \\ Q_{AmpMax} [m^3/h] \\ Q_{Ma=0,3} [m^3/h] \end{cases}$$

$$Q_{High} [ft^3/min] = \min \begin{cases} Q_{max} [ft^3/min] \\ Q_{AmpMax} [ft^3/min] \\ Q_{Ma=0,3} [ft^3/min] \end{cases}$$

A0034338

Q_{Alta} Maior valor efetivo de faixa

Q_{max} Taxa de vazão máxima mensurável

Q_{AmpMax} Taxa máxima de vazão mensurável com base na amplitude do sinal

$Q_{Ma=0,3}$ O valor restrito da faixa superior depende do número Mach

Para líquidos, a ocorrência de cavitação também pode restringir o valor da faixa superior.

 O Applicator está disponível para cálculos.

Faixa de vazão operável

O valor, que normalmente é de até 49: 1, pode variar dependendo das condições de operação (relação entre o valor da faixa superior e o valor da faixa inferior)

Sinal de entrada

Valores externos medidos

Para aumentar a precisão de determinadas variáveis medidas ou para calcular a vazão volumétrica corrigida, o sistema de automação pode gravar continuamente diferentes valores medidos para o instrumento de medição:

- Pressão de operação para aumentar a precisão de medição (a Endress+Hauser recomenda o uso de um instrumento de medição de pressão para pressão absoluta, por ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- Temperatura média para aumentar a precisão de medição (por ex. iTEMP)
- Densidade de referência para calcular a vazão volumétrica corrigida

-  ■ Uma diversidade de medidores de pressão pode ser encomendada como acessórios da Endress+Hauser.
- Se estiver usando medidores de pressão, preste atenção aos trechos retos a jusante ao instalar equipamentos externos →  25.

Se o equipamento não tiver compensação de temperatura, recomenda-se que os valores de medição da pressão externa sejam lidos de tal forma que as seguintes variáveis medidas possam ser calculadas:

- Vazão de energia
- Vazão mássica
- Vazão volumétrica corrigida

Comunicação digital

Os valores medidos são gravados a partir do sistema de automação no instrumento de medição através do FOUNDATION Fieldbus.

16.4 Saída

Sinal de saída

Saída em pulso/frequência/comutada

Função	Pode ser configurada como saída em pulso, frequência ou comutada
Versão	Passiva, coletor aberto
Valores máximos de entrada	<ul style="list-style-type: none"> ■ DC 35 V ■ 50 mA
Queda de tensão	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para \leq 2 mA: 2 V ■ Para 10 mA: 8 V
Corrente residual	\leq 0.05 mA
Saída em pulso	
Largura do pulso	Configurável: 5 para 2 000 ms
Taxa máxima do pulso	100 Impulse/s
Valor do pulso	Configurável
Variáveis medidas atribuíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão mássica ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica total ■ Vazão de energia ■ Diferença de vazão de calor
Saída de frequência	
Frequência de saída	Configurável: 0 para 1 000 Hz
Amortecimento	Configurável: 0 para 999 s
Pulso/razão de pausa	1:1
Variáveis medidas atribuíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Velocidade da vazão ■ Temperatura ■ Pressão de vapor saturado calculada ■ Vazão mássica total ■ Vazão de energia ■ Diferença de vazão de calor ■ Pressão
Saída comutada	
Comportamento de comutação	Binário, condutor ou não condutor
Atraso de comutação	Configurável: 0 para 100 s

Número de ciclos de comutação	Ilimitado
Funções atribuíveis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desligado ■ Ligado ■ Comportamento do diagnóstico ■ Valor limite <ul style="list-style-type: none"> ■ Vazão volumétrica ■ Vazão volumétrica corrigida ■ Vazão mássica ■ Velocidade da vazão ■ Temperatura ■ Pressão de vapor saturado calculada ■ Vazão mássica total ■ Vazão de energia ■ Diferença de vazão de calor ■ Pressão ■ Número Reynolds ■ Totalizador 1-3 ■ Status ■ Status do corte de vazão baixa

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus	H1, IEC 61158-2, isolado galvanicamente
Transferência de dados	31.25 kbit/s
Consumo de corrente	15 mA
Tensão de alimentação permitida	9 para 32 V
Conexão de barramento	Com proteção de polaridade reversa integrada

Sinal em alarme

Dependendo da interface, uma informação de falha é exibida, como segue:

Saída em pulso/frequência/comutada

Saída em pulso	
Modo de falha	Sem pulsos
Saída de frequência	
Modo de falha	Escolha entre: <ul style="list-style-type: none"> ■ Valor real ■ 0 Hz ■ Valor definível entre: 0 para 1 250 Hz
Saída comutada	
Modo de falha	Escolha entre: <ul style="list-style-type: none"> ■ Estado da corrente ■ Aberto ■ Fechado

FOUNDATION Fieldbus

Estado e alarme mensagens	Diagnósticos de acordo com a FF-891
Erro na corrente FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

Display local

Display de texto padronizado	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
Luz de fundo	Além disso, para a versão do equipamento com display local SD03: A luz vermelha indica um erro no equipamento.

 Sinal de estado de acordo com a recomendação NAMUR NE 107

Interface/protocolo

- Através de comunicação digital:
FOUNDATION Fieldbus
- Através da interface de operação
Interface de dados comuns Endress+Hauser (CDI)

Display de texto padronizado	Com informações sobre a causa e medidas corretivas
-------------------------------------	--

Corte vazão baixo Os pontos de comutação para corte de vazão baixa são predefinidos e podem ser configurados.

Isolamento galvânico Todas as entradas e saídas são isoladas galvanicamente umas das outras.

FOUNDATION Fieldbus	ID do fabricante	0x452B48
	Número de identificação	0x1038
	Revisão do equipamento	2
	Revisão DD	Informações e arquivos em: ■ www.endress.com → Área de Downloads
	Revisão CFF	■ www.fieldcommgroup.org
	Versão de Teste do Equipamento (Versão ITK)	6.2.0
	Número da campanha do teste ITK	Informações: ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org
	Capacidade do Link Master (LAS)	Sim
	Escolha do "Link Master" e do "Equipamento Básico"	Sim Ajuste de fábrica: Equipamento básico
	Endereço do nó	Ajuste de fábrica: 247 (0xF7)
Funções compatíveis		Os métodos a seguir são compatíveis: ■ Reinicialização ■ Reinicialização ENP ■ Diagnóstico ■ Ler eventos ■ Ler dados de tendência
Relacionamentos de Comunicação Virtual (VCRs)		
Número de VCRs		44
Número de objetos vinculados no VFD		50
Entradas permanentes		1
VCRs do cliente		0

VCRs do servidor	10
VCRs da fonte	43
VCRs do dissipador	0
VCRs do assinante	43
VCRs do editor	43
Capacidades do link do equipamento	
Tempo de Slot	4
Atraso mín. entre PDU	8
Atraso máx. de resposta	Min. 5
Integração do sistema	Para informações sobre integração do sistema, consulte as <ul style="list-style-type: none">■ Dados de transmissão cíclica■ Descrição dos módulos■ Tempos de execução■ Métodos

16.5 Fonte de alimentação

Esquema de ligação elétrica →  34

Conectores do equipamento →  34
disponíveis

Tensão de alimentação

Transmissor

Uma fonte de alimentação externa é necessária para cada saída.

Os seguintes valores de fonte de alimentação aplicam-se às saídas disponíveis:

Fonte de alimentação para uma versão compacta sem display local ¹⁾

Código do pedido para "Saída, entrada"	Mínimo tensão do terminal ²⁾	Máximo Tensão do terminal
Opção E: FOUNDATION Fieldbus, saída em pulso/frequência/comutada	≥ CC 9 V	DC 32 V

1) No caso de uma fonte de alimentação externa do condicionador de potência

2) A tensão mínima do terminal aumenta se a operação local for usada: consulte a tabela a seguir

Aumento da tensão mínima do terminal com operação local

Código do pedido para "Display; operação"	Aumento na mínima Tensão do terminal
Opção C: Operação local SD02	+ CC 1 V
Opção E: Operação local SD03 com iluminação (iluminação de fundo não usada)	+ CC 1 V
Opção E: Operação local SD03 com iluminação (iluminação de fundo usada)	+ CC 3 V

Consumo de energia

Transmissor

Código do pedido para "Saída, entrada"	Consumo de energia máximo
Opção E: FOUNDATION Fieldbus, saída em pulso/frequência/comutada	<ul style="list-style-type: none"> ■ Operação com saída 1: 512 mW ■ Operação com saída 1 e 2: 2 512 mW

Consumo de corrente

FOUNDATION Fieldbus

15 mA

Falha na fonte de alimentação

- Os totalizadores param no último valor medido.
- Dependendo da versão do equipamento, a configuração fica retida na memória do equipamento ou na memória de dados conectável (HistoROM DAT).
- Mensagens de erro (incluindo total de horas operadas) são armazenadas.

Conexão elétrica

→ 37

Equalização de potencial

→ 43

Terminais

- Para versão de equipamento sem proteção contra sobretensão integrada: terminais de mola de encaixe para seções transversais do fio 0.5 para 2.5 mm² (20 para 14 AWG)
- Para versão de equipamento com proteção contra sobretensão integrada: terminais de parafuso para seções transversais dos fios 0.2 para 2.5 mm² (24 para 14 AWG)

Entradas para cabos

O tipo de entrada para cabo disponível depende da versão específica do equipamento.

Prensa-cabos (não para Ex d)

M20 ×1,5

Rosca para entrada para cabo

- NPT ½"
- G ½"
- M20 ×1,5

Especificação do cabo

→ 32

Proteção contra sobretensão

O equipamento pode ser solicitado com proteção contra sobretensão integrada:
Código de pedido para "Acessório instalado", opção NA "Proteção contra sobretensão"

Faixa de tensão de entrada	Os valores correspondem às especificações da tensão de alimentação → 36 ¹⁾
Resistência por canal	2 · 0.5 Ω máx.
Sobretensão cc na faísca	400 para 700 V
Tensão de surto de disparo	< 800 V
Capacitância a 1 MHz	< 1.5 pF

Corrente nominal de descarga (8/20 µs)	10 kA
Faixa de temperatura	-40 para +85 °C (-40 para +185 °F)

- 1) A tensão é reduzida pelo valor da resistência interna $I_{\min} \cdot R_i$

 Dependendo da classe de temperatura, as restrições se aplicam à temperatura ambiente para versões de equipamentos com proteção contra sobretensão.

 Para informações detalhadas sobre as tabelas de temperatura, consulte as "Instruções de segurança" (XA) do equipamento.

16.6 Características de desempenho

Condições de operação de referência


- Limites de erro em conformidade com a ISO/DIN 11631
- +20 para +30 °C (+68 para +86 °F)
- 2 para 4 bar (29 para 58 psi)
- Sistema de calibração que pode ser comprovado com as normas nacionais
- Calibração com a conexão do processo correspondente à norma específica

 Para obter erros medidos, use a ferramenta de dimensionamento *Applicator*
→ 198

Erro medido máximo

Precisão de base

D.L. = da leitura

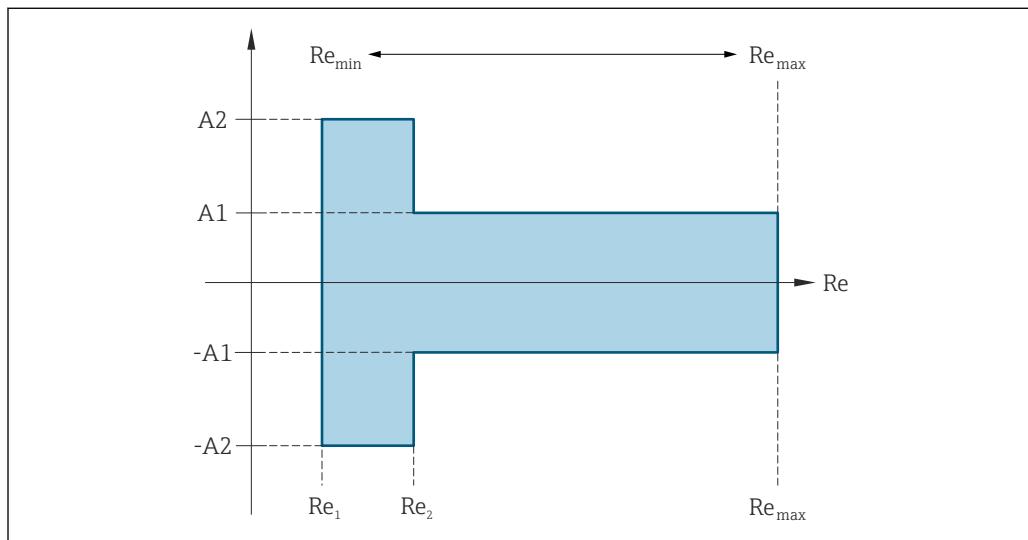

A0034077

Número Reynolds	
Re_1	5 000
Re_2	10 000
Re_{\min}	O número Reynolds para a mínima vazão volumétrica permitida no tubo de medição Padrão

Número Reynolds	
	$Q_{AmpMin} \text{ [m}^3/\text{h}] = \frac{v_{AmpMin} \text{ [m/s]} \cdot \pi \cdot (D_i \text{ [m]})^2}{4} \cdot 3600 \text{ [s/h]}$ $Q_{AmpMin} \text{ [ft}^3/\text{min}] = \frac{v_{AmpMin} \text{ [ft/s]} \cdot \pi \cdot (D_i \text{ [ft]})^2}{4} \cdot 60 \text{ [s/min]}$
Re _{max}	<p>Definido pelo diâmetro interno do tubo de medição, número Mach e velocidade máxima permitida no tubo de medição</p> $Re_{max} = \frac{\rho \cdot 4 \cdot Q_{Heigh}}{\mu \cdot \cdot K}$ <p>i Mais informações sobre o valor efetivo da faixa superior Q_{Alta} → 204</p>

A0034304

A0034339

Vazão volumétrica

Tipo de meio		Incompressível	Compressível
Número Reynolds Faixa	Erro de medição	Padrão	Padrão
Re ₂ a Re _{max}	A1	< 0.75 %	< 1.0 %
Re ₁ a Re ₂	A2	< 5.0 %	< 5.0 %

Temperatura

- Vapor saturado e líquidos em temperatura ambiente, se T > 100 °C (212 °F):
< 1 °C (1.8 °F)
- Gás: < 1 % o.r. [K]
- Tempo de incremento 50 % (agitado sob a água, de acordo com IEC 60751): 8 s

Vazão mássica de vapor saturado

Versão do sensor				Massa (medição da temperatura integrada)
Pressão de processo [bar abs.]	Velocidade da vazão [m/s (ft/s)]	Número Reynolds Faixa	Erro de medição	Padrão
> 4.76	20 para 50 (66 para 164)	Re ₂ a Re _{max}	A1	< 1.7 %
> 3.62	10 para 70 (33 para 230)	Re ₂ a Re _{max}	A1	< 2.0 %
Em todos os casos não especificados aqui, aplica-se o seguinte: < 5.7 %				

Vazão mássica de vapor/gases superaquecidos^{4) 5)}

Versão do sensor				Massa (medição de temperatura integrada) + compensação da pressão externa ¹⁾
Pressão de processo [bar abs.]	Velocidade da vazão [m/s (ft/s)]	Número Reynolds Faixa	Erro de medição	Padrão
< 40	Todas as velocidades	Re ₂ a Re _{max}	A1	< 1.7 %
< 120		Re ₂ a Re _{max}	A1	< 2.6 %
Em todos os casos não especificados aqui, aplica-se o seguinte: < 6.6 %				

- 1) O uso de um Cerabar S é necessário para os erros de medição listados na seção a seguir. O erro de medição usado para calcular o erro na pressão medida é 0.15 %.

Vazão mássica da água

Versão do sensor				Massa (medição da temperatura integrada)
Pressão de processo [bar abs.]	Velocidade de vazão [m/s (ft/s)]	Número Reynolds faixa	Desvio do valor medido	Padrão
Todas as pressões	Todas as velocidades	Re ₂ a Re _{max}	A1	< 0.85 %
		Re ₁ a Re ₂	A2	< 2.7 %

Vazão mássica (líquidos específicos do usuário)

Para especificar a precisão do sistema, a Endress+Hauser exige informações sobre o tipo de líquido e sua temperatura operacional ou informações em forma de tabela sobre a dependência entre a densidade do líquido e a temperatura.

Exemplo

- Acetona deve ser medida em temperaturas de fluido a partir de +70 para +90 °C (+158 para +194 °F).
- Para tanto, o parâmetro **Temperatura de referência** (7703) (aqui 80 °C (176 °F)), parâmetro **Densidade de referência** (7700) (aqui 720.00 kg/m³) e parâmetro **Coeficiente de expansão linear** (7621) (aqui 18.0298 × 10⁻⁴ 1/°C) devem ser inseridas no transmissor.
- A incerteza geral do sistema, que é menor que 0.9 % no exemplo acima, é composta pelas seguintes incertezas de medição: incerteza da medição da vazão volumétrica, incerteza da medição de temperatura, incerteza da correlação densidade-temperatura usada (incluindo a incerteza resultante da densidade).

Vazão mássica (outros meios)

Depende do fluido selecionado e do valor da pressão, especificado nos parâmetros. A análise de erro individual deve ser executada.

Precisão dos resultados

As saídas têm as especificações de precisão base listadas a seguir.

Saída de pulso/frequência

o.r. = de leitura

Precisão	Máx. ±100 ppm o.r.
----------	--------------------


4) Gás único, mistura de gases, ar: NEL40; gás natural: ISO 12213-2 contém AGA8-DC92, AGA NX-19, ISO 12213-3 contém SGERG-88 e AGA8 Método Bruto 1
 5) O instrumento de medição foi calibrado com água e verificado sob pressão em plataformas de calibração de gás.

Repetibilidade

D.L. = da leitura

$$r = \left\{ \frac{100 \cdot D_i^3}{V} \right\}^{1/2} \% \text{ o.r.}$$

A0042121-PT

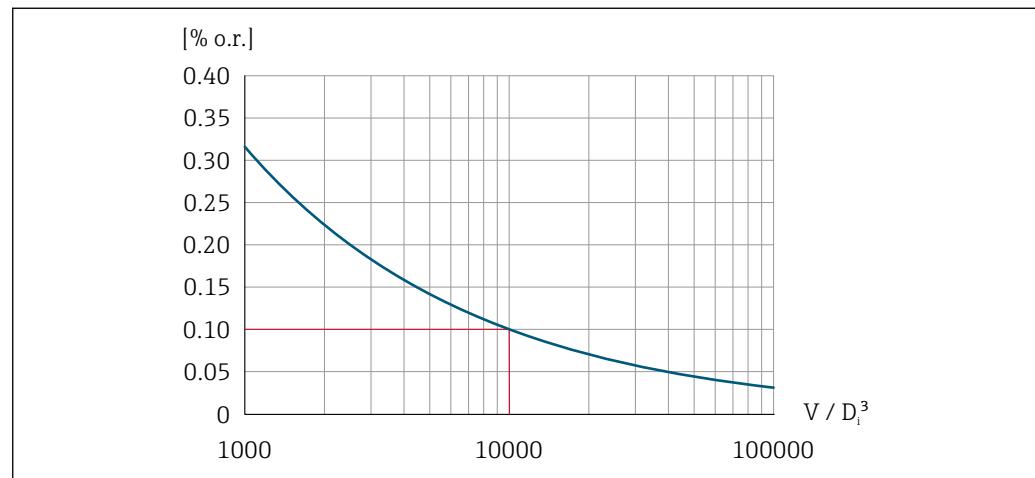

A0042123-PT

■ 26 Repetibilidade = 0,1 % o.r. com um volume medido [m^3] de $V = 10\,000 \cdot D_i^3$

A repetibilidade pode ser melhorada se o volume medido for aumentado. A repetibilidade não é uma característica do equipamento, mas uma variável estatística que depende das condições limites indicadas.

Tempo de resposta

Se todas as funções configuráveis para os tempos de filtragem (amortecimento da vazão, amortecimento da exibição, constante do tempo da saída de corrente, constante do tempo da saída de frequência, constante do tempo de saída de status) forem ajustadas como 0, no caso de frequências vórtex de 10 Hz e mais altas, deve-se esperar um tempo de resposta de máx(T_v , 100 ms).

No caso de frequências de medição < 10 Hz, o tempo de resposta é > 100 ms e pode chegar até 10 s. T_v é a duração média do período de vórtex do fluido de vazão.

Umidade relativa

O equipamento é adequado para uso em áreas externas e internas com uma umidade relativa de 5 a 95 %.

Altura de operação

De acordo com o EN 61010-1

- ≤ 2 000 m (6 562 ft)
- > 2 000 m (6 562 ft) com proteção adicional contra sobretensão (por ex. Endress+Hauser HAW Series)

Influência da temperatura ambiente

Saída de pulso/frequência

o.r. = da leitura

Coeficiente de temperatura	Máx. ±100 ppm o.r.
----------------------------	--------------------

16.7 Instalação

Requisitos de instalação → 22

16.8 Ambiente

Faixa de temperatura ambiente → 25

Tabelas de temperatura

Observe as interdependências entre o ambiente permitido e as temperaturas dos fluidos quando operar o equipamento em áreas classificadas.

Para informações detalhadas sobre as tabelas de temperatura, consulte a documentação separada intitulada "Instruções de segurança" (XA) do equipamento.

Temperatura de armazenamento Todos os componentes separados dos módulos de display:
-50 para +80 °C (-58 para +176 °F)

Módulos de display

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Display remoto FHX50:

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Umidade relativa O equipamento é adequado para uso em áreas externas e internas com uma umidade relativa de 5 a 95 %.

Classe climática DIN EN 60068-2-38 (teste Z/AD)

Grau de proteção

Transmissor

- Padrão: IP66/67, gabinete tipo 4X, adequado para grau de poluição 4
- Quando o invólucro está aberto: IP20, gabinete tipo 1, adequado para grau de poluição 2
- Módulo do display: IP20, gabinete tipo 1, adequado para grau de poluição 2

Sensor

IP66/67, invólucro tipo 4X, adequado para grau 4 de poluição

Conector do equipamento

IP67, somente quando rosqueado

Resistência à vibração e resistência a choques

Vibração sinusoidal, em conformidade com IEC 60068-2-6

Código de pedido para "Invólucro", opção B "GT18 compartimento duplo, 316L, compacto"

- Pico de 2 para 8.4 Hz, 3.5 mm
- Pico de 8.4 para 500 Hz, 1 g

Código de pedido para "Invólucro", opção C "GT20 compartimento duplo, alu, revestido, compacto" ou opção J "GT20 compartimento duplo, alu, revestido, remoto" ou opção K "GT18 compartimento duplo, 316L, remoto"

- Pico de 2 para 8.4 Hz, 7.5 mm
- Pico de 8.4 para 500 Hz, 2 g

Vibração aleatória da banda larga de acordo com o IEC 60068-2-64

Código de pedido para "Invólucro", opção B "GT18 compartimento duplo, 316L, compacto"

- 10 para 200 Hz, 0.003 g²/Hz
- 200 para 500 Hz, 0.001 g²/Hz
- Total: 0.93 g rms

Código de pedido para "Invólucro", opção C "GT20 compartimento duplo, alu, revestido, compacto" ou opção J "GT20 compartimento duplo, alu, revestido, remoto" ou opção K "GT18 compartimento duplo, 316L, remoto"

- 10 para 200 Hz, 0.01 g²/Hz
- 200 para 500 Hz, 0.003 g²/Hz
- Total: 1.67 g rms

Meia onda sinusoidal de choque conforme IEC 60068-2-27

- Código de pedido para "Invólucro", opção B "GT18 compartimento duplo, 316L, compacto" 6 ms 30 g
- Código de pedido para "Invólucro", opção C "GT20 compartimento duplo, alu, revestido, compacto" ou opção J "GT20 compartimento duplo, alu, revestido, remoto" ou opção K "GT18 compartimento duplo, 316L, remoto" 6 ms 50 g

Impactos de manuseio bruto, de acordo com a IEC 60068-2-31

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

 Detalhes na Declaração de conformidade.

 Esta unidade não é destinada para uso em ambientes residenciais e não pode garantir proteção adequada da recepção de rádio em tais ambientes.

16.9 Processo

Faixa de temperatura média

Sensor DSC ¹⁾

Código de pedido para "Versão do sensor; sensor DSC; tubo de medição"		
Opção	Descrição	Faixa de temperatura média
BD	Volume de alta temperatura; Liga 718; 316L	-200 para +400 °C (-328 para +752 °F), PN 63 para 160/Classe 600
CD	Massa; liga 718; 316L	-200 para +400 °C (-328 para +752 °F)
Versão especial para temperaturas de fluido muito altas (sob encomenda)		-200 para +440 °C (-328 para +824 °F), versão para áreas classificadas

1) Sensor de capacitors

Vedações

Código de pedido para "Vedaçao do sensor DSC"

Opção	Descrição	Faixa de temperatura média
A	Grafite	-200 para +400 °C (-328 para +752 °F)
B	Viton	-15 para +175 °C (+5 para +347 °F)
C	Gylon	-200 para +260 °C (-328 para +500 °F)
D	Kalrez	-20 para +275 °C (-4 para +527 °F)

Classificações de pressão/temperatura

 Para uma visão geral das classificações de pressão-temperatura para as conexões de processo, consulte as Informações técnicas

Pressão nominal do sensor Os seguintes valores de resistência a sobrepressão aplicam-se ao eixo do sensor em casos de ruptura da membrana:

Versão do sensor; sensor DSC; tubo de medição	Sobrepressão, eixo do sensor in [bar a]
Alta temperatura do volume	375
Massa (medição da temperatura integrada)	375
Vapor de massa (medição da pressão/temperatura integrada)	375
Líquido/gás de massa (medição da pressão/temperatura integrada)	

Perda de pressão Para um cálculo preciso, use o Applicator → 198.

Vibrações

16.10 Construção mecânica

Design, dimensões

 Para saber as dimensões e os comprimentos de instalação do equipamento, consulte o documento "Informações técnicas", seção "Construção mecânica"

Peso

Versão compacta

Dados de peso:

- Incluindo o transmissor:
 - Código do produto para "Invólucro" opção C "GT20. duas câmaras, alumínio, revestido, compacto" 1.8 kg (4.0 lb):
 - Código do produto para "Invólucro", opção B "GT18, duas câmaras, 316L, compacto" 4.5 kg (9.9 lb):
- Excluindo o material da embalagem

Peso em unidades SI

Todos os valores (peso) referem-se aos equipamentos com flanges EN (DIN), PN 250. Informações de peso em [kg].

DN [mm]	Peso [kg]	
	Código do pedido para "Invólucro", opção C "GT20 de duas câmaras, alumínio, revestido, compacto"	Código do pedido para "Invólucro", opção B "GT18 de duas câmaras, 316L, compacto"
15	15.1	17.8
25	16.1	18.8
40	21.1	23.8
50	23.1	2.8
80	41.1	43.8
100	64.1	66.8
150	152.1	154.8

Peso em unidades US

Todos os valores (peso) referem-se aos equipamentos com flanges ASME B16.5, Classe 1500/Sch. 80. Informações de peso em [lbs].

DN [pol.]	Peso [lbs]	
	Código do pedido para "Invólucro", opção C "GT20 de duas câmaras, alumínio, revestido, compacto"	Código do pedido para "Invólucro", opção B "GT18 de duas câmaras, 316L, compacto"
½	29.0	34.9
1	37.8	43.7
1½	44.4	50.3
2	66.5	72.4
3	108.3	114.3
4	156.8	162.8
6	381.7	387.7

Versão remota do transmissor*Invólucro de montagem na parede*

Depende do material do invólucro de montagem na parede:

- Código do produto para "Invólucro" opção J "GT20 duas câmaras, alumínio, revestido, remoto" 2.4 kg (5.2 lb):
- Código do produto para "Invólucro", opção K "GT18, duas câmaras, 316L, remoto" 6.0 kg (13.2 lb):

Versão remota do sensor

Dados de peso:

- Incluindo invólucro de conexão do sensor:
 - Código do produto para "Invólucro" opção J "GT20 duas câmaras, alumínio, revestido, remoto" 0.8 kg (1.8 lb):
 - Código do produto para "Invólucro", opção K "GT18, duas câmaras, 316L, remoto" 2.0 kg (4.4 lb):
- Excluindo o cabo de conexão
- Excluindo o material da embalagem

Peso em unidades SI

Todos os valores (peso) referem-se aos equipamentos com flanges EN (DIN), PN 250. Informações de peso em [kg].

DN [mm]	Peso [kg]	
	invólucro de conexão do sensor Código do pedido para "Invólucro", opção J "GT20 de duas câmaras, alumínio, revestido, remoto"	invólucro de conexão do sensor Código do pedido para "Invólucro", opção K "GT18 de duas câmaras, 316L, remoto"
15	14.1	15.3
25	15.1	16.3
40	20.1	21.3
50	22.1	23.3
80	40.1	41.3
100	63.1	64.3
150	151.1	152.3

Peso em unidades US

Todos os valores (peso) referem-se aos equipamentos com flanges ASME B16.5, Classe 1500/Sch. 80. Informações de peso em [lbs].

DN [pol.]	Peso [lbs]	
	invólucro de conexão do sensor Código do pedido para "Invólucro", opção J "GT20 de duas câmaras, alumínio, revestido, remoto"	invólucro de conexão do sensor Código do pedido para "Invólucro", opção K "GT18 de duas câmaras, 316L, remoto"
½	26.6	29.4
1	35.4	38.2
1½	42.0	44.8
2	64.1	66.8
3	105.9	108.7
4	154.5	157.2
6	379.3	382.1

Acessórios*Condicionador de vazão**Peso em unidades SI*

DN EN ¹⁾ [mm]	Nível de pressão	Peso [kg]
15	PN 63	0.05
25	PN 63	0.2
40	PN 63	0.4
50	PN 63	0.6
80	PN 63	1.4
100	PN 63	2.4
150	PN 63	7.8

1) (DIN)

DN ¹⁾ [mm]	Nível de pressão	Peso [kg]
15	40K	0.06
25	40K	0.1
40	40K	0.3
50	40K	0.5
80	40K	1.3
100	40K	2.1
150	40K	6.2

1) JIS


Materiais

Invólucro do transmissor*Versão compacta*

- Código do produto para "Invólucro", opção B "GT18, duas câmaras, 316L, compacto":
Aço inoxidável, CF3M
- Código do produto para "Invólucro" opção C "GT20. duas câmaras, alumínio, revestido, compacto":
Alumínio, AlSi10Mg, revestido
- Material da janela: vidro

Versão remota

- Código do produto para "Invólucro" opção J "GT20 duas câmaras, alumínio, revestido, remoto":
Alumínio, AlSi10Mg, revestido
- Código do produto para "Invólucro", opção K "GT18, duas câmaras, 316L, remoto":
Para máxima resistência à corrosão: aço inoxidável, CF3M
- Material da janela: vidro

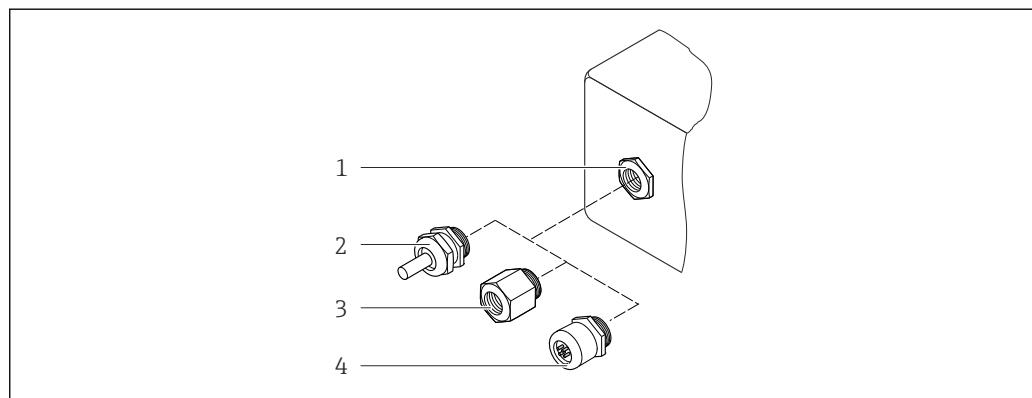Entradas para cabo/prensa-cabos

A0028352

Fig. 27 Possíveis entradas para cabo/prensa-cabos

- 1 Rosca interna M20 × 1,5
- 2 Prensa-cabos M20 × 1,5
- 3 Adaptador para entrada de cabos com rosca interna G 1/2" ou NPT 1/2"
- 4 Conector do equipamento

*Código de pedido para "Invólucro", opção B "GT18 compartimento duplo, 316L, compacto"
opção K "GT18 compartimento duplo, 316L, remoto"*

Entrada para cabo/prensa-cabo	Tipo de proteção	Material
Prensa-cabos M20 × 1,5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Área não-classificada ■ Ex ia ■ Ex ic ■ Ex nA, Ex ec ■ Ex tb 	Aço inoxidável, 1.4404
Adaptador de entrada para cabos com rosca interna G 1/2"	Área classificada e área não-classificada (exceto para XP)	Aço inoxidável, 1.4404 (316L)
Adaptador de entrada para cabos com rosca interna NPT 1/2"	Área classificada e área não-classificada	

Código de pedido para "Invólucro": opção C "compartimento duplo GT20, alumínio, revestido, compacto", opção J "compartimento duplo GT20, alumínio, revestido, remoto"

Entrada para cabo/prensa-cabo	Tipo de proteção	Material
Prensa-cabos M20 × 1,5	■ Área não-classificada ■ Ex ia ■ Ex ic	Plástico
	Adaptador de entrada para cabos com rosca interna G ½"	Latão niquelado
Adaptador de entrada para cabos com rosca interna NPT ½"	Área classificada e área não-classificada (exceto para XP)	Latão niquelado
Rosca ½" NPT via adaptador	Área classificada e área não-classificada	

Cabo de conexão para versão remota

- Cabo padrão: cabo em PVC com blindagem em cobre
- Cabo reforçado: cabo em PVC com blindagem em cobre e revestimento de fio de aço trançado adicional

Invólucro de conexão do sensor

O material do invólucro de conexão do sensor depende do material selecionado para o invólucro do transmissor.

- Código do produto para "Invólucro" opção J "GT20 duas câmaras, alumínio, revestido, remoto":
Alumínio revestido AlSi10Mg
- Código do produto para "Invólucro", opção K "GT18, duas câmaras, 316L, remoto":
Aço fundido inoxidável, 1.4408 (CF3M)
Em conformidade com:
 - NACE MR0175
 - NACE MR0103

Tubos de medição

DN 15 a 300 (½ a 12"), classificações de pressão PN160/250, classe 900/1500

- Aço fundido inoxidável, CF3M/1.4408
- Em conformidade com:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003
- DN15 a 150 (½ a 6"): AD2000, faixa de temperatura permitida
-10 para +400 °C (+14 para +752 °F) restrita

Sensor DSC

Código de pedido para "Versão do sensor; sensor DSC; tubo de medição", opção **BD, CD**

Classificações de pressão PN 160/250, Classe 900/1500:

Partes em contato com o meio (identificadas como "molhado" na flange do sensor DSC):

- UNS N07718 similar à Liga /718/2.4668
- Em conformidade com:
 - NACE MR01752003
 - NACE MR01032003

Partes sem contato com o meio:

Aço inoxidável 1,4301 (304)

Cnexões de processo

Classificações de pressão PN 160/250, Classe 900/1500:

Material de aço inoxidável, com tripla certificação 1.4404/F316/F316L

 Conexões de processo disponíveis

Vedações

- Grafite

Película Sigraflex ZTM (certificado BAM para aplicações de oxigênio)
- FPM (VitonTM)
- Kalrez 6375TM
- Gylon 3504TM (certificado BAM para aplicações de oxigênio)

Suporte do invólucro

Aço inoxidável, 1.4408 (CF3M)

Parafusos para o sensor DSC

- Código de pedido para "Versão do sensor", opção BD, CD,
Aço inoxidável, A2 conforme ISO 3506-1 (304)
- Sob encomenda
Aço inoxidável, 1.4980 de acordo com EN 10269 (Gr. 660 B)

Acessórios

Tampa de proteção

Aço inoxidável, 1.4404 (316L)

Condicionador de fluxo

- Aço inoxidável, múltiplas certificações 1.4404 (316, 316L)
- Em conformidade com:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

Conexões de processo

Classificações de pressão PN 160/250, Classe 900/1500:

Material de aço inoxidável, com tripla certificação 1.4404/F316/F316L

 Conexões de processo disponíveis

16.11 Operabilidade

Idiomas



Podem ser operados nos seguintes idiomas:

- Através do display local:
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, holandês, português, polonês, russo, sueco, turco, chinês, japonês, coreano, bahasa (indonésio), vietnamita, tcheco, sueco
- Através da ferramenta de operação "FieldCare":
Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, chinês, japonês

Operação local

Através do módulo do display

Dois módulos de display estão disponíveis:

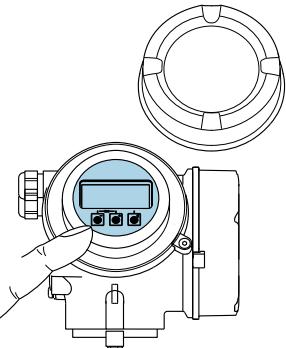Código do pedido para "Display; Operação", opção C "SD02"	Código do pedido para "Display; Operação", opção E "SD03"
 A0032219	 A0032221
1 Operação com botões	1 Operação com controle touchscreen

Elementos do display

- Display gráfico, iluminado, 4 linhas
- Iluminação branca de fundo: muda para vermelha no caso de falhas do equipamento
- O formato para exibição das variáveis medidas e variáveis de status pode ser configurado individualmente

Elementos de operação


- Operação com 3 botões com invólucro aberto: , ,  ou
- Operação externa através de controle touchscreen (3 chaves ópticas) sem abrir o invólucro: , , 
- Os elementos de operação também são acessíveis em diversas zonas das áreas classificadas

Funcionalidade adicional

- Função de cópia de segurança dos dados
A configuração do equipamento pode ser salva no módulo do display.
- Função de comparação de dados
A configuração do equipamento salva no módulo do display pode ser comparada à configuração do equipamento atual.
- Função da transferência de dados
A configuração do transmissor pode ser transmitida para outro equipamento por meio do módulo do display do transmissor.

Através de display remoto FHX50

 O display remoto FHX50 pode ser solicitado como um acessório opcional → 196.

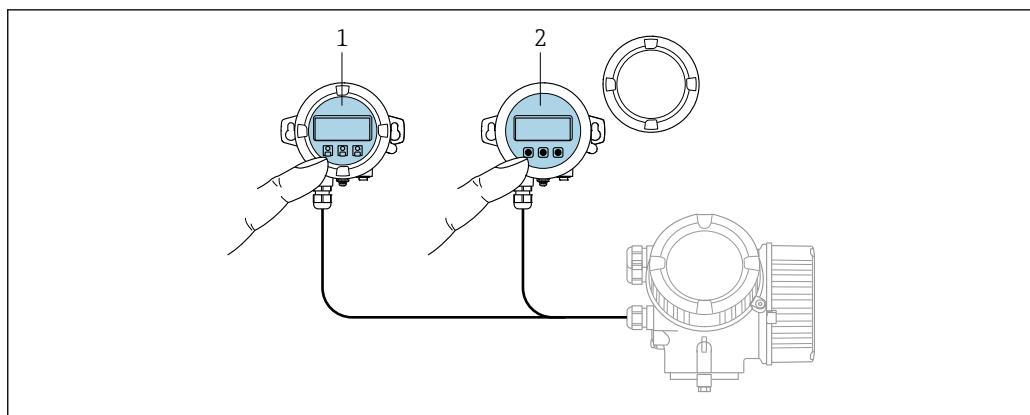

28 Opções de funcionamento do FHX50

- 1 Display SD02 e módulo de operação, botões de pressão: a tampa deve ser aberta para a operação
- 2 Display SD03 e módulo de operação, botões ópticos: operação possível através da tampa de vidro

Display e elementos de operação

O display e os elementos de operação correspondem àqueles do módulo do display .

Operação remota → 60

Interface de serviço → 61

16.12 Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
2. Abra a página do produto.
3. Selecione **Downloads**.

Identificação CE O equipamento atende as diretrizes legais das diretrizes da UE aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade UE correspondente junto com as normas aplicadas.

A Endress+Hauser confirma que o equipamento foi testado com sucesso ao afixar a identificação CE no produto.

Identificação UKCA O equipamento atende as especificações legais das regulamentações do Reino Unido (Instrumentos obrigatórios). Elas estão listadas na Declaração de conformidade UKCA juntamente com as normas designadas. Ao selecionar uma opção de encomenda para marcação UKCA, a Endress+Hauser confirma a avaliação e o teste bem-sucedidos do equipamento fixando a marcação UKCA.

Endereço de contato Endress+Hauser Reino Unido:

Endress+Hauser Ltd.

Floates Road
Manchester M23 9NF
Reino Unido
www.uk.endress.com

Identificação RCM	O sistema de medição atende às especificações EMC da "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Aprovação Ex	Os equipamentos têm certificado para uso em áreas classificadas e as instruções de segurança relevantes são fornecidas separadamente nas "Instruções de segurança" (XA). A etiqueta de identificação faz referência a este documento.
Certificação FOUNDATION Fieldbus	<p>Interface FOUNDATION Fieldbus</p> <p>O medidor é certificado e registrado pelo FieldComm Group. O sistema de medição atende aos requisitos das especificações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Certificado de acordo com o FOUNDATION Fieldbus H1 ■ Kit de teste de interoperabilidade (ITK), revisão versão 6.2.0 (certificado disponível sob encomenda) ■ Teste de conformidade da camada física ■ O equipamento também pode ser operado com equipamentos certificados de outros fabricantes (interoperabilidade)
Diretriz de equipamento de pressão	<ul style="list-style-type: none"> ■ Com a marcação <ul style="list-style-type: none"> a) PED/G1/x (x = categoria) ou b) PESR/G1/x (x = categoria) na placa de identificação do sensor, Endress+Hauser confirma a conformidade com os "Requisitos Essenciais de Segurança" <ul style="list-style-type: none"> a) especificado no anexo I da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão ou b) Anexo 2 dos Instrumentos Estatutários 2016 No. 1105. ■ Equipamentos que não apresentam esta marca (sem PED ou PESR) são designados e fabricados de acordo com as boas práticas de engenharia. Eles atendem aos requisitos de <ul style="list-style-type: none"> a) Art. 4 Parág. 3 da Diretriz de Equipamentos de Pressão 2014/68/UE b) Parte 1, Parág. 8 dos Instrumentos Estatutários 2016 nº 1105. O escopo de aplicação é indicado <ul style="list-style-type: none"> a) nos diagramas 6 a 9 no anexo II da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão ou b) Cronograma 3, Parág. 2 dos Instrumentos Estatutários 2016 nº 1105.
Experiência	O sistema de medição Prowirl 200 é o modelo subsequente do Prowirl 72 e do Prowirl 73.
Normas e diretrizes externas	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 60529 Graus de proteção fornecidos pelo invólucro (código IP) ■ DIN ISO 13359 Medição de vazão do líquido condutor em conduítes fechados - Comprimento geral ■ ISO 12764:2017 Medição de vazão de fluidos em conduítes fechados - Medição da taxa de vazão por meio de medidores de vazão de descarga de vórtice inseridos em conduítes de seção transversal circular que estão funcionando totalmente ■ EN 61010-1 Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório - requerimentos gerais ■ EN 61326-1/-2-3 Especificações EMC para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório ■ NAMUR NE 21 Compatibilidade Eletromagnética (EMC) de processo industrial e equipamento de controle de laboratório

- NAMUR NE 32
Retenção de dados em casos de uma falha na alimentação em campo e instrumentos de controle com microprocessadores
- NAMUR NE 43
Padronização do nível de sinal para informação de defeito de transmissores digitais com sinal de saída analógico.
- NAMUR NE 53
Software dos equipamentos de campo e equipamentos de processamento de sinal com componentes eletrônicos digitais
- NAMUR NE 105
Especificações para integração de equipamentos fieldbus em ferramentas de engenharia para equipamentos de campo
- NAMUR NE 107
Automonitoramento e diagnóstico de equipamentos de campo
- NAMUR NE 131
Especificações para equipamentos de campo para aplicações padrão
- ETSI EN 300 328
Diretrizes para componentes de rádio de 2,4 GHz.
- EN 301489
Compatibilidade eletromagnética e questões de espectro de rádio (ERM).

16.13 Pacotes de aplicação

Existem diversos pacotes de aplicação diferentes disponíveis para melhorar a funcionalidade do dispositivo. Estes pacotes podem ser necessários para tratar de aspectos de segurança ou exigências específicas de alguma aplicação.

Os pacotes de aplicação podem ser solicitados com o equipamento ou subsequentemente através da Endress+Hauser. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em nosso centro de vendas local Endress+Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

 Informações detalhadas sobre os pacotes de aplicação:
Documentação especial → [228](#)

16.14 Acessórios

 Visão geral dos acessórios disponíveis para pedido → [196](#)

16.15 Documentação

-  Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:
- *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação
 - *Aplicativo de operações da Endress+Hauser*: Insira o número de série que está na etiqueta de identificação ou escaneie o QR code.

Medidor	Código da documentação
Prowirl O 200	KA01324D

Resumo das instruções de operação para o transmissor

Instrumento de medição	Código da documentação
Prowirl 200	KA01327D

Informações técnicas

Medidor	Código da documentação
Prowirl O 200	TI01334D

Descrição dos parâmetros do equipamento

Instrumento de medição	Código da documentação
Prowirl 200	GP01111D

Documentação complementar específica para cada equipamento

Instruções de segurança

Conteúdo	Código da documentação
ATEX/IECEx Ex d	XA01635D
ATEX/IECEx Ex ia	XA01636D
ATEX/IECEx Ex ec, Ex ic	XA01637D
cCSA _{US} XP	XA01638D
cCSA _{US} IS	XA01639D
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex ia	XA01782D
EAC Ex ec, Ex ic	XA01685D
INMETRO Ex d	XA01642D
INMETRO Ex ia	XA01640D
INMETRO Ex ec, Ex ic	XA01641D
JPN Ex d	XA01766D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex ia	XA01644D
NEPSI Ex ec, Ex ic	XA01645D
UKEX Ex d	XA02630D
UKEX Ex ia	XA02631D
UKEX Ex ec, Ex ic	XA02632D

Documentação especial

Conteúdo	Código da documentação
Informações sobre a Diretriz dos Equipamentos sob Pressão	SD01614D
Heartbeat Technology	SD02030D
Tampa de proteção	SD00333F

Instruções de instalação

Conteúdo	Observação
Instruções de instalação para conjuntos de peças sobressalentes e acessórios	<ul style="list-style-type: none">■ Acesse as características gerais de todos os conjuntos de peças de reposição disponíveis através do <i>Device Viewer</i> → 193■ Acessórios disponíveis para pedido com Instruções de instalação → 196

Índice

A

Acesso direto	56
Acesso para gravação	59
Acesso para leitura	59
Adaptação do comportamento de diagnóstico	147
Adaptação do sinal de status	148
Ajuste de parâmetro	
Adaptação do medidor às condições de processo .	136
Administração	113
Ajuste do sensor	100
Compensação externa	98
Composição do gás	88
Configurações de display avançadas	109
Corte vazão baixo	83
Display local	80
Entrada analógica	80
Gerenciamento da configuração do equipamento	112
Idioma de operação	71
Meio	77
Propriedades do meio	85
Redefinir o equipamento	189
Reinicialização do totalizador	136
Reinic peace o equipamento	189
Restabelecer o totalizador	136
Saída comutada	105
Saída de pulso	102
Saída de pulso/frequência/comutada	102, 103
Simulação	114
Tag do equipamento	72
Totalizador	107
Unidades do sistema	73
Ajustes dos parâmetros	
Administração (Submenu)	113
Ajuste do sensor (Submenu)	100
Analog inputs (Submenu)	80
Compensação externa (Submenu)	98
Composição Gas (Submenu)	88
Configuração (Menu)	72
Corte de vazão baixa (Assistente)	83
Diagnóstico (Menu)	185
Exibição do backup de configuração (Submenu) .	112
Exibir (Assistente)	80
Exibir (Submenu)	109
Informações do equipamento (Submenu)	189
Manuseio do totalizador (Submenu)	136
Propriedades do meio (Submenu)	85
Registro de dados (Submenu)	137
Saída de pulso/frequência/chave (Assistente)	
.	102, 103, 105
Selecionar o meio (Assistente)	77
Simulação (Submenu)	114
Totalizador (Submenu)	134
Totalizador 1 para n (Submenu)	107
Unidades do sistema (Submenu)	73
Valores de saída (Submenu)	135
Variáveis de processo (Submenu)	132

Altura de operação	215
Aplicação	200
Applicator	201
Aprovação Ex	226
Aprovações	225
Área de status	
Na visualização de navegação	50
Para display de operação	48
Área do display	
Na visualização de navegação	51
Para display de operação	48
Arquivos de descrição do equipamento	65
Arquivos de descrição do equipamento (DD)	65
Assistência técnica da Endress+Hauser	
Manutenção	192
Reparos	194
Assistente	
Corte de vazão baixa	83
Exibir	80
Saída de pulso/frequência/chave	102, 103, 105
Selecionar o meio	77
Autorização de acesso aos parâmetros	
Acesso para gravação	59
Acesso para leitura	59
B	
Bloco Transdutor de DIAGNÓSTICO	186
C	
Cabo de conexão	32
Caminho de navegação (visualização de navegação) .	50
Campo de aplicação	
Risco residual	10
Características de desempenho	212
Certificação FOUNDATION Fieldbus	226
Certificados	225
Chave de proteção contra gravação	117
Classe climática	216
Classificações de pressão/temperatura	217
Código de acesso	59
Entrada incorreta	59
Código de pedido	14, 15, 16
Código de pedido estendido	
Sensor	16
Transmissor	15
Comissionamento	71
Configuração do medidor	72
Configurações avançadas	84
Compatibilidade eletromagnética	217
Componentes do equipamento	13
Comportamento de diagnóstico	
Explicação	144
Símbolos	144
Comunicador de campo	
Função	64
Comunicador de campo 475	64

Conceito de operação	47	Visualização para edição	52																																																																																																																																																																																																																						
Condições ambientes		Documentação	227																																																																																																																																																																																																																						
Altura de operação	215	Documento																																																																																																																																																																																																																							
Resistência à vibração e resistência a choque	216	Temperatura ambiente	25	Função	6	Temperatura de armazenamento	216	Símbolos	6	Condições de armazenamento	20	E		Condições de operação de referência	212	Editor de texto	52	Condições do processo		Editor numérico	52	Perda de pressão	218	Elementos de operação	53, 144	Temperatura do meio	217	Entrada	200	Conexão		Entrada para cabo		ver Conexão elétrica		Grau de proteção	43	Conexão do equipamento	37	Entradas para cabos		Conexão elétrica		Dados técnicos	211	Commubox FXA291	61	Equalização de potencial	43	Ferramentas de operação		Erro medido máximo	212	Através da interface de operação (CDI)	61	Escopo de função		Pela rede FOUNDATION Fieldbus	60	Comunicador de campo	64	Grau de proteção	43	Comunicador de campo 475	64	Instrumento de medição	32	Field Xpert	62	Configuração do idioma de operação	71	Especificações para o pessoal	9	Consumo de corrente	211	Esquema de ligação elétrica	34, 37	Consumo de energia	211	Estrutura		Corte vazão baixo	209	Menu de operação	46	D		Estrutura do bloco FOUNDATION Fieldbus	120	Dados da versão para o equipamento	65	Etiqueta de identificação		Dados de transmissão cíclica	65	Sensor	16	Dados técnicos, características gerais	200	Transmissor	15	Data de fabricação	15, 16	Exibição do registro de dados	137	Declaração de conformidade	10	Experiência	226	Definir o código de acesso	117	F		Desabilitação da proteção contra gravação	116	Faixa de função		Descarte	194	Gerenciador de equipamento AMS	64	Descarte de embalagem	21	Faixa de medição	201	Design		Faixa de temperatura		Medidor	13	Temperatura de armazenamento	20	Device Viewer	193	Faixa de temperatura ambiente	25	DeviceCare	63	Faixa de temperatura de armazenamento	216	Arquivo de descrição do equipamento (DD)	65	Faixa de temperatura média	217	Devolução	194	Faixa de vazão operável	206	Diagnóstico		Falha na fonte de alimentação	211	Símbolos	143	Ferramenta		Dica de ferramenta		Transporte	20	ver Texto de ajuda		Ferramentas		Dimensões de instalação	25	Conexão elétrica	32	ver Dimensões de instalação		Instalação	28	Direção (vertical, horizontal)	22	Ferramentas de conexão	32	Direção da vazão	22	Ferramentas de montagem	28	Diretriz de equipamento de pressão	226	Field Xpert		Display		Função	62	ver Display local		Field Xpert SFX350	62	Display de operação	48	FieldCare	62	Display local	224	Arquivo de descrição do equipamento (DD)	65	ver Display de operação		Estabelecimento da conexão	62	ver Em estado de alarme		Função	62	ver Mensagem de diagnóstico		Interface do usuário	63	Visualização de navegação	50	Filtragem do registro de evento	188
Temperatura ambiente	25	Função	6																																																																																																																																																																																																																						
Temperatura de armazenamento	216	Símbolos	6																																																																																																																																																																																																																						
Condições de armazenamento	20	E																																																																																																																																																																																																																							
Condições de operação de referência	212	Editor de texto	52																																																																																																																																																																																																																						
Condições do processo		Editor numérico	52																																																																																																																																																																																																																						
Perda de pressão	218	Elementos de operação	53, 144																																																																																																																																																																																																																						
Temperatura do meio	217	Entrada	200																																																																																																																																																																																																																						
Conexão		Entrada para cabo																																																																																																																																																																																																																							
ver Conexão elétrica		Grau de proteção	43																																																																																																																																																																																																																						
Conexão do equipamento	37	Entradas para cabos																																																																																																																																																																																																																							
Conexão elétrica		Dados técnicos	211																																																																																																																																																																																																																						
Commubox FXA291	61	Equalização de potencial	43																																																																																																																																																																																																																						
Ferramentas de operação		Erro medido máximo	212																																																																																																																																																																																																																						
Através da interface de operação (CDI)	61	Escopo de função																																																																																																																																																																																																																							
Pela rede FOUNDATION Fieldbus	60	Comunicador de campo	64																																																																																																																																																																																																																						
Grau de proteção	43	Comunicador de campo 475	64																																																																																																																																																																																																																						
Instrumento de medição	32	Field Xpert	62																																																																																																																																																																																																																						
Configuração do idioma de operação	71	Especificações para o pessoal	9																																																																																																																																																																																																																						
Consumo de corrente	211	Esquema de ligação elétrica	34, 37																																																																																																																																																																																																																						
Consumo de energia	211	Estrutura																																																																																																																																																																																																																							
Corte vazão baixo	209	Menu de operação	46																																																																																																																																																																																																																						
D		Estrutura do bloco FOUNDATION Fieldbus	120																																																																																																																																																																																																																						
Dados da versão para o equipamento	65	Etiqueta de identificação																																																																																																																																																																																																																							
Dados de transmissão cíclica	65	Sensor	16																																																																																																																																																																																																																						
Dados técnicos, características gerais	200	Transmissor	15																																																																																																																																																																																																																						
Data de fabricação	15, 16	Exibição do registro de dados	137																																																																																																																																																																																																																						
Declaração de conformidade	10	Experiência	226																																																																																																																																																																																																																						
Definir o código de acesso	117	F																																																																																																																																																																																																																							
Desabilitação da proteção contra gravação	116	Faixa de função																																																																																																																																																																																																																							
Descarte	194	Gerenciador de equipamento AMS	64																																																																																																																																																																																																																						
Descarte de embalagem	21	Faixa de medição	201																																																																																																																																																																																																																						
Design		Faixa de temperatura																																																																																																																																																																																																																							
Medidor	13	Temperatura de armazenamento	20																																																																																																																																																																																																																						
Device Viewer	193	Faixa de temperatura ambiente	25																																																																																																																																																																																																																						
DeviceCare	63	Faixa de temperatura de armazenamento	216																																																																																																																																																																																																																						
Arquivo de descrição do equipamento (DD)	65	Faixa de temperatura média	217																																																																																																																																																																																																																						
Devolução	194	Faixa de vazão operável	206																																																																																																																																																																																																																						
Diagnóstico		Falha na fonte de alimentação	211																																																																																																																																																																																																																						
Símbolos	143	Ferramenta																																																																																																																																																																																																																							
Dica de ferramenta		Transporte	20																																																																																																																																																																																																																						
ver Texto de ajuda		Ferramentas																																																																																																																																																																																																																							
Dimensões de instalação	25	Conexão elétrica	32																																																																																																																																																																																																																						
ver Dimensões de instalação		Instalação	28																																																																																																																																																																																																																						
Direção (vertical, horizontal)	22	Ferramentas de conexão	32																																																																																																																																																																																																																						
Direção da vazão	22	Ferramentas de montagem	28																																																																																																																																																																																																																						
Diretriz de equipamento de pressão	226	Field Xpert																																																																																																																																																																																																																							
Display		Função	62																																																																																																																																																																																																																						
ver Display local		Field Xpert SFX350	62																																																																																																																																																																																																																						
Display de operação	48	FieldCare	62																																																																																																																																																																																																																						
Display local	224	Arquivo de descrição do equipamento (DD)	65																																																																																																																																																																																																																						
ver Display de operação		Estabelecimento da conexão	62																																																																																																																																																																																																																						
ver Em estado de alarme		Função	62																																																																																																																																																																																																																						
ver Mensagem de diagnóstico		Interface do usuário	63																																																																																																																																																																																																																						
Visualização de navegação	50	Filtragem do registro de evento	188																																																																																																																																																																																																																						

Firmware	
Data de lançamento	65
Versão	65
Função do documento	6
Funções	
ver Parâmetros	
Funções do usuário	47
G	
Gerenciador de equipamento AMS	64
Função	64
Gerenciamento da configuração do equipamento	112
Giro do invólucro do transmissor	30
Giro do invólucro dos componentes eletrônicos	
ver Giro do invólucro do transmissor	
Giro do módulo do display	30
Grau de proteção	43, 216
H	
Habilitação da proteção contra gravação	116
Habilitação e desabilitação do bloqueio do teclado	60
Histórico do firmware	191
HistoROM	112
I	
ID do fabricante	65
ID do tipo de equipamento	65
Identificação CE	10, 225
Identificação do instrumento de medição	14
Identificação RCM	226
Identificação UKCA	225
Idiomas, opções de operação	223
Influência	
Temperatura ambiente	215
Informações de diagnóstico	
Design, descrição	144, 146
DeviceCare	145
Display local	143
FieldCare	145
Medidas corretivas	152
Visão geral	152
Informações sobre este documento	6
Inspeção	
Conexão	43
Instalação	31
Produtos recebidos	14
Instalação	22
Instrumento de medição	
Instalação do sensor	28
Preparação da conexão elétrica	36
Integração do sistema	65
Interface de usuário	
Evento de diagnóstico anterior	185
Evento de diagnóstico atuais	185
Isolamento galvânico	209
Isolamento térmico	26
L	
Leitura dos valores medidos	131
M	
Limpeza	
Limpeza externa	192
Limpeza interior	192
Substituição das vedações	192
Substituição das vedações do invólucro	192
Substituição das vedações do sensor	192
Limpeza externa	192
Limpeza interior	192
Lista de diag	186
Lista de eventos	187
Lista de verificação	
Verificação pós-conexão	43
Verificação pós-montagem	31
Local de instalação	22
Localização de falhas	
Geral	141
Marcas comerciais registradas	8
Materiais	221
Medição e teste do equipamento	192
Medidas corretivas	
Fechamento	145
Recorrer	145
Medidor	
Acionar	71
Configuração	72
Conversão	193
Descarte	195
Design	13
Preparação para instalação	28
Removendo	195
Reparos	193
Mensagem de diagnóstico	143
Mensagens de erro	
ver Mensagens de diagnóstico	
Menu	
Configuração	72
Diagnóstico	185
Menu de contexto	
Explicação	54
Fechamento	54
Recorrer	54
Menu de operação	
Estrutura	46
Menus, submenus	46
Submenus e funções de usuário	47
Menus	
Para a configuração para medidor	72
Para configurações específicas	84
Minisseletoras	
ver Chave de proteção contra gravação	
Módulo dos componentes eletrônicos de E/S	13, 37
Módulo dos componentes eletrônicos principais	13
N	
Netilion	192
Nome do equipamento	
Sensor	16

Transmissor	15	Revisão DD	65
Normas e diretrizes	226	Revisão do equipamento	65
Número de série	15, 16	S	
O		Segurança	9
Opções de operação	45	Segurança da operação	10
Operação	131	Segurança do produto	10
Operação remota	225	Segurança no local de trabalho	10
Operações de entrada	23	Sensor	
Operações de saída	23	Instalação	28
P		Símbolos	
Parâmetros		Na área de status do display local	48
Alterar	58	No editor de texto e numérico	52
Inserir valor	58	Para assistentes	51
Peças de reposição	193	Para bloqueio	48
Perda de pressão	218	Para comportamento de diagnóstico	48
Peso		Para comunicação	48
Condicionador de vazão	220	Para correção	52
Transporte (observação)	20	Para menus	51
Versão compacta	218	Para número do canal de medição	48
Unidades SI	218	Para parâmetros	51
Unidades US	219	Para sinal de status	48
Versão remota do sensor		Para submenu	51
Unidades SI	219	Para variável medida	48
Unidades US	220	Sinais de status	143, 146
Preparação da conexão	36	Sinal de saída	207
Preparações de instalação	28	Sinal em alarme	208
Pressão nominal		Sistema de medição	200
Sensor	218	Status de bloqueio do equipamento	131
Princípio de medição	200	Submenu	
Projeto do sistema		Administração	113
Sistema de medição	200	Ajuste do sensor	100
ver Projeto do medidor		Analog inputs	80
Proteção contra ajustes de parâmetro	116	Compensação externa	98
Proteção contra gravação		Composição Gas	88
Através de código de acesso	116	Configuração avançada	84
Por meio da chave de proteção contra gravação	117	Exibição do backup de configuração	112
Por meio de operação do bloco	119	Exibir	109
Proteção contra gravação de hardware	117	Informações do equipamento	189
R		Lista de eventos	187
Recalibração	192	Manuseio do totalizador	136
Recebimento	14	Propriedades do meio	85
Registrador de linha	137	Registro de dados	137
Registro de eventos	187	Simulação	114
Reparo	193	Totalizador	134
Notas	193	Totalizador 1 para n	107
Reparo de um equipamento	193	Unidades do sistema	73
Reparo do equipamento	193	Valores de saída	135
Repetibilidade	215	Variáveis de processo	131, 132
Requisitos de instalação		Visão geral	47
Dimensões de instalação	25	Substituição	
Isolamento térmico	26	Componentes do equipamento	193
Local de instalação	22	Substituição das vedações	192
Operações de entrada e saída	23	T	
Orientação	22	Tarefas de manutenção	192
Resistência à vibração e resistência a choque	216	Teclas de operação	
Revisão CFF	65	ver Elementos de operação	

Temperatura ambiente	
Influência	215
Temperatura de armazenamento	20
Tempo de reposta	215
Tensão de alimentação	36, 210
Terminais	211
Texto de ajuda	
Explicação	57
Fechamento	57
Recorrer	57
Totalizador	
Configuração	107
Transmissor	
Conexão dos cabos de sinal	37
Girar o invólucro	30
Giro do módulo do display	30
Transporte do instrumento de medição	20

U

Unidade de alimentação	
Especificações	36
Uso do instrumento de medição	
ver Uso indicado	
Uso do medidor	
Casos fronteiriços	9
Uso indevido	9
Uso indicado	9

V

Valores do display	
Para status de bloqueio	131
Variáveis de medição	
Calculadas	200
Medida	200
ver Variáveis do processo	
Variáveis de saída	207
Verificação da função	71
Verificação pós-conexão (checklist)	43
Verificação pós-instalação	71
Verificação pós-montagem (checklist)	31
Versão remota	
Ligaçāo do cabo de conexão	38
Visualização de navegação	
No assistente	50
No submenu	50
W	
W@M Device Viewer	14



71709042

www.addresses.endress.com
