


Manuel de mise en service

Memosens CCS55D

Capteur numérique avec technologie Memosens
pour la détermination du brome libre

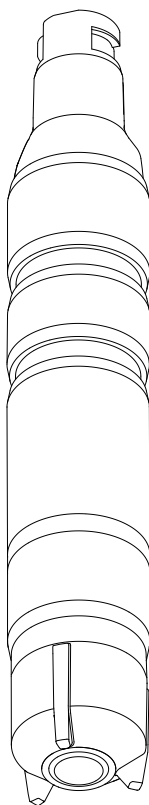

Sommaire

1 Informations relatives au document	4	10.2 Retour de matériel	42
1.1 Mises en garde	4	10.3 Mise au rebut	42
1.2 Symboles utilisés	4	11 Accessoires	43
2 Consignes de sécurité de base	6	11.1 Kit de maintenance CCV05	43
2.1 Exigences imposées au personnel	6	11.2 Accessoires spécifiques à l'appareil	43
2.2 Utilisation conforme	6	12 Caractéristiques techniques ..	45
2.3 Sécurité du travail	6	12.1 Entrée	45
2.4 Sécurité de fonctionnement	7	12.2 Performances	45
2.5 Sécurité du produit	7	12.3 Environnement	47
3 Description du produit	8	12.4 Process	47
3.1 Construction de l'appareil	8	12.5 Construction mécanique	48
4 Réception des marchandises et identification du produit ...	14	13 Installation et fonctionnement dans un environnement explosible de Classe I Div. 2	49
4.1 Réception des marchandises	14	Index	51
4.2 Identification du produit	14		
5 Montage	17		
5.1 Conditions de montage	17		
5.2 Montage du capteur	19		
5.3 Contrôle du montage	27		
6 Raccordement électrique	28		
6.1 Raccordement du capteur	28		
6.2 Garantir l'indice de protection	28		
6.3 Contrôle du raccordement	29		
7 Mise en service	30		
7.1 Contrôle du fonctionnement	30		
7.2 Polarisation du capteur	30		
7.3 Étalonnage du capteur	30		
8 Diagnostic et suppression des défauts	32		
9 Maintenance	34		
9.1 Plan de maintenance	34		
9.2 Opérations de maintenance	35		
10 Réparation	42		
10.1 Pièces de rechange	42		

1 Informations relatives au document


1.1 Mises en garde

Structure de l'information	Signification
 DANGER Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non-respect ▶ Mesure corrective	Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela aura pour conséquence des blessures graves pouvant être mortelles.
 AVERTISSEMENT Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non-respect ▶ Mesure corrective	Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela pourra avoir pour conséquence des blessures graves pouvant être mortelles.
 ATTENTION Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non-respect ▶ Mesure corrective	Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela pourra avoir pour conséquence des blessures de gravité moyenne à légère.
 AVIS Cause / Situation Conséquences en cas de non-respect ▶ Mesure / Remarque	Cette information attire l'attention sur des situations qui pourraient occasionner des dégâts matériels.

1.2 Symboles utilisés

Symbole	Signification
	Informations complémentaires, conseil
	Autorisé ou recommandé
	Non autorisé ou non recommandé
	Renvoi à la documentation de l'appareil
	Renvoi à la page
	Renvoi au schéma
	Résultat d'une étape

1.2.1 Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification
	Renvoi à la documentation de l'appareil
	Profondeur d'immersion minimale

2 Consignes de sécurité de base

2.1 Exigences imposées au personnel

Le montage, la mise en service, la configuration et la maintenance du dispositif de mesure ne doivent être confiés qu'à un personnel spécialisé et qualifié.

- ▶ Ce personnel qualifié doit être autorisé par l'exploitant de l'installation en ce qui concerne les activités citées.
- ▶ Seuls des électriciens sont habilités à réaliser le raccordement électrique.
- ▶ Le personnel qualifié doit avoir lu et compris le présent manuel de mise en service et respecter les instructions y figurant.
- ▶ Les défauts sur le point de mesure doivent uniquement être éliminés par un personnel autorisé et spécialement formé.



Les réparations qui ne sont pas décrites dans le présent manuel de mise en service ne doivent être réalisées que par le fabricant ou le service après-vente.

2.2 Utilisation conforme

L'eau de mer, l'eau industrielle et l'eau de piscine peuvent être désinfectées en ajoutant des désinfectants appropriés tels que des dérivés inorganiques du brome. La quantité dosée doit être adaptée aux variations continues des conditions d'utilisation. Une concentration trop faible dans l'eau nuit à la qualité de la désinfection, tandis qu'une concentration trop élevée augmente inutilement les coûts et est source de corrosion et d'altération du goût et de l'odeur.

Le capteur a été spécialement conçu pour cette application et est utilisé pour la mesure continue du brome libre actif dans l'eau. En combinaison avec un ensemble de mesure et de régulation, il permet une régulation optimale de la désinfection.

Toute autre utilisation que celle décrite dans le présent manuel risque de compromettre la sécurité des personnes et du système de mesure complet et est, par conséquent, interdite.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'emploi prévu.

2.2.1 Environnement explosible conformément à cCSAus NI Cl. I, Div. 2 ¹⁾

- ▶ Tenir compte du schéma de contrôle et des conditions d'application spécifiées en annexe du présent manuel de mise en service et suivre les instructions.

2.3 Sécurité du travail

En tant qu'utilisateur, vous êtes tenu d'observer les prescriptions de sécurité suivantes :

- Instructions de montage
- Normes et directives locales

1) Uniquement en cas de raccordement au CM44x(R)-CD*

Immunité aux parasites CEM

- La compatibilité électromagnétique de l'appareil a été testée conformément aux normes internationales en vigueur pour le domaine industriel.
- L'immunité aux interférences indiquée n'est valable que pour un appareil raccordé conformément aux instructions du présent manuel.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Avant de mettre l'ensemble du point de mesure en service :

1. Vérifiez que tous les raccordements sont corrects.
2. Assurez-vous que les câbles électriques et les raccords de tuyau ne sont pas endommagés.
3. N'utilisez pas de produits endommagés, et protégez-les contre une mise en service involontaire.
4. Marquez les produits endommagés comme défectueux.

En cours de fonctionnement :

- ▶ Si les défauts ne peuvent pas être éliminés :
Les produits doivent être mis hors service et protégés contre une mise en service involontaire.

2.4.1 Instructions spéciales

- ▶ Ne pas utiliser les capteurs sous des conditions de process où les conditions osmotiques sont susceptibles de provoquer le passage des composants électrolytiques à travers la membrane et dans le process.

Une utilisation conforme du capteur dans les liquides ayant une conductivité d'au moins 10 nS/cm peut être considérée comme sûre en termes d'application.

2.5 Sécurité du produit


Ce produit a été construit et contrôlé dans les règles de l'art, il a quitté nos locaux dans un état technique parfait. Les directives et normes internationales en vigueur ont été respectées.

3 Description du produit

3.1 Construction de l'appareil

Le capteur est constitué des unités fonctionnelles suivantes :

- Cartouche à membrane (chambre de mesure avec membrane)
 - Sépare le système ampérométrique interne du produit
 - Avec une membrane PET robuste et une soupape de sécurité
 - Avec grille support spéciale entre l'électrode de travail et la membrane pour un film électrolytique constant et défini, et donc une indication relativement constante même à des pressions et des débits variables
- Corps du capteur avec
 - Grande contre-électrode
 - Électrode de travail encapsulée dans du plastique
 - Sonde de température intégrée

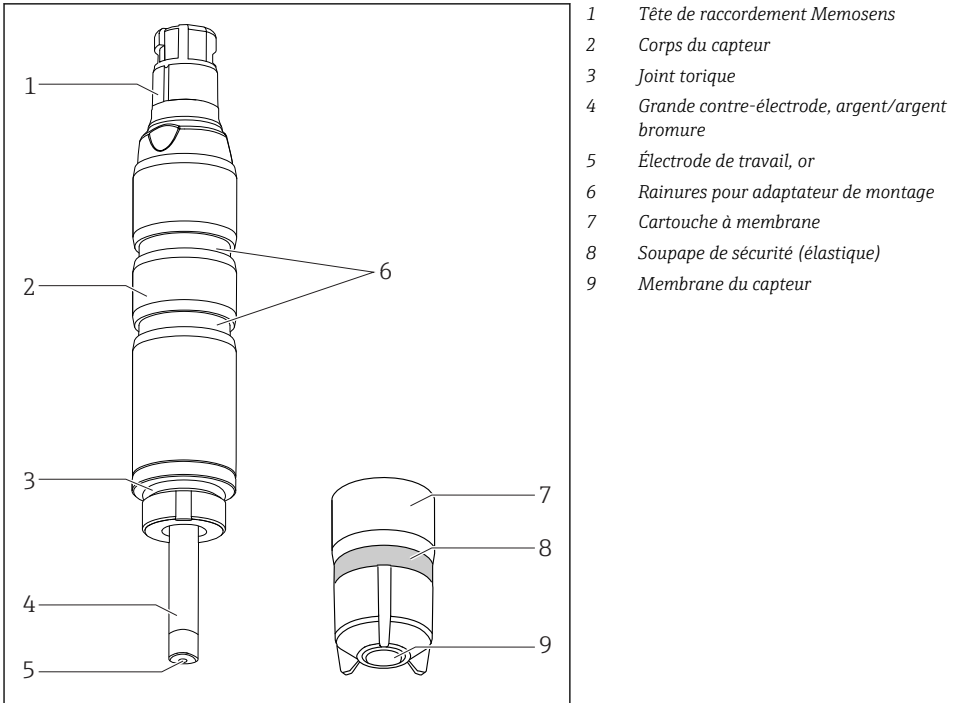

A0034227

1 Structure du capteur

3.1.1 Principe de mesure

Le brome libre est déterminé via l'acide hypobromeux (HOBr) selon le principe de mesure ampérométrique.

L'acide hypobromeux (HOBr) contenu dans le produit à travers la membrane du capteur et est réduit en ions bromure (Br^-) à l'électrode de travail en or. À la contre-électrode en argent, l'argent est oxydé en bromure d'argent. L'émission d'électrons à l'électrode de travail en or et l'acceptation d'électrons à la contre-électrode en argent font circuler un courant proportionnel à la concentration de brome libre dans le produit à des conditions constantes.

La concentration d'acide hypobromeux (HOBr) dépend de la valeur de pH. Une mesure additionnelle du pH doit être utilisée pour compenser cette dépendance.

Le transmetteur utilise le signal de courant en nA pour calculer la variable mesurée de concentration en mg/l (ppm).

Le capteur peut également mesurer les agents de bromation organiques. Pour ce faire, il est recommandé de procéder à un nouvel étalonnage lors de la mise en service.

3.1.2 Effets sur le signal mesuré

Valeur de pH

Dépendance du pH

Le brome moléculaire (Br_2) est présent à des valeurs de pH < 5 alors que l'acide hypobromeux (HOBr) et l'hypobromite (OBr^-) restent comme composants du brome libre dans la gamme de pH 5 à 11. Lorsque l'acide hypobromeux se sépare (se dissocie) avec un pH croissant pour former des ions hypobromite (OBr^-) et des ions hydrogène (H^+), les quantités des différents composants du brome actif libre changent avec le pH. Par exemple, si la part d'acide hypobromeux est de 97 % à pH 7, il chute d'env. 3 % à pH 10.

Lors de la mesure ampérométrique avec le capteur de brome, seul le taux d'acide hypobromeux (HOBr) est mesuré. Celui-ci a un fort pouvoir désinfectant dans les solutions aqueuses. L'effet désinfectant de l'hypobromite (OBr^-) est légèrement inférieur. De ce fait, lorsqu'il est utilisé comme désinfectant à des valeurs de pH très élevées, l'efficacité du brome est limitée.

Valeur de pH	Résultat
< 5	Le brome élémentaire est formé à partir de l'acide hypobromeux et se comporte différemment de l'acide hypobromeux lorsqu'il traverse la membrane. En outre, en présence d'ions chlorure, du chlorure de brome peut se former, ce qui peut également conduire à des résultats incorrects.
5 à 10	La compensation en pH fonctionne parfaitement dans cette gamme. Une valeur de concentration compensée en pH peut être spécifiée.
> 10	Le signal mesuré est très faible dans cette gamme, étant donné que le niveau d'acide hypobromeux présent est très bas. La valeur de concentration déterminée dépend principalement d'autres conditions du point de mesure.

Compensation en pH du signal du capteur de brome

Pour étalonner et contrôler l'ensemble de mesure de brome, il faut réaliser une mesure comparative colorimétrique selon la méthode DPD. Le brome libre réagit avec le diéthylène-paraphénylène-diamine (DPD) en formant un colorant rouge. L'intensité de la couleur rouge augmente proportionnellement à la teneur en brome. Pour le test DPD, l'échantillon est tamponné à une valeur de pH définie. C'est pourquoi la valeur de pH de l'échantillon n'est pas


prise en compte dans la mesure DPD. En raison du tamponnage dans la méthode DPD, toutes les parts de brome actif libre (HOBr et OBr^-) sont détectées pour mesurer le brome libre.

Le capteur de brome mesure les quantités d'acide hypobromeux et d'hypobromite. En cas de sélection de la compensation en pH dans le transmetteur, la somme de l'acide hypobromeux et de l'hypochlorite est calculée à partir du signal mesuré et du pH.



Lors de la mesure de brome libre avec compensation en pH active, l'étalonnage doit toujours être effectué en mode compensé en pH.

Avec la compensation en pH, la valeur de brome affichée et sortie par l'appareil correspond à la valeur DPD même en cas de variation du pH. En l'absence de compensation en pH, la valeur mesurée par le capteur peut uniquement correspondre à la valeur DPD si le pH du produit est maintenu constant à la valeur du pH au moment de l'étalonnage. Sans compensation en pH, l'ensemble de mesure de brome doit être réétalonné en cas de variation du pH.

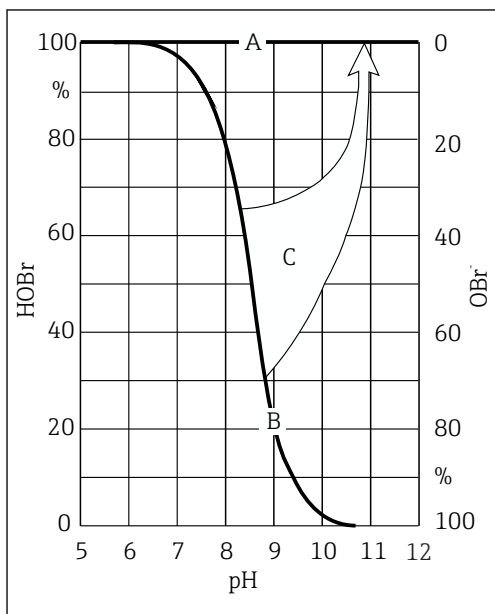

A0041314

2 Principe de la compensation en pH

- A Valeur mesurée avec compensation en pH
- B Valeur mesurée sans compensation en pH
- C Compensation en pH

Précision de la compensation en pH

La précision de la valeur de brome compensée en pH dépend de la somme de plusieurs écarts de mesure (brome libre, pH, température, mesure DPD, etc.).

Une part élevée d'acide hypobromeux (HOBr) lors de l'étalonnage du brome a un effet positif sur la précision, alors qu'une faible part a un effet négatif. L'imprécision de la valeur de brome

compensée en pH augmente plus la différence de pH entre la mesure et l'étalonnage du brome croît ou plus les valeurs mesurées individuelles sont imprécises.

Étalonnage tenant compte de la valeur de pH

Pour le test DPD, l'échantillon est tamponné à une valeur de pH définie, à laquelle le brome libre est presque exclusivement présent sous forme d'H₂OBr. En revanche, avec la mesure ampérométrique, la mesure est effectuée directement à la valeur du pH du produit. En fonction de la distribution d'H₂OBr/OBr⁻ à une valeur de pH donnée, le capteur mesure entièrement le composant H₂OBr et mesure partiellement l'OBr⁻.


Aux valeurs de pH supérieures à 7, il en résulte un courant de mesure inférieur. La compensation en pH a pour effet d'augmenter la valeur de brome mesurée à la valeur réelle du brome libre. L'étalonnage du système de mesure complet n'est possible que jusqu'à un pH moyen de 9.

Au-dessus de ces valeurs de pH, l'erreur totale de l'ensemble de mesure est importante.

Débit

La vitesse d'écoulement minimale au niveau de la cellule de mesure à membrane est de 16 cm/s (0,5 ft/s).

- En utilisant la chambre de passage Flowfit CCA151, la vitesse d'écoulement minimale correspond à un débit volumique de 5 l/h (1,3 gal/h).
- En utilisant la chambre de passage CCA250, la vitesse d'écoulement minimale correspond à un débit volumique de 30 l/h (7,9 gal/h) (bord supérieur du flotteur à la hauteur de la marque rouge).

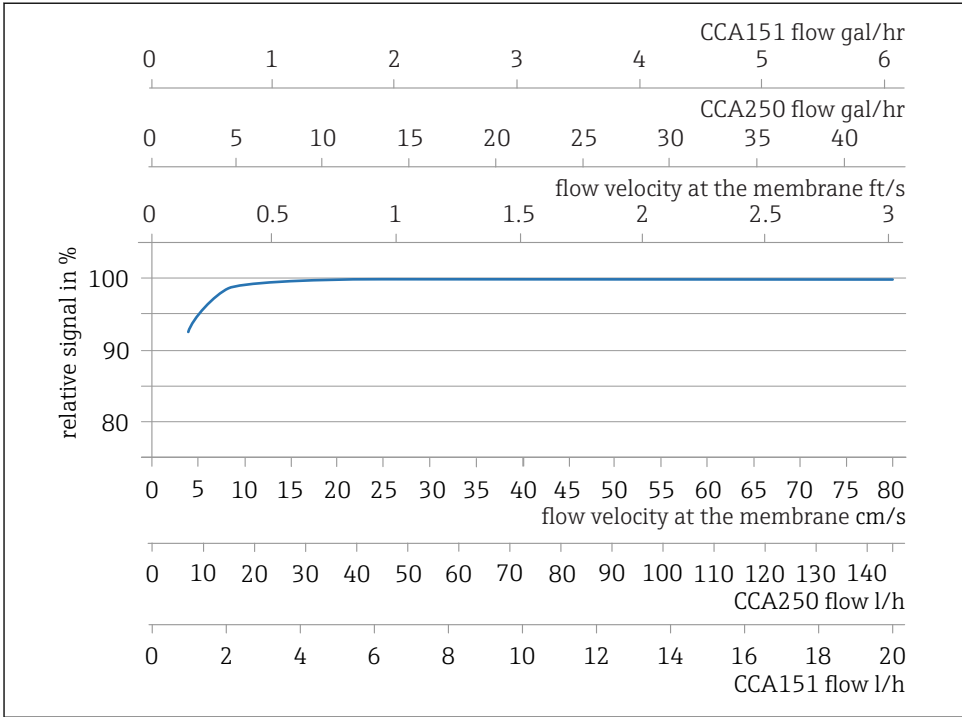

A0042802

- 3 *Corrélation entre la pente de l'électrode et la vitesse d'écoulement à la membrane / débit volumique dans la chambre de passage*

À des débits plus élevés, le signal mesuré est pratiquement indépendant de l'écoulement, alors que si le débit chute sous la valeur indiquée, le signal de mesure dépend du débit.

Le montage d'un capteur de position INS dans la chambre de passage permet de détecter avec fiabilité les débits trop faibles et d'émettre une alarme ou de bloquer le dosage en cas de besoin.

Sous le débit minimal, le courant au capteur est plus sensible aux fluctuations du débit. Pour les produits abrasifs, il est recommandé de ne pas dépasser le débit minimal. En présence de matières en suspension pouvant se déposer, le débit maximal est recommandé.

Température

Les variations de température du produit ont une influence sur le signal de mesure :

- Une augmentation de la température entraîne une augmentation de la valeur mesurée (env. 4 % par K)
- Une baisse de la température entraîne une diminution de la valeur mesurée.

L'utilisation du capteur en combinaison avec le Liquiline permet une compensation automatique de la température (ATC). Un réétalonnage en cas de changements de température n'est pas nécessaire.

1. Si la compensation de température automatique est désactivée au transmetteur, la température doit être maintenue à un niveau constant après l'étalonnage.
2. Sinon, réétalonner le capteur.

En cas de variations thermiques normales et lentes (0,3 K / minute), la sonde de température interne suffit.



Pour plus de détails sur l'utilisation de sondes de température externes, voir le manuel de mise en service du transmetteur.

Sensibilités transverses²⁾

Il y a des sensibilités transverses pour : brome total, chlore libre disponible, chlore total, dioxyde de chlore, ozone, peroxyde d'hydrogène et acide peracétique.

2) Les substances listées ont été testées avec différentes concentrations. Un effet additif n'a pas été étudié.

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

1. Vérifiez que l'emballage est intact.
 - ↳ Signalez tout dommage constaté sur l'emballage au fournisseur.
Conservez l'emballage endommagé jusqu'à la résolution du problème.
2. Vérifiez que le contenu est intact.
 - ↳ Signalez tout dommage du contenu au fournisseur.
Conservez les marchandises endommagées jusqu'à la résolution du problème.
3. Vérifiez que la livraison est complète et que rien ne manque.
 - ↳ Comparez les documents de transport à votre commande.
4. Pour le stockage et le transport, protégez l'appareil contre les chocs et l'humidité.
 - ↳ L'emballage d'origine assure une protection optimale.
Veillez à respecter les conditions ambiantes admissibles.

Pour toute question, adressez-vous à votre fournisseur ou à votre agence.

4.2 Identification du produit

4.2.1 Plaque signalétique

Sur la plaque signalétique se trouvent les informations suivantes relatives à l'appareil :

- Identification du fabricant
- Référence de commande étendue
- Numéro de série
- Consignes de sécurité et avertissements

- ▶ Comparer les indications figurant sur la plaque signalétique à la commande.

4.2.2 Page produit

www.fr.endress.com/ccs55d

4.2.3 Interprétation de la référence de commande

La référence de commande et le numéro de série de l'appareil se trouvent :

- sur la plaque signalétique
- dans les papiers de livraison

Obtenir des précisions sur le produit

1. Rendez-vous sur www.endress.com.
2. Cliquez sur Recherche (loupe).
3. Entrez un numéro de série valide.
4. Recherchez.
 - ↳ La structure du produit apparaît dans une fenêtre contextuelle.

5. Cliquez sur la photo du produit dans la fenêtre contextuelle.

- ↳ Une nouvelle fenêtre (**Device Viewer**) s'ouvre. Toutes les informations relatives à votre appareil s'affichent dans cette fenêtre, de même que la documentation du produit.

4.2.4 Adresse du fabricant

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 Contenu de la livraison

La livraison comprend :

- Capteur de désinfection (à membrane, Ø25 mm) avec capot de protection (prêt à l'emploi)
- Flacon avec électrolyte (50 ml (1,69 fl.oz))
- Cartouche à membrane de rechange dans le capot de protection
- Manuel de mise en service
- Certificat de réception du fabricant

4.2.6 Certificats et agréments

Marquage CE

Déclaration de conformité

Le système satisfait aux exigences des normes européennes harmonisées. Il est ainsi conforme aux prescriptions légales des directives UE. Par l'apposition du marquage **CE**, le fabricant certifie que le produit a passé les tests avec succès les différents contrôles.

Agréments marine

Une sélection d'appareils et de capteurs dispose d'une homologation de type pour applications marines délivrée par les sociétés de classification suivantes : ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd) et LR (Lloyd's Register). Les références de commande détaillées des appareils et capteurs agréés, ainsi que les conditions de montage et les conditions ambiantes, sont fournies dans les certificats pour applications marines correspondants, sur la page produit disponible sur Internet.

EAC

Le produit a été certifié conformément aux directives TP TC 004/2011 et TP TC 020/2011 qui s'appliquent dans l'Espace Economique Européen (EEE). Le marquage de conformité EAC est apposé sur le produit.

Agréments Ex ³⁾**cSAus NI Cl. I, Div. 2**

Ce produit est conforme aux exigences définies dans :

- UL 61010-1
- ANSI/ISA 12.12.01
- FM 3600
- FM 3611
- CSA C22.2 NO. 61010-1-12
- CSA C22.2 NO. 213-16
- Schéma de contrôle : 401204

3) Uniquement en cas de raccordement au CM44x(R)-CD*


5 Montage

5.1 Conditions de montage

5.1.1 Position de montage

Ne pas monter la tête en bas !


- ▶ Installer le capteur dans une chambre de passage, un support ou un raccord process approprié à un angle d'au moins 15° par rapport à l'horizontale.
- ▶ Tout autre angle d'inclinaison n'est pas autorisé.
- ▶ Suivre les instructions de montage du capteur, figurant dans le manuel de mise en service de la chambre de passage utilisée.

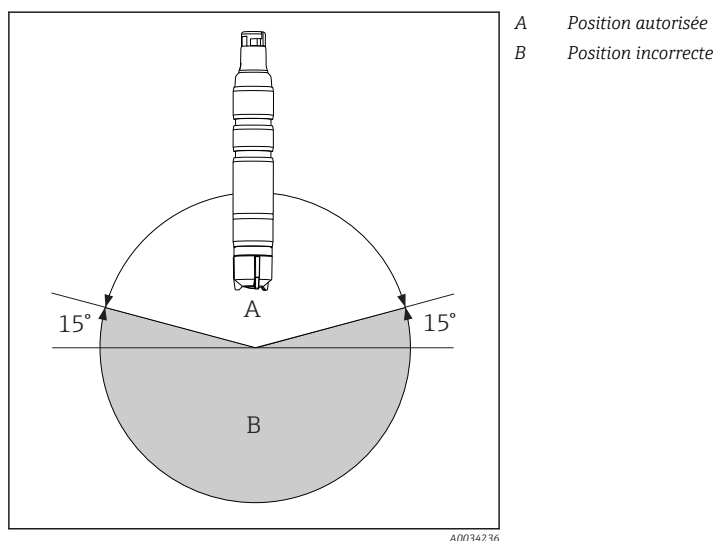

5.1.2 Profondeur d'immersion

50 mm (1,97 in)

5.1.3 Dimensions

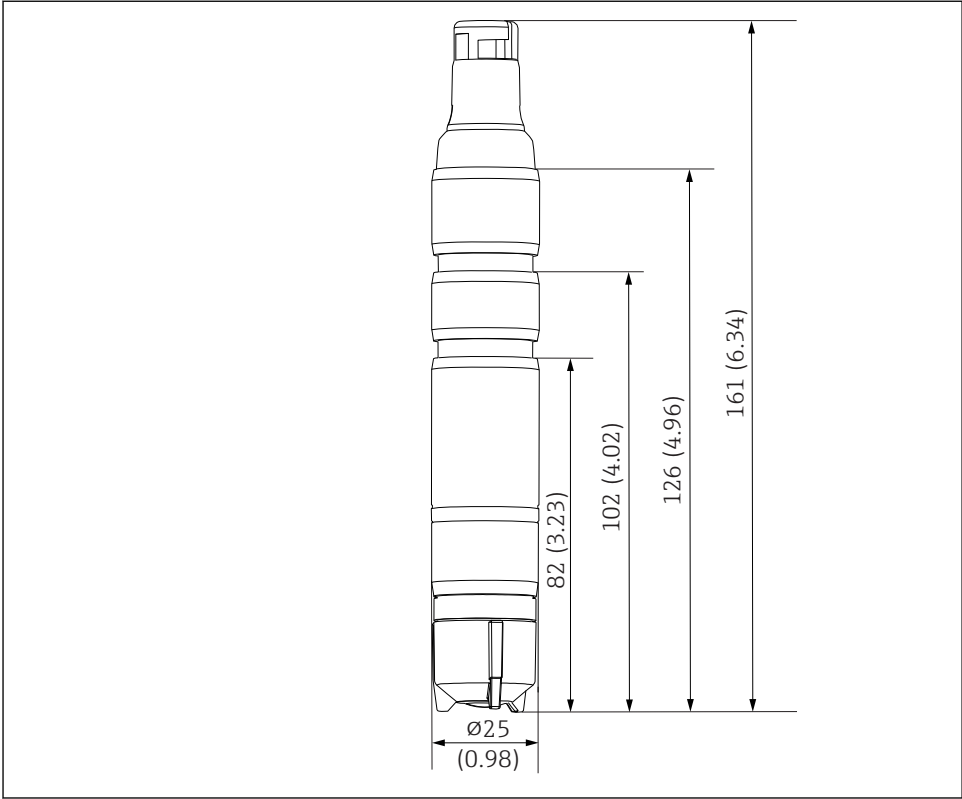

A0034238


4 Dimensions en mm (in)

5.2 Montage du capteur

5.2.1 Ensemble de mesure

L'ensemble de mesure complet comprend :

- Capteur CCS55D (à membrane, Ø25 mm) avec adaptateur de montage correspondant
- Chambre de passage Flowfit CCA250
- Câble de mesure CYK10, CYK20
- Transmetteur, p. ex. Liquiline CM44x avec version de firmware 01.07.03 ou plus ou CM44xR avec version de firmware 01.07.03 ou plus
- En option : capteur de pH CPS31D
- En option : câble prolongateur CYK11
- En option : capteur de position
- En option : chambre de passage Flowfit CCA151 (si le pH est fourni d'une autre manière)
- En option : support à immersion Flexdip CYA112 (si le pH est fourni d'une autre manière)

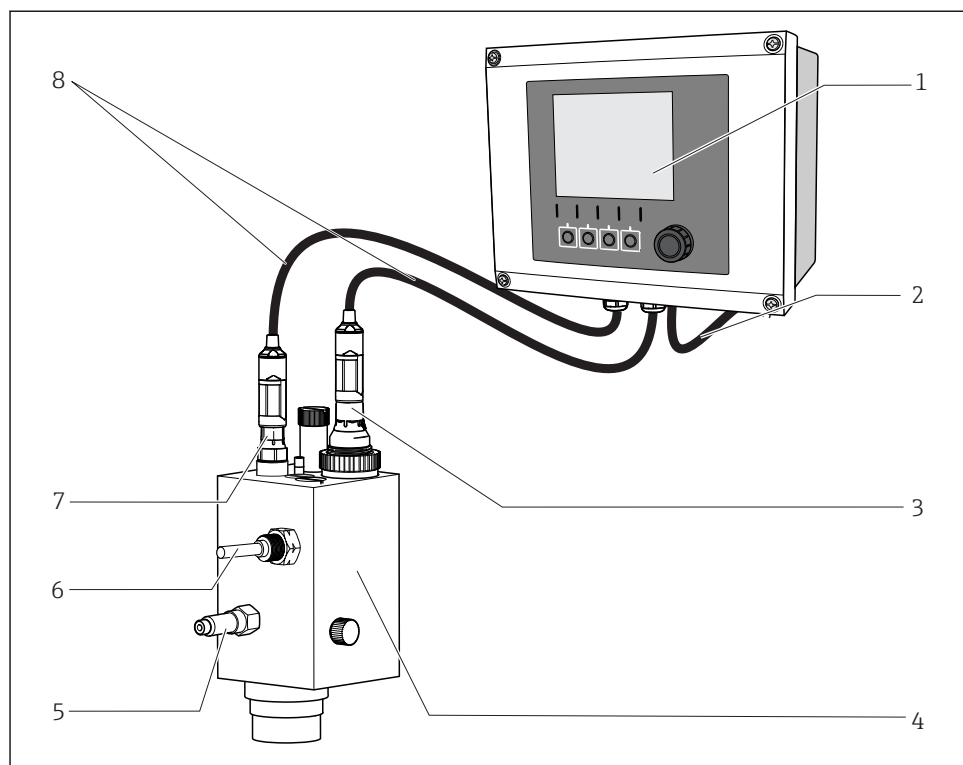

A0007341

5 Exemple d'un ensemble de mesure

- 1 Transmetteur Liquiline CM44x
- 2 Câble d'alimentation pour transmetteur
- 3 Capteur CCS55D (à membrane, Ø25 mm)
- 4 Chambre de passage Flowfit CCA250
- 5 Entrée de la chambre de passage Flowfit CCA250
- 6 Capteur de position (en option)
- 7 Capteur de pH CPS31D
- 8 Câble de mesure CYK10

5.2.2 Préparation du capteur


Retirer le capot de protection du capteur

AVIS

Une pression négative peut endommager la cartouche à membrane du capteur.

► Si le capot de protection est fixé, le retirer avec précaution du capteur.


1. À la livraison et lors du stockage, le capteur est équipé d'un capot de protection : pour commencer, dévisser uniquement la partie supérieure du capot de protection en la tournant.

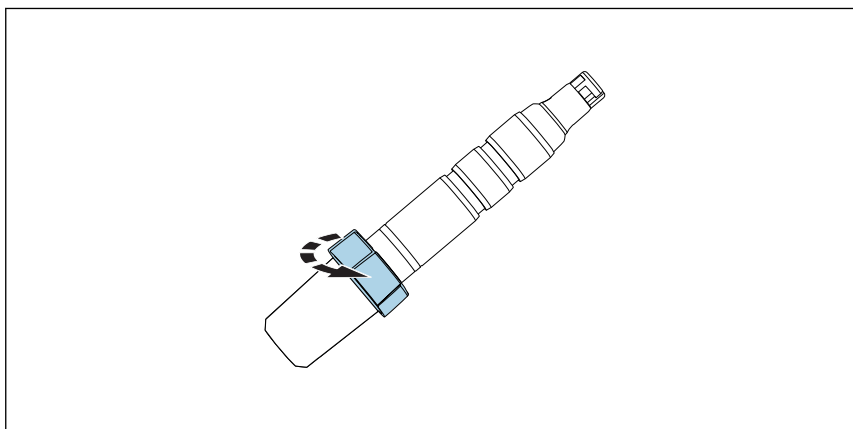

A0034263

-  6 Tourner pour dévisser la partie supérieure du capot de protection

2. Retirer avec précaution le capot de protection du capteur.

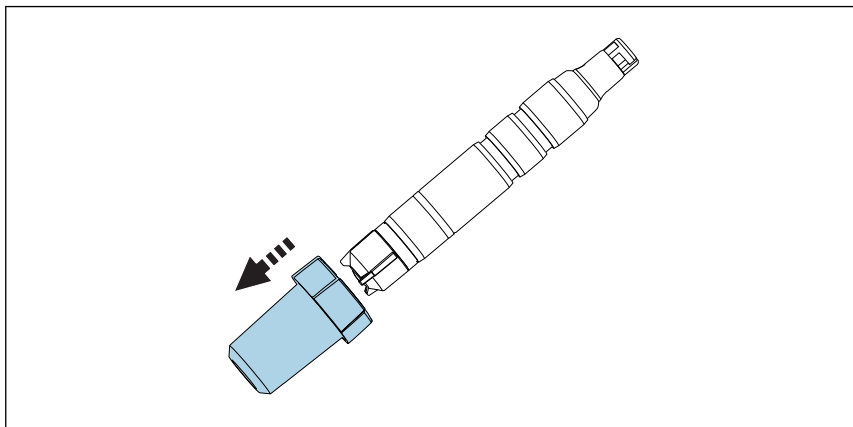

A0034350

-  7 Retirer avec précaution le capot de protection

5.2.3 Montage du capteur dans la chambre de passage CCA151

Le capteur (à membrane, Ø25 mm) est conçu pour être installé dans la chambre de passage Flowfit CCA151.


i Le capteur (à membrane, Ø25 mm) est conçu pour être installé dans la chambre de passage Flowfit CCA151 si le pH pour la compensation est fourni d'une autre manière.

Tenir compte des points suivants lors de l'installation :

- ▶ Le débit volumique doit être d'au moins 5 l/h (1,3 gal/h).
- ▶ Si le produit est réintroduit dans un bassin de débordement, une conduite ou autre, la contre-pression résultante sur le capteur ne doit pas dépasser 1 bar (14,5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.)) et doit rester constante.
- ▶ Il faut éviter toute pression négative au capteur, p. ex. installation sur le côté aspiration d'une pompe.
- ▶ Pour éviter le colmatage, il faut également filtrer l'eau fortement contaminée.

Préparation du support

1. À la livraison, la chambre de passage est munie d'un écrou-raccord vissé : dévisser l'écrou-raccord de la chambre de passage.

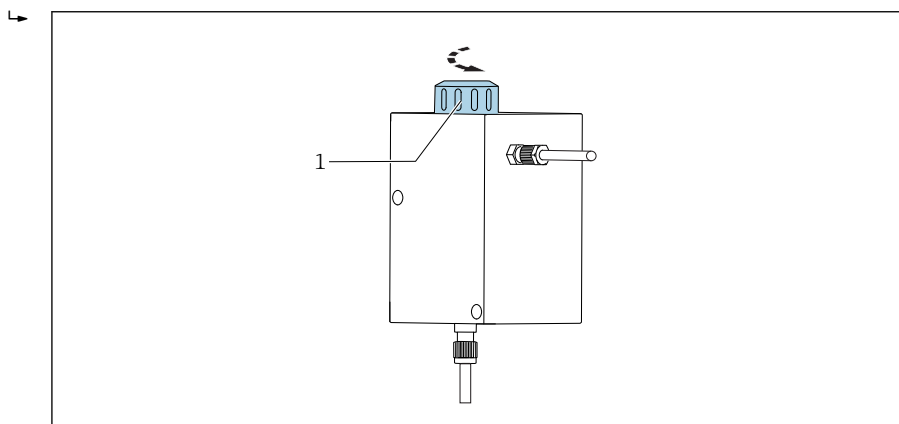

A0034262

8 Chambre de passage Flowfit CCA151


1 Écrou fou

2. À la livraison, la chambre de passage est munie d'un bouchon aveugle : retirer le bouchon aveugle de la chambre de passage.

Équipement du capteur avec un adaptateur

L'adaptateur nécessaire (bague de serrage, bague d'appui et joint torique) peut être commandé comme accessoire de capteur monté ou comme accessoire séparé →  44.

1. D'abord faire glisser la bague de serrage, puis la bague d'appui, puis le joint torique de la cartouche à membrane vers la tête du capteur et dans la rainure inférieure.

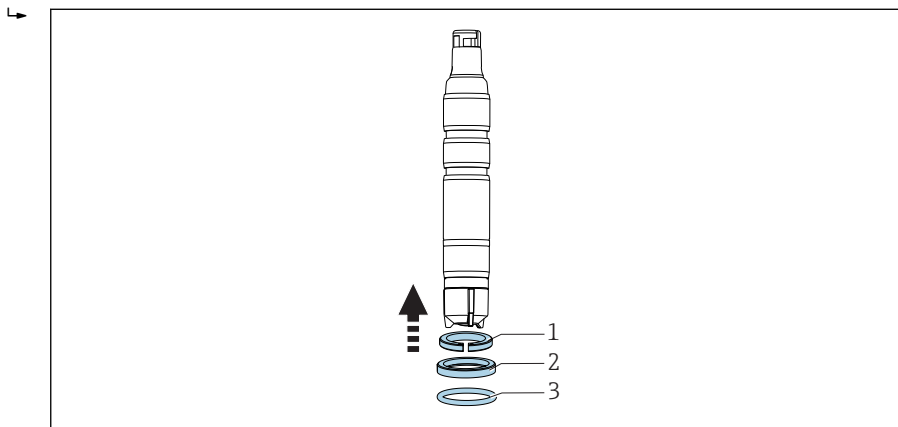


A0034247

-  9 *Faire glisser la bague de serrage (1), la bague d'appui (2) et le joint torique (3) vers le haut, de la cartouche à membrane vers la tige du capteur, puis dans la rainure inférieure.*

Installer le capteur dans la chambre de passage

2. Faire glisser le capteur avec l'adaptateur pour Flowfit CCA151 dans l'ouverture de la chambre de passage.

3. Visser l'écrou-raccord sur la chambre de passage sur le bloc.

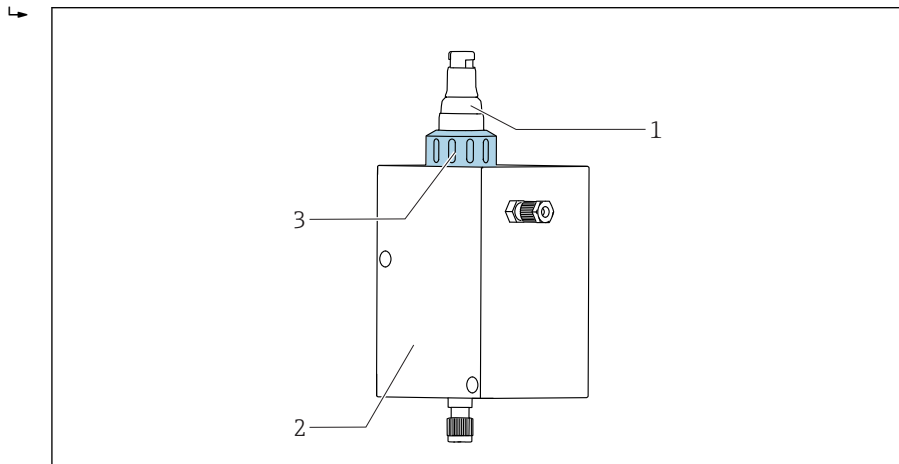

A0034261

10 Chambre de passage Flowfit CCA151

- 1 Capteur
- 2 Chambre de passage Flowfit CCA151
- 3 Écrou-raccord pour la fixation d'un capteur de désinfection

5.2.4 Montage du capteur dans la chambre de passage CCA250

Le capteur peut être installé dans la chambre de passage Flowfit CCA250. En plus de permettre l'installation d'un capteur pour le brome libre, cela permet également le fonctionnement simultané d'un capteur de pH et d'un capteur de redox, par exemple. Une vanne à boisseau régule le débit volumique dans la gamme de 30 ... 120 l/h (7,9 ... 31,7 gal/h).


Tenir compte des points suivants lors de l'installation :

- ▶ Le débit volumique doit être d'au moins 30 l/h (7,9 gal/h). Si le débit chute sous cette valeur ou s'arrête complètement, un capteur de position inductif le détecte et déclenche une alarme avec blocage des pompes doseuses.
- ▶ Si le produit est réintroduit dans un bassin de débordement, une conduite ou autre, la contre-pression résultante sur le capteur ne doit pas dépasser 1 bar (14,5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.)) et doit rester constante.
- ▶ Il faut éviter toute pression négative au capteur en installant, par exemple, le capteur sur une aspiration de pompe.

Équipement du capteur avec un adaptateur

L'adaptateur nécessaire peut être commandé comme accessoire du capteur ou comme accessoire séparé. →  44


1. Glisser l'adaptateur de la Flowfit CCA250 de la tête du capteur jusqu'à la butée du capteur.

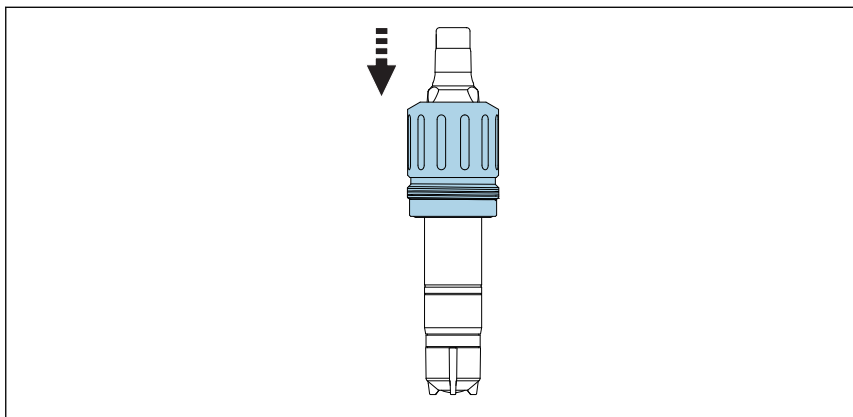

A0034245

 11 Glisser l'adaptateur de la Flowfit CCA250.

2. Fixer l'adaptateur à l'aide des 2 goujons filetés et d'une vis à six pans creux (2 mm).

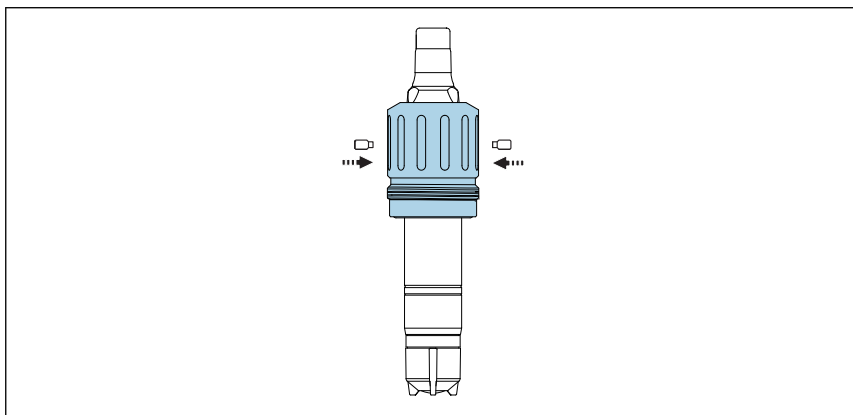

A0041320

3. Visser le capteur dans la chambre de passage.



Pour plus d'informations sur l'installation du capteur dans la chambre de passage FlowfitCCA250, voir le manuel de mise en service de la chambre de passage

5.2.5 Montage du capteur dans d'autres chambres de passage

En cas d'utilisation d'autres chambres de passage, s'assurer que :

- ▶ Une vitesse d'écoulement d'au moins 16 cm/s (0,52 ft/s) doit toujours être garantie au niveau de la membrane.
- ▶ L'écoulement se fait du bas vers le haut. Les bulles d'air transportées doivent être éliminées de sorte qu'elles ne s'accumulent pas devant la membrane..
- ▶ L'écoulement doit être dirigé vers la membrane.



Tenir compte des instructions de montage additionnelles, contenues dans le manuel de mise en service du support utilisé.

5.2.6 Montage du capteur dans le support à immersion CYA112

Il est également possible d'installer le capteur dans un support à immersion avec raccord fileté G1.




En cas d'utilisation d'une chambre de passage, s'assurer que le débit est suffisant vers le capteur → 11.

Équipement du capteur avec un adaptateur

L'adaptateur nécessaire peut être commandé comme accessoire du capteur ou comme accessoire séparé. → 44


1. Glisser l'adaptateur de la Flexdip CYA112 de la tête du capteur jusqu'à la butée du capteur.

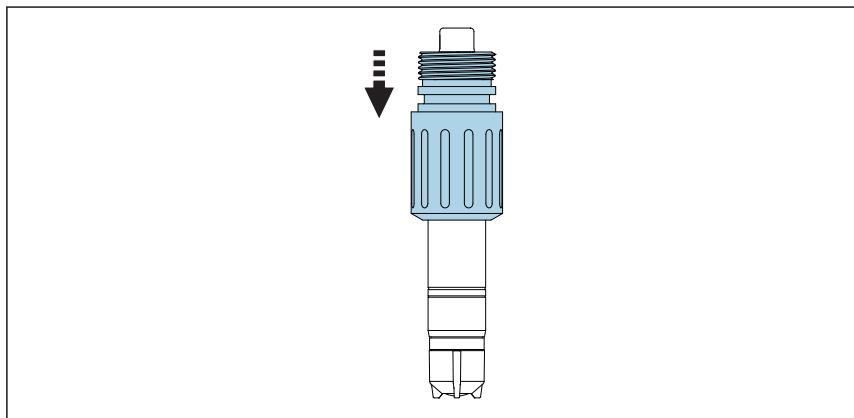

A0034246

- 12 Glisser l'adaptateur de la Flexdip CYA112.

2. Fixer l'adaptateur avec les 2 goujons filetés fournis et une vis à six pans creux (2 mm).

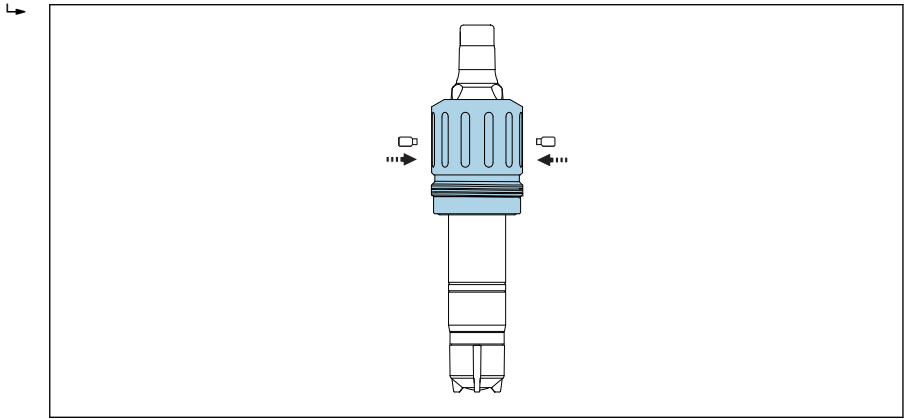

A0041320

3. Visser le capteur dans le support à immersion. L'utilisation d'une fixation rapide est recommandée.



Pour plus d'informations sur l'installation du capteur dans la chambre de passage FlexdipCYA112, voir le manuel de mise en service de la chambre de passage

5.3 Contrôle du montage

1. L'adaptateur est-il maintenu en place et incapable de bouger librement ?
2. Le capteur est-il installé dans une chambre de passage et pas suspendu par son câble ?
 - ↳ Installer le capteur dans une chambre de passage ou directement via le raccord process.
3. La cartouche à membrane est-elle étanche ?
 - ↳ Visser à fond ou remplacer.
4. La membrane est-elle intacte et plate : est-elle légèrement bombée (pas plate) ?
5. Y a-t-il de l'électrolyte dans la cartouche à membrane ?
 - ↳ Si nécessaire, remplir la cartouche à membrane d'électrolyte.

6 Raccordement électrique

⚠ ATTENTION


Appareil sous tension

Un raccordement non conforme peut entraîner des blessures !

- Seuls des électriciens sont habilités à réaliser le raccordement électrique.
- Les électriciens doivent avoir lu et compris le présent manuel de mise en service et respecter les instructions y figurant.
- **Avant** de commencer le raccordement, assurez-vous qu'aucun câble n'est sous tension.

6.1 Raccordement du capteur


Le raccordement électrique au transmetteur se fait à l'aide d'un câble de mesure CYK10.

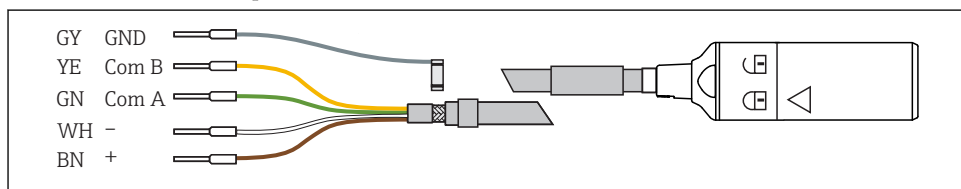

A0024019

13 Câble de mesure CYK10

- Pour prolonger le câble, utiliser le câble de mesure CYK11. La longueur de câble maximale est de 100 m (328 ft).

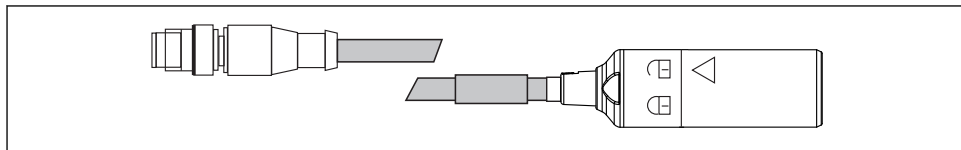

A0018861

14 Raccordement électrique, connecteur M12

6.2 Garantir l'indice de protection

A la livraison, il convient de ne réaliser que les raccordements mécaniques et électriques décrits dans le présent manuel, qui sont nécessaires à l'application prévue.

- Travaillez avec soin.

Sinon, certains indices de protection garantis pour ce produit (étanchéité (IP), sécurité électrique, immunité CEM) pourraient ne plus être garantis en raison, par exemple de l'absence de couvercles ou de câbles/d'extrémités de câble pas ou mal fixés.

6.3 Contrôle du raccordement

Etat et spécifications de l'appareil	Remarques
Le capteur, la chambre de passage et les câbles sont-ils exempts de dommages à l'extérieur ?	Contrôle visuel
Raccordement électrique	Remarques
Les câbles montés sont-ils exempts de toute contrainte et non vrillés ?	
Les fils de câble sont-ils suffisamment dénudés et correctement positionnés dans la borne ?	A vérifier (en tirant légèrement)
Toutes les bornes à visser sont-elles correctement serrées ?	Serrer
Toutes les entrées de câble sont-elles montées, serrées et étanches ?	Pour les entrées de câble latérales, assurez-vous que les boucles de câble sont orientées vers le bas pour que l'eau puisse s'écouler
Toutes les entrées de câble sont-elles installées vers le bas ou montées sur le côté ?	

7 Mise en service

7.1 Contrôle du fonctionnement

Avant la première mise en service, s'assurer que :

- Le capteur est correctement monté.
- Le raccordement électrique a été correctement réalisé.
- Il y a suffisamment d'électrolyte dans la cartouche à membrane et le transmetteur n'affiche pas un avertissement concernant l'appauvrissement de l'électrolyte.



Prendre connaissance des informations figurant sur la fiche de données de sécurité pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'électrolyte.



Toujours garder le capteur humide après la mise en service.

⚠ AVERTISSEMENT

Fuite du produit de process

Risque de blessure causée par la haute pression, la température élevée ou par la substance chimique

- Avant d'appliquer une pression sur une sonde avec système de nettoyage, s'assurer que le système est correctement raccordé.
- Ne pas installer le support dans le process s'il n'est pas possible de garantir un raccordement correct.

7.2 Polarisation du capteur

La tension appliquée par le transmetteur entre l'électrode de travail et la contre-électrode polarise la surface de l'électrode de travail. Par conséquent, après la mise sous tension du transmetteur lorsqu'un capteur est raccordé, il faut attendre la fin de la polarisation avant de pouvoir démarrer l'étalonnage.

Pour obtenir une valeur affichée stable, le capteur requiert les durées de polarisation suivantes :

Première mise en service	60 min
Remise en service	30 min

7.3 Étalonnage du capteur

Mesure de référence selon la méthode DPD

Pour étalonner le système de mesure, effectuer une mesure comparative colorimétrique selon la méthode DPD. Le brome réagit avec le diéthylène-paraphénylène-diamine (DPD) et se colore en rouge, l'intensité de la coloration rouge étant proportionnelle à la teneur en brome. Cette coloration rouge est mesurée avec un photomètre (p. ex. PF-3 → 43) . Le photomètre indique la teneur en brome.

Exigences

Les valeurs du capteur sont stables (ni dérive ni fluctuation des valeurs mesurées pendant au moins 5 minutes). Cela est généralement possible lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- La polarisation est terminée.
- Le débit est constant et dans la gamme acceptable.
- Le capteur et le produit sont à la même température.
- La valeur de pH se situe dans la gamme admissible.

Étalonnage du zéro

L'étalonnage du point zéro n'est pas nécessaire en raison de la stabilité du point zéro du capteur à membrane.

Cependant, un étalonnage du point zéro peut être effectué, si souhaité.

1. Pour effectuer un ajustage du point zéro, faire fonctionner le capteur pendant au moins 15 min. dans de l'eau exempte de brome, en utilisant le support ou le capot de protection comme récipient.
2. Il est également possible de réaliser un ajustage du point zéro à l'aide du gel pour point zéro COY8 →  43.

Étalonnage de la pente



Toujours réaliser un étalonnage de la pente dans les cas suivants :

- Après le remplacement de la cartouche à membrane
- Après le remplacement de l'électrolyte

1. S'assurer que la valeur de pH et la température du produit sont constantes.
2. Prélever un échantillon représentatif pour la mesure DPD. Celui-ci doit se faire à proximité immédiate du capteur. Utiliser le robinet de prélèvement le cas échéant.
3. Déterminer la teneur en brome à l'aide de la méthode DPD.
4. Entrer la valeur mesurée dans le transmetteur (voir manuel de mise en service pour le transmetteur).
5. Pour assurer une meilleure précision, vérifier l'étalonnage par mesure DPD après plusieurs heures ou 24 heures.

8 Diagnostic et suppression des défauts

Pour la recherche des défauts, il faut prendre en compte l'ensemble du point de mesure. Cela comprend :

- Transmetteur
- Raccordements et câbles électriques
- Support
- Capteur

Les causes d'erreur possibles listées dans le tableau suivant se rapportent essentiellement au capteur. Avant de commencer la recherche des défauts, s'assurer que les conditions d'utilisation suivantes sont respectées :

- Mesure en mode "compensé en température" (configuration sur le transmetteur CM44x) ou température constante après étalonnage
- Débit d'au moins 16 cm/s (0,5 ft/s)
- Aucun agent de bromation organique n'est utilisé
- Si des agents de bromation organiques sont utilisés, un nouvel étalonnage doit être effectué.

 En cas de grands écarts entre la valeur mesurée par le capteur et la valeur de la méthode DPD, il faut d'abord prendre en compte toutes les possibilités d'erreur dues à la méthode DPD photométrique (voir manuel de mise en service du photomètre). Si nécessaire, répéter la mesure DPD plusieurs fois.

Erreur	Cause possible	Mesure corrective
Pas d'affichage, pas de courant au capteur	Pas de tension d'alimentation au transmetteur	► Établir le raccordement au réseau
	Interruption du câble de raccordement entre le capteur et le transmetteur	► Établir le raccordement du câble
	Il y a pas d'électrolyte dans la cartouche à membrane	► Remplir la cartouche à membrane
	Pas d'écoulement de produit à l'entrée	► Établir l'écoulement, nettoyer le filtre
Valeur affichée trop élevée	Polarisation du capteur pas totalement terminée	► Attendre que la polarisation soit terminée
	Membrane défectueuse	► Remplacer la cartouche à membrane
	Shunt (p. ex. pont d'humidité) dans le corps du capteur	► Retirer la cartouche à membrane, frotter l'électrode de travail jusqu'à ce qu'elle soit sèche. ► Si l'affichage du transmetteur ne se remet pas à zéro, il y a shunt : remplacer le capteur.
	Interférence d'oxydants étrangers avec le capteur	► Examiner le produit, vérifier les substances chimiques

Erreur	Cause possible	Mesure corrective
Valeur affichée trop faible	Cartouche à membrane pas vissée totalement	► Remplir la cartouche à membrane d'électrolyte frais →  36 ► Visser complètement la cartouche à membrane
	Membrane contaminée	► Nettoyer la membrane →  35
	Bulle d'air devant la membrane	► Éliminer la bulle d'air
	Bulle d'air entre l'électrode de travail et la membrane	► Retirer la cartouche à membrane, remplir d'électrolyte ► Éliminer la bulle d'air en tapotant sur l'extérieur de la cartouche à membrane ► Visser la cartouche à membrane
	Écoulement de produit à l'entrée trop faible	► Établir le bon écoulement
	Interférence d'oxydants étrangers avec la mesure comparative DPD	► Examiner le produit, vérifier les substances chimiques
	Utilisation de désinfectants organiques	► Utiliser un agent adapté (p. ex. selon DIN 19643) (il peut être nécessaire de remplacer l'eau au préalable) ► Utiliser un système de référence adapté.
L'affichage fluctue considérablement	Trou dans la membrane	► Remplacer la cartouche à membrane

9 Maintenance

 Veuillez prendre connaissance des informations figurant sur la fiche de données de sécurité pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'électrolyte.

Prenez toutes les mesures nécessaires à temps pour garantir la sécurité de fonctionnement et la fiabilité de l'ensemble de mesure.

AVIS

Effets sur le process et la commande de process !

- ▶ Lorsque vous intervenez sur le système, notez les possibles répercussions sur le système de commande de process ou sur le process lui-même.
- ▶ Pour votre sécurité personnelle, n'utilisez que des accessoires d'origine. Avec des pièces d'origine, le fonctionnement, la précision et la fiabilité sont garantis même après une intervention de maintenance.

9.1 Plan de maintenance

Intervalle	Travaux de maintenance
Si des dépôts sont visibles sur la membrane (biofilm, calcaire)	Nettoyer la membrane du capteur →  36
Si la surface du corps de l'électrode est visiblement encrassée	Nettoyer le corps de l'électrode →  36
La durée de vie de l'électrolyte dépend fortement de la teneur en sel du produit. Nous recommandons de changer l'électrolyte tous les 6 à 9 mois. L'électrolyte doit être changé tous les 6 mois au moins dans le cas de produits à faible conductivité. La cartouche à membrane doit être remplacée tous les ans.	Changer l'électrolyte Remplacer la cartouche à membrane →  37
▪ Pente en fonction de l'application : Tous les 6 à 9 mois (au maximum) dans des conditions constantes dans la gamme admissible de 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) ▪ Il est recommandé d'effectuer un étalonnage 2 semaines après l'installation dans le cas de produits à faible conductivité ▪ Étalonnage du point zéro : ▪ En cas de fonctionnement dans une gamme de concentration inférieure à 0,5 mg/l (ppm) ▪ Si une valeur mesurée négative est affichée avec étalonnage en usine	Étalonnage du capteur
▪ Si l'avertissement du compteur d'électrolyte est actif ▪ Si le capot est remplacé ▪ Pour déterminer le point zéro ▪ Si la pente est trop faible ou trop forte par rapport à la pente nominale et si la cartouche à membrane n'est pas visiblement endommagée ou encrassée	Remplir la cartouche à membrane d'électrolyte frais →  36
▪ S'il y a des dépôts de graisse/d'huile (tâches sombres ou transparentes sur la membrane) ▪ Si la pente est trop forte ou trop faible ou si le courant au capteur est très bruyant ▪ S'il est évident que le courant au capteur dépend fortement de la température (la compensation de température ne fonctionne pas).	Remplacer la cartouche à membrane →  37
Si des changements sont visibles sur l'électrode de travail ou la contre-électrode (la couche brune a disparu)	Régénérer le capteur →  41

9.2 Opérations de maintenance

9.2.1 Nettoyage du capteur

⚠ ATTENTION

Acide chlorhydrique dilué

L'acide chlorhydrique provoque des irritations en cas de contact avec la peau ou les yeux.

- ▶ Lors de la manipulation d'acide chlorhydrique dilué, porter des vêtements de protection tels que des gants et des lunettes de protection.
- ▶ Éviter les projections.

AVIS


Substances chimiques réduisant la tension de surface (p. ex. tensio-actifs dans les solutions de nettoyage ou solvants organiques comme l'alcool, qui peuvent être mélangés à de l'eau)

Les produits chimiques qui réduisent la tension de surface font perdre à la membrane du capteur sa propriété spéciale et sa fonction de protection, ce qui entraîne des erreurs de mesure.

- ▶ N'utiliser aucune substance chimique qui réduit la tension de surface.

Retirer le capteur de la chambre de passage CCA151

1. Retirer le câble.
2. Dévisser l'écrou-raccord de la chambre de passage.

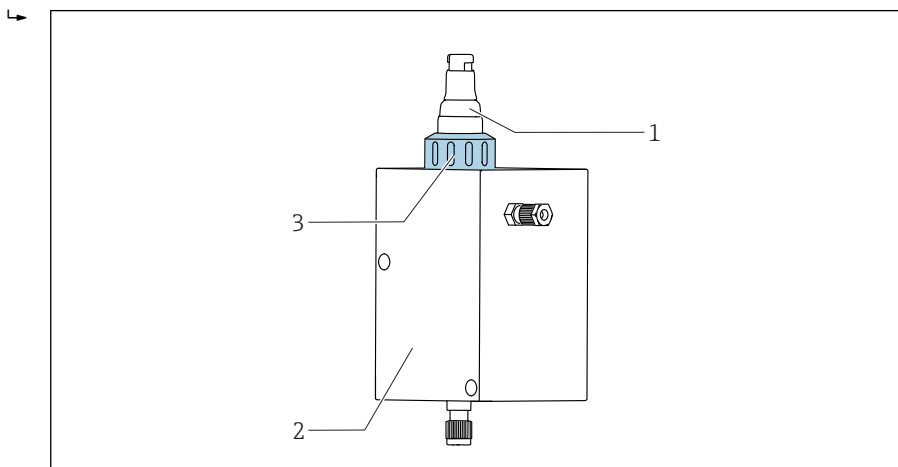

A0034261

- 1 Capteur de désinfection CCS55D
- 2 Chambre de passage Flowfit CCA151
- 3 Écrou-raccord pour la fixation d'un capteur de désinfection CCS55D

3. Sortir le capteur par l'ouverture dans la chambre de passage.

Retirer le capteur de la chambre de passage CCA250

1. Retirer le câble.
2. Dévisser le capteur ainsi que l'adaptateur de la chambre de passage.



Il n'est pas nécessaire de démonter l'adaptateur.



Pour plus d'informations sur le "Retrait du capteur de la chambre de passage CCA250", voir le manuel de mise en service de la chambre de passage concernée.

Retirer le capteur de la chambre de passage CYA112

1. Retirer le câble.
2. Dévisser le capteur ainsi que l'adaptateur de la chambre de passage.



Il n'est pas nécessaire de démonter l'adaptateur.



Pour plus d'informations sur le "Retrait du capteur du support CYA112", voir le manuel de mise en service de la chambre de passage concernée.

Nettoyage de la membrane du capteur

En cas de dépôts visibles sur la membrane, p. ex. biofilm, procéder de la façon suivante :

1. Retirer le capteur de la chambre de passage → 35.
2. Retirer la cartouche à membrane → 37.
3. Ne nettoyer la cartouche à membrane que mécaniquement avec un jet d'eau modéré. Il est également possible de la placer pendant quelques minutes dans des acides dilués ou dans des solutions de nettoyage spécifiées sans autres additifs chimiques.
4. Ensuite, rincer soigneusement avec de l'eau.
5. Revisser la cartouche à membrane sur le capteur → 37.

Nettoyage du corps d'électrode

1. Retirer le capteur de la chambre de passage → 35.
2. Retirer la cartouche à membrane → 37.
3. Essuyer soigneusement l'électrode en or à l'aide d'une éponge douce.
4. Rincer le corps de l'électrode avec de l'eau déminéralisée, de l'alcool ou de l'acide dilué.
5. Revisser la cartouche à membrane sur le capteur → 37.

9.2.2 Remplissage de la cartouche à membrane avec de l'électrolyte frais



Veillez prendre connaissance des informations figurant sur la fiche de données de sécurité pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'électrolyte.

AVIS**Membrane et électrodes endommagées, bulles d'air**

Possibilité d'erreurs de mesure pouvant aller jusqu'au dysfonctionnement du point de mesure

- ▶ Éviter d'endommager la membrane et les électrodes.
- ▶ L'électrolyte de remplissage est chimiquement neutre et ne présente aucun danger pour la santé. Éviter toutefois le contact avec les yeux et l'ingestion.
- ▶ Fermer le flacon d'électrolyte après usage. Ne pas transvaser l'électrolyte dans d'autres récipients.
- ▶ Ne pas conserver l'électrolyte plus de 2 ans. L'électrolyte ne doit pas présenter de couleur jaune. Respecter la date limite d'utilisation sur l'étiquette.
- ▶ Éviter la formation de bulles en versant l'électrolyte dans la cartouche à membrane.

Remplissage de la cartouche à membrane avec de l'électrolyte


1. Retirer la cartouche à membrane →  38.
2. Verser env. 7 ml (0,24 fl.oz) d'électrolyte dans la cartouche à membrane jusqu'au niveau du début du raccord fileté.
3. Visser lentement la cartouche à membrane jusqu'en butée →  36. L'excès d'électrolyte est alors expulsé du capteur.
4. Si nécessaire, sécher le capteur et la cartouche à membrane à l'aide d'un chiffon.
5. Réinitialiser le compteur des heures de fonctionnement de l'électrolyte sur le transmetteur. Pour plus d'informations, voir le manuel de mise en service du transmetteur.

9.2.3 Remplacement de la cartouche à membrane

1. Retirer le capteur de la chambre de passage →  35.
2. Retirer la cartouche à membrane →  38.
3. Verser de l'électrolyte frais dans la nouvelle cartouche à membrane jusqu'au niveau du début du raccord fileté.
4. Vérifier que la bague d'étanchéité est montée dans la cartouche à membrane.
5. Revisser la nouvelle cartouche à membrane sur le corps du capteur →  39.
6. Visser la cartouche à membrane jusqu'à ce que la membrane à l'électrode de travail soit légèrement distendue (1 mm (0,04 in)).
7. Réinitialiser le compteur des heures de fonctionnement de la cartouche à membrane sur le transmetteur. Pour plus d'informations, voir le manuel de mise en service du transmetteur.


Démontage de la cartouche à membrane

- Tourner avec précaution la cartouche à membrane et la retirer.

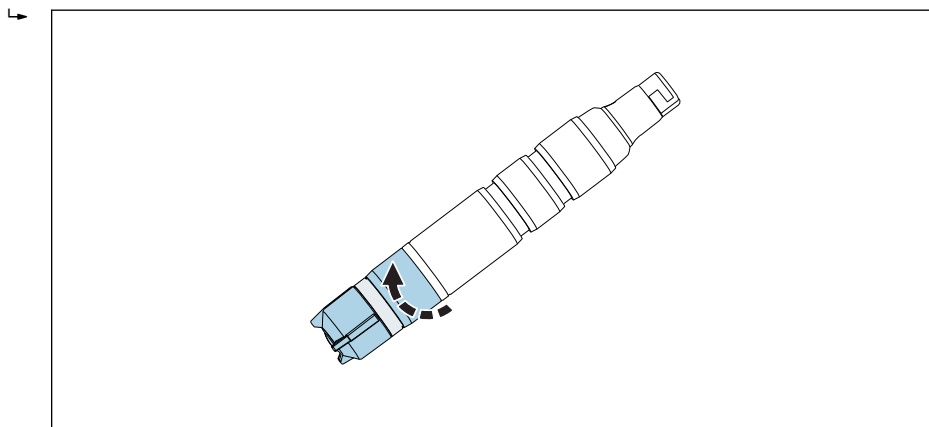

A0034406

 15 Tourner avec précaution la cartouche à membrane.

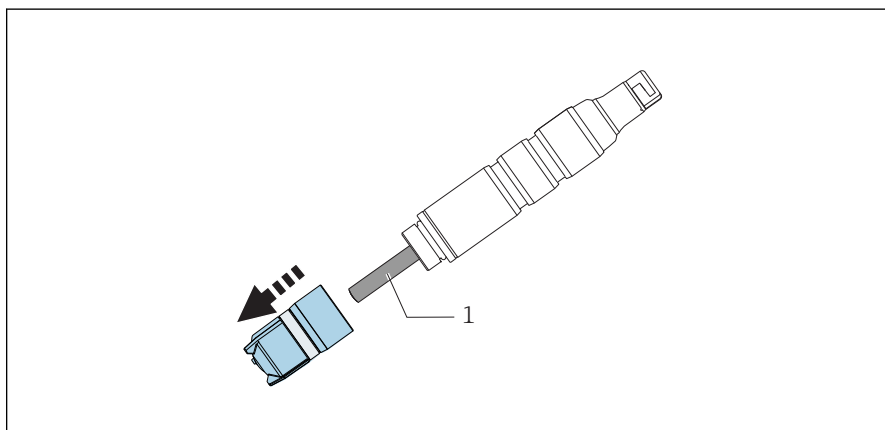

A0034408


 16 Retirer avec précaution la cartouche à membrane.

1 Corps de l'électrode

Vissage de la cartouche à membrane sur le capteur

- Visser la cartouche à membrane sur le corps du capteur : tenir le capteur par la tige. Laisser la soupape libre.

↳

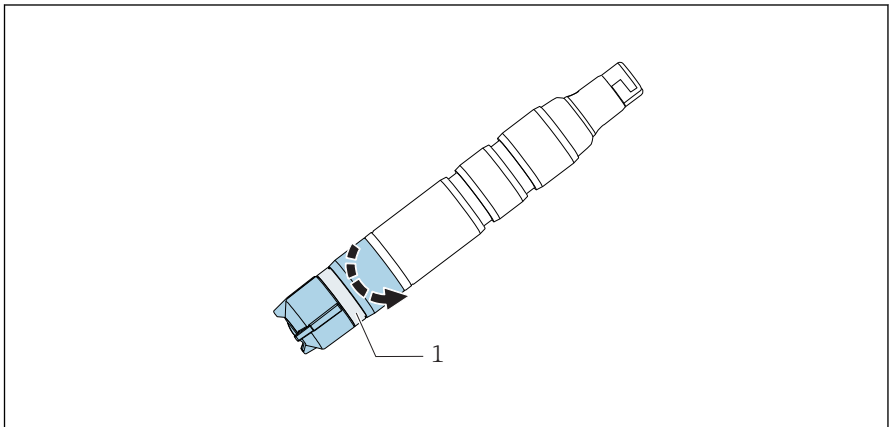

A0034480

■ 17 Visser la cartouche à membrane : laisser la soupape de sécurité libre.

1 Soupape de sécurité

9.2.4 Stockage du capteur

En cas d'interruption de la mesure pendant une courte période, s'il est garanti que le capteur est maintenu humide pendant le stockage :

1. Si il est garanti que la chambre de passage ne fonctionne pas à vide, le capteur peut rester dans la chambre de passage.
2. Si la chambre de passage risque de fonctionner à vide, retirer le capteur de la chambre.
3. Pour que la membrane reste humide après le retrait du capteur, remplir le capot de protection d'électrolyte ou d'eau claire.
4. Placer le capot de protection sur le capteur → 40.

En cas d'interruption prolongée de la mesure, notamment s'il y a un risque de dessèchement :

1. Retirer le capteur de la chambre de passage.
2. Nettoyer le corps du capteur et la cartouche à membrane à l'eau froide et laisser sécher.
3. Visser la cartouche à membrane jusqu'en butée sans serrer. La membrane reste ainsi détendue.
4. Remplir le capot de protection avec de l'électrolyte ou de l'eau claire et le fixer → 39.


5. Pour la remise en service, suivre la même procédure que pour la mise en service
→  30.

 Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'encrassement biologique pendant des interruptions plus longues de la mesure. Retirer les dépôts organiques continus, tels que les films bactériens.

Montage du capot de protection sur le capteur

1. Pour que la membrane reste humide après le retrait du capteur, remplir le capot de protection d'un d'eau propre.

↳

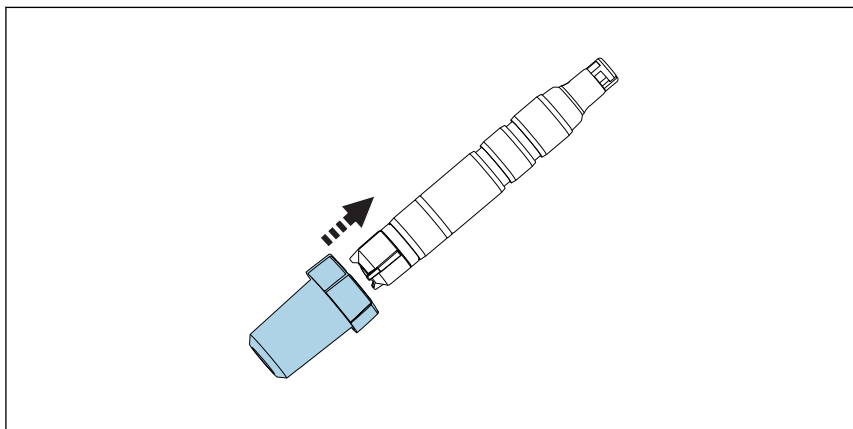


A0034264

 18 Glisser délicatement le capot de protection sur la cartouche à membrane.

2. La partie supérieure du capot de protection est en position ouverte.
Glisser délicatement le capot de protection sur la cartouche à membrane.

3. Fixer le capot de protection en tournant la partie supérieure du capot de protection.

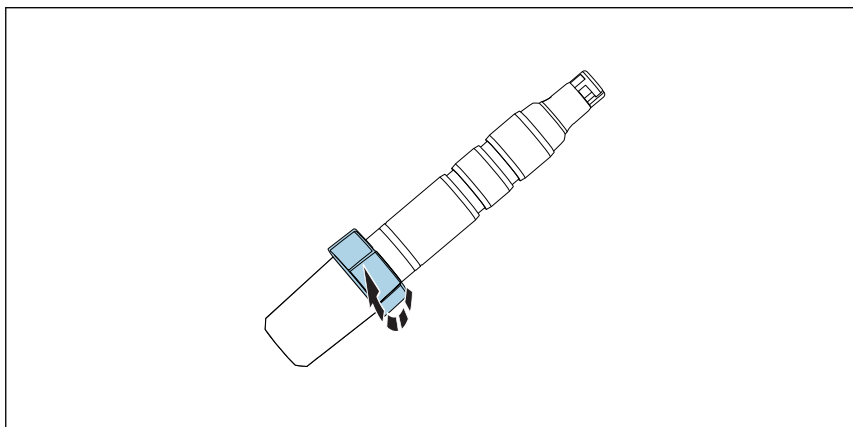

A0034494

 19 Fixation du capot de protection en tournant la partie supérieure

9.2.5 Régénération du capteur

Pendant la mesure, l'électrolyte dans le capteur s'épuise progressivement en raison des réactions chimiques. La gris-brun appliquée sur la contre-électrode en usine continue de grossir pendant le fonctionnement du capteur. Toutefois, cela n'a pas d'effet sur la réaction qui a lieu à l'électrode de travail.

Un changement de couleur de la indique un effet sur la réaction en cours. Vérifier visuellement que la couleur gris-brun de la contre-électrode n'a pas changé. Si la couleur de la contre-électrode a changé, p. ex. si elle est tachetée, blanche ou argentée, il faut régénérer le capteur.

- Retourner le capteur au fabricant pour régénération.

10 Réparation

10.1 Pièces de rechange

Pour plus de détails sur les kits de pièces de rechange, référez-vous au "Spare Part Finding Tool" sur Internet :

www.fr.endress.com/spareparts_consumables

10.2 Retour de matériel

Le produit doit être retourné s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine ou si le mauvais produit a été commandé ou livré. En tant qu'entreprise certifiée ISO et conformément aux directives légales, Endress+Hauser est tenu de suivre des procédures définies en ce qui concerne les appareils retournés ayant été en contact avec le produit.

Pour garantir un retour rapide, sûr et professionnel de l'appareil :

- Vous trouverez les informations relatives à la procédure et aux conditions de retour des appareils sur notre site web www.endress.com/support/return-material.

10.3 Mise au rebut

L'appareil contient des composants électroniques. Le produit doit être mis au rebut comme déchet électronique.

- Respecter les réglementations locales.

11 Accessoires

Vous trouverez ci-dessous les principaux accessoires disponibles à la date d'édition de la présente documentation.

- ▶ Pour les accessoires non mentionnés ici, adressez-vous à notre SAV ou agence commerciale.

11.1 Kit de maintenance CCV05

Commande selon la structure du produit

- 2 x cartouches à membrane et 1 x électrolyte 50 ml (1,69 fl.oz)
- 1 x électrolyte 50 ml (1,69 fl.oz)
- 2 x jeu de joints

11.2 Accessoires spécifiques à l'appareil

Câble de données Memosens CYK10

- Pour capteurs numériques avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyk10



Information technique TI00118C

Câble de données Memosens CYK11

- Câble prolongateur pour capteurs numériques avec protocole Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyk11



Information technique TI00118C

Câble laboratoire Memosens CYK20

- Pour capteurs numériques avec technologie Memosens
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cyk20

Flowfit CCA151

- Chambre de passage pour capteurs de désinfection
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cca151



Information technique TI01357C

Flowfit CCA250

- Chambre de passage pour capteurs de désinfection et de pH/redox
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cca250



Information technique TI00062C

Flexdip CYA112

- Support à immersion pour l'eau et les eaux usées
- Système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves
- Matériau : PVC ou inox
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/cya112



Information technique TI00432C

Photomètre PF-3

- Photomètre portable compact pour la détermination de la valeur mesurée de référence
- Flacons de réactifs à code couleur avec instructions de dosage claires
- Référence : 71257946

Kit adaptateur CCS5xD pour CCA151

- Bague de serrage
- Bague de serrage
- Joint torique
- Réf. 71372027

Kit d'adaptateurs CCS5x(D) pour CCA250

- Adaptateur y compris joints toriques
- 2 goujons pour le maintien en place
- Réf. 71372025

Kit d'adaptateurs CCS5x(D) pour CYA112

- Adaptateur y compris joints toriques
- 2 goujons pour le maintien en place
- Réf. 71372026

COY8

Gel point zéro pour capteurs d'oxygène et de désinfection

- Gel sans oxygène ni chlore gel pour la vérification, l'étalonnage du point zéro et l'ajustement des points de mesure d'oxygène et de désinfection
- Configurateur de produit sur la page produit : www.fr.endress.com/coy8



Information technique TI01244C

12 Caractéristiques techniques

12.1 Entrée

12.1.1 Grandeurs mesurées

Brome libre (HOBr)	Acide hypobromeux (HOBr) [mg/l, µg/l, ppm, ppb]
Température	[°C, °F]

12.1.2 Gamme de mesure

CCS55D-**31AD	0 ... 5 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31BF	0 ... 20 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31CJ	0 ... 200 mg/l (ppm) HOBr

12.1.3 Courant de signal

CCS55D-**31AD	56 à 104 nA par 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31BF	14 à 26 nA par 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31CJ	14 à 26 nA par 1 mg/l (ppm) HOBr

12.2 Performances

12.2.1 Conditions de référence

Température	max. 20 °C (68 °F)
Valeur de pH	pH 6,5 ±0.2
Débit	40 à 60 cm/s
Produit de base exempt de HOBr	Eau courante

12.2.2 Temps de réponse

$T_{90} < 20$ s (une fois la polarisation terminée)

Le temps T_{90} peut être plus long sous certaines conditions. Si le capteur est utilisé ou conservé dans un produit exempt de brome pendant une longue période, la réponse du capteur démarre immédiatement en cas de présence de brome mais n'atteint la valeur de concentration exacte qu'après un certain temps.

12.2.3 Écart de mesure maximum

±2 % et ±5 µg/l (ppb) de la valeur mesurée (selon la valeur la plus élevée)

	LOD (limite de détection) ¹⁾	LOQ (limite de quantification) ¹⁾
CCS55D-**31AD	0,0008 mg/l (ppm)	0,0025 mg/l (ppm)
CCS55D-**31BF	0,0026 mg/l (ppm)	0,0085 mg/l (ppm)
CCS55D-**31CJ	0,0061 mg/l (ppm)	0,0203 mg/l (ppm)

1) Basée sur ISO 15839. L'écart de mesure inclut toutes les incertitudes du capteur et du transmetteur (système d'électrode). Elle ne comprend pas les incertitudes résultant du matériau de référence ou d'un ajustage ayant été réalisé.

12.2.4 Répétabilité

CCS55D-**31AD	0,0017 mg/l (ppm)
CCS55D-**31BF	0,0087 mg/l (ppm)
CCS55D-**31CJ	0,0476 mg/l (ppm)

12.2.5 Pente nominale

CCS55D-**31AD	80 nA par 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31BF	20 nA par 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31CJ	20 nA par 1 mg/l (ppm) HOBr

12.2.6 Dérive à long terme

< 1 % par mois (valeur moyenne, déterminée lors du fonctionnement à des concentrations variables et sous des conditions de référence)

12.2.7 Temps de polarisation

Première mise en service	60 min
Remise en service	30 min

12.2.8 Durée d'utilisation de l'électrolyte

La durée de vie de l'électrolyte dépend fortement de l'application et du produit. Elle diminue avec l'augmentation des concentrations de brome libre et l'augmentation de la température.

à 10 % de la gamme de mesure et 20 °C	2 ans
à 50 % de la gamme de mesure et 20 °C	1 an
à la concentration maximum et 55 °C	60 jours

12.2.9 Consommation intrinsèque de brome

La consommation intrinsèque de brome au niveau du capteur est négligeable.

12.3 Environnement

12.3.1 Température ambiante

–20 ... 60 °C (–4 ... 140 °F)

12.3.2 Température de stockage

	Stockage à long terme jusqu'à 2 ans (maximum)	Stockage jusqu'à 48 h (maximum)
Avec électrolyte	0 ... 35 °C (32 ... 95 °F) (non congelable)	35 ... 50 °C (95 ... 122 °F)
Sans électrolyte	–20 ... 60 °C (–4 ... 140 °F)	

12.3.3 Indice de protection

IP68 (1,8 m (5,91 ft)) colonne d'eau sur 7 jours à 20 °C (68 °F)

12.4 Process

12.4.1 Température de process

0 à 55 °C (32 à 130 °F), non congelable

12.4.2 Pression de process

La pression d'entrée dépend de la chambre de passage et de l'installation.

La mesure peut être réalisée avec une sortie libre.

La pression du produit directement en amont de la membrane du capteur ne doit pas dépasser 1 bar (14,5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.)).

- En ce qui concerne l'état et les performances du capteur, il est essentiel de respecter les limites de vitesse d'écoulement indiquées dans le tableau suivant.

	Vitesse d'écoulement [cm/s]	Débit volumique [l/h]		
		Flowfit CCA250	Flowfit CCA151	Flexdip CYA112
Minimum	16	30	5	Le capteur est suspendu librement dans le produit ; respecter la vitesse d'écoulement minimum de 16 cm/s pendant l'installation.
Maximum	80	120	20	

12.4.3 Gamme de pH

Gamme d'efficacité du brome libre pH 5 à 10¹⁾

Étalonnage pH 5 à 9

Mesure pH 5 à 10

- 1) À un pH < 5, le brome élémentaire est formé à partir de l'acide hypobromeux et se comporte différemment de l'acide hypobromeux lorsqu'il traverse la membrane. En outre, en présence d'ions chlorure (Cl⁻), du chlorure de brome peut se former, ce qui peut également conduire à des résultats incorrects.

12.4.4 Débit

Au moins 5 l/h (1,3 gal/h), dans la chambre de passage Flowfit CCA151
Au moins 30 l/h (7,9 gal/h), dans la chambre de passage Flowfit CCA250

12.4.5 Débit

Au moins 16 cm/s (0,5 ft/s) , p. ex. avec support à immersion Flexdip CYA112

12.5 Construction mécanique

12.5.1 Dimensions

→  18

12.5.2 Poids

Capteur avec cartouche à membrane et électrolyte (sans capot de protection et sans adaptateur)
env.95 g (3,35 oz)

12.5.3 Matériaux

Corps du capteur	POM ou PVC
Membrane	PET
Cartouche à membrane	PVDF
Capot de protection	▪ Récipient : PC Makrolon (polycarbonate) ▪ Joint : Kraiburg TPE TM5MED ▪ Couvercle : PC Makrolon (polycarbonate)
Bague d'étanchéité	FKM
Raccord corps du capteur	PPS


12.5.4 Spécification de câble

Max. 100 m (330 ft), avec prolongateur de câble

13 **Installation et fonctionnement dans un environnement explosible de Classe I Div. 2**

Appareil antiétincelle pour une utilisation dans un environnement explosible spécifié selon :

- cCSAus Class I Div. 2
- Groupe de gaz A, B, C, D
- Classe de température T6, $-5\text{ °C (23 °F)} < T_a < 55\text{ °C (131 °F)}$
- Schéma de contrôle : 401204

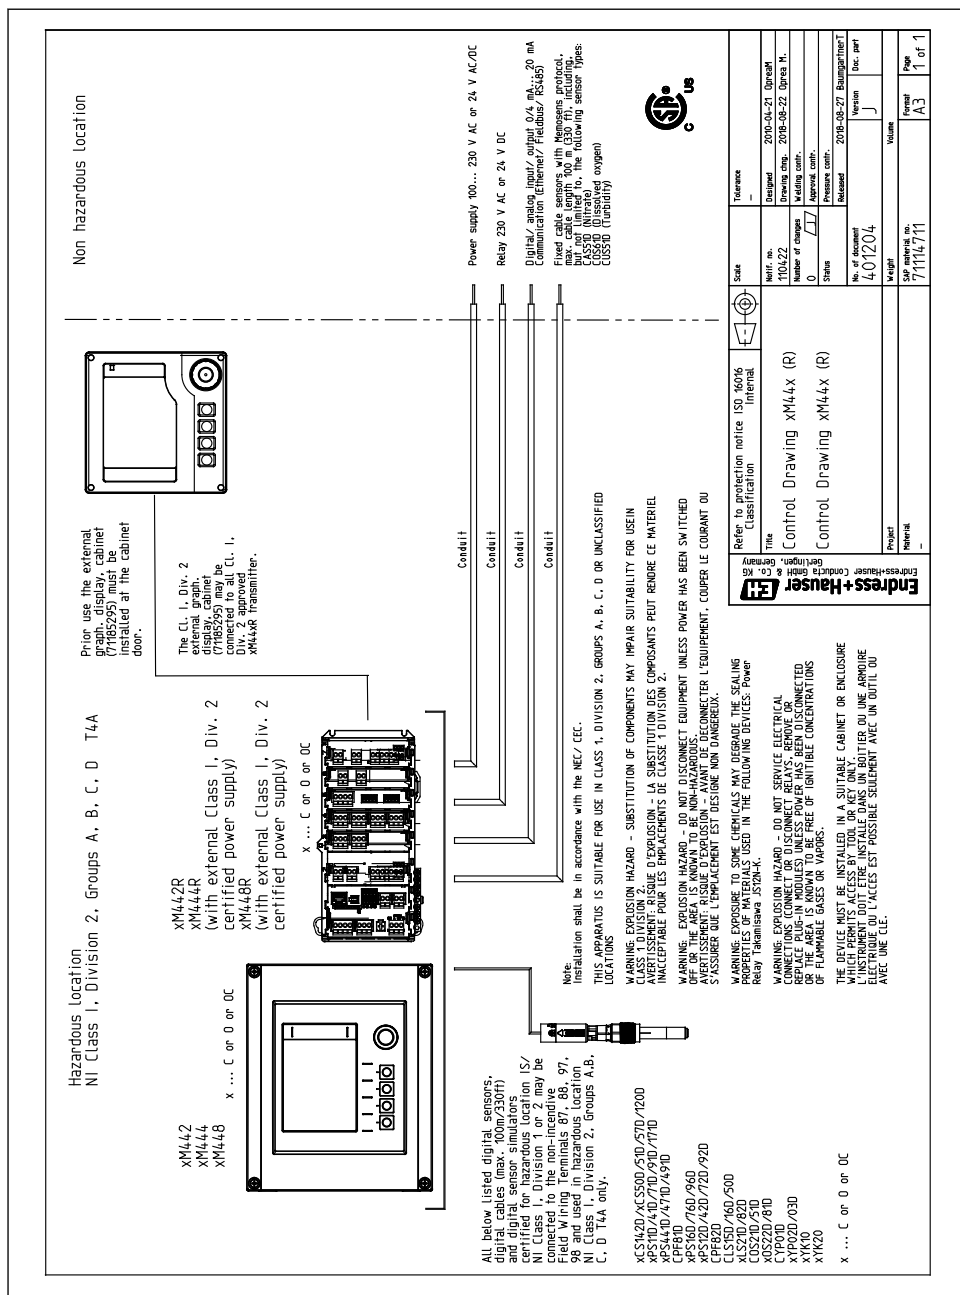

Index

A

Accessoires	43
Agréments	
Marine	15
Agréments Ex	16

C

Capteur	
Étalonnage	30
Montage	19
Nettoyage	35
Polarisation	30
Raccordement	28
Régénération	41
Stockage	39
Caractéristiques techniques	
Construction mécanique	48
Entrée	45
Environnement	47
Performances	45
Process	47
Chambre de passage	24, 26
Conditions de référence	45
Consignes de sécurité	6
Contenu de la livraison	15
Contrôle	
Fonctionnement	30
Montage	27
Raccordement	29
Contrôle du fonctionnement	30
Contrôle du montage	30

D

Débit	11, 48
Déclaration de conformité	15
Dérive à long terme	46
Description de l'appareil	8
Diagnostic	32
Durée d'utilisation de l'électrolyte	46

E

Écart de mesure maximum	46
Effet sur le signal mesuré	
Débit	11
Température	12

Valeur de pH	9
Ensemble de mesure	19
Environnement	47

G

Gamme de pH	47
Gammes de mesure	45
Grandeurs mesurées	45

I

Indice de protection	
Caractéristiques techniques	47
Garantie	28
Instructions de montage	17

M

Marine	15
Matériaux	48
Mise au rebut	42
Mises en garde	4
Montage	
Capteur	19
Chambre de passage	24
Contrôle	27
Position de montage	17
Support à immersion	26

N

Nettoyage	35
---------------------	----

O

Opérations de maintenance	35
-------------------------------------	----

P

Pente nominale	46
Performances	45
Pièces de rechange	42
Plan de maintenance	34
Plaque signalétique	14
Poids	48
Position de montage	17
Pression de process	47
Principe de fonctionnement	8
Principe de mesure	8
Process	47

R

Raccordement

Contrôle	29
Garantir l'indice de protection	28
Raccordement électrique	28
Réception des marchandises	14
Régénération	41
Réparation	42
Répétabilité	46
Retour de matériel	42

S

Signal mesuré	9
Spécification de câble	48
Stockage	39
Support à immersion	26
Suppression des défauts	32
Symboles	4

T

Température	12
Température ambiante	47
Température de process	47
Température de stockage	47
Temps de polarisation	46
Temps de réponse	45

U

Utilisation	6
Utilisation conforme	6

V

Valeur de pH	9
------------------------	---



71486225

www.addresses.endress.com
