


取扱説明書

Liquiline CM442R/CM444R/ CM448R

ユニバーサル 4 線式 マルチチャンネルコントローラ
盤内設置用

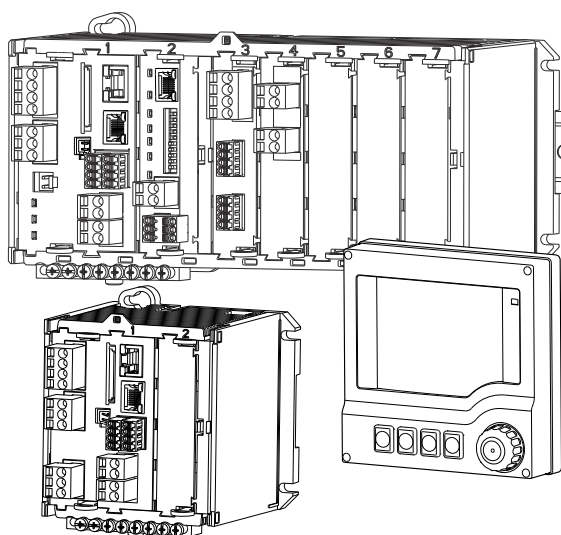

目次

1	本説明書について	5	8.3	設定オプション	47
1.1	警告	5	9	設定	49
1.2	シンボル	5	9.1	機能チェック	49
1.3	機器のシンボル	5	9.2	起動	49
1.4	関連資料	6	9.3	ユーザ定義スクリーン	50
2	安全上の基本注意事項	7	9.4	基本設定	51
2.1	作業員の要件	7	10	操作	52
2.2	用途	7	10.1	表示	52
2.3	労働安全	8	10.2	一般設定	54
2.4	操作上の安全性	8	10.3	電流入力	68
2.5	製品の安全性	9	10.4	出力	68
3	機器説明	10	10.5	バイナリ入力および出力	77
3.1	標準機器	10	10.6	追加機能	83
3.2	センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i 付き 機器	11	11	校正	112
3.3	スロットとポートの割当て	12	12	診断およびトラブルシューティン グ	113
3.4	端子図	13	12.1	一般トラブルシューティング	113
4	納品内容確認および製品識別表示	14	12.2	現場表示器の診断情報（オプション）	114
4.1	納品内容確認	14	12.3	ウェブブラウザ経由の診断情報	114
4.2	製品識別表示	14	12.4	フィールドバス経由の診断情報	114
4.3	納入範囲	15	12.5	診断情報の適合	114
4.4	認証と認定	15	12.6	診断情報の概要	116
5	設置	17	12.7	未解決の診断メッセージ	120
5.1	設置条件	17	12.8	診断リスト	120
5.2	機器の取付け	21	12.9	イベントログブック	121
5.3	設置状況の確認	24	12.10	シミュレーション	124
6	電気接続	25	12.11	機器テスト	125
6.1	接続条件	25	12.12	機器のリセット	125
6.2	機器の接続	26	12.13	機器情報	126
6.3	センサの接続	30	12.14	ファームウェアの履歴	129
6.4	追加の入力、出力またはリレーの接続	33	13	メンテナンス	132
6.5	PROFIBUS DP または Modbus RS 485 の 接続	37	13.1	洗浄	132
6.6	ハードウェア設定	38	14	修理	134
6.7	保護等級の保証	39	14.1	スペアパーツ	134
6.8	配線状況の確認	40	14.2	返却	136
7	システム統合	41	14.3	廃棄	136
7.1	Web サーバー	41	15	アクセサリ	137
7.2	サービスインターフェイス	43	15.1	測定用ケーブル	137
7.3	フィールドバス	43	15.2	センサ	137
8	操作オプション	45	15.3	追加機能	142
8.1	概要	45	15.4	ソフトウェア	144
8.2	現場表示器による操作メニューへのアクセ ス	46	15.5	その他のアクセサリ	144

16 技術データ 146

16.1 入力 146

16.2 デジタル入力、パッシブ 147

16.3 電流入力、パッシブ 147

16.4 出力 147

16.5 デジタル出力、パッシブ 149

16.6 電流出力、アクティブ 150

16.7 リレー出力 150

16.8 プロトコル固有のデータ 151

16.9 電源 154

16.10 性能特性 155

16.11 環境 155

16.12 構造 157

**17 危険環境 Class I Div. 2 における取付
設置と操作 159**

索引 160

1 本説明書について


1.1 警告

情報の構造	意味
 危険 原因（/結果） 違反した場合の結果（該当する場合） ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できない場合、致命傷または重傷を負います。
 警告 原因（/結果） 違反した場合の結果（該当する場合） ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、重傷または致命傷を負う可能性があります。
 注意 原因（/結果） 違反した場合の結果（該当する場合） ▶ 修正方法	危険な状況を警告するシンボルです。 この状況を回避できなかった場合、軽傷または中程度の傷害を負う可能性があります。
 注記 原因 / 状況 違反した場合の結果（該当する場合） ▶ アクション/注記	器物を損傷する可能性がある状況を警告するシンボルです。

1.2 シンボル

シンボル	意味
	追加情報、ヒント
	許可または推奨
	禁止または非推奨
	資料参照
	ページ参照
	図参照
	操作・設定の結果

1.3 機器のシンボル

シンボル	意味
	機器の資料参照

1.4 関連資料

本取扱説明書の補足資料として、以下の資料をインターネットの製品ページから入手できます。

- 簡易取扱説明書 Liquiline CM44xR、KA01160C マ
- 取扱説明書 Memosens、BA01245C
 - Memosens 入力のソフトウェア説明
 - Memosens センサの校正
 - センサ固有の診断とトラブルシューティング
- HART 通信用取扱説明書、BA00486C
 - HART の現場設定およびインストールガイド
 - HART ドライバの説明
- フィールドバスおよび Web サーバー経由の通信用ガイドライン
 - HART、SD01187C
 - PROFIBUS、SD01188C
 - Modbus、SD01189C
 - Web サーバー、SD01190C
 - EtherNet/IP、SD01293C
 - PROFINET、SD02490C
- 爆発性雰囲気危険場所を使用する電気機器に関する安全上の注意事項
 - ATEX & IECEX、XA02419C
 - CSA、XA02420C

2 安全上の基本注意事項

2.1 作業員の要件

- 計測システムの据付け、試運転、運転、およびメンテナンスは、特別な訓練を受けた技術者のみが行うようにしてください。
- 技術者は特定の作業を実施する許可をプラント管理者から受けなければなりません。
- 電気接続は電気技師のみが行えます。
- 技術者はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- 測定点のエラーは、特別な訓練を受け、許可された作業員が修理を行ってください。

 支給された取扱説明書に記載されていない修理はメーカーまたは契約サービス会社のみが行えます。

2.2 用途

2.2.1 非危険環境

Liquiline CM44xR は、非危険場所において Memosens 技術を搭載したデジタルセンサを接続するためのマルチチャンネルコントローラです。

この機器は、次のアプリケーションに使用できるように設計されています。

- 食品および飲料産業
- ライフサイエンス産業
- 浄水/廃水処理
- 化学工業

2.2.2 cCSAus Class I Div. 2 に準拠する危険環境

- ▶ 本マニュアルに付属の制御図、規定の操作条件、および手順に従ってください。

2.2.3 危険環境で使用するセンサ用の 2DS Ex-i モジュールを搭載した非危険環境用の変換器

本取扱説明書および対応する XA に記載された設置条件を遵守する必要があります。

- ATEX & IECEx : XA02419C
- CSA : XA02420C

2.2.4 指定外の使用および不適切な使用

注記

ハウジングの上に物が置かれている場合

短絡または発火の原因となる可能性があります。あるいは、個々のキャビネットコンポーネントまたは測定システム全体の不具合につながる恐れがあります。

- ▶ 工具、ケーブル、紙、食品、液体容器、その他を絶対にハウジングの上に放置しないでください。
- ▶ 特に、火災予防（喫煙）および食品（飲料）の取り扱いに関する事業者の規定を必ず順守してください。

指定の用途以外で本機器を使用することは、作業員や計測システム全体の安全性を損なう恐れがあるため容認されません。

不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

2.2.5 設置環境

本機器および関連する電源ユニットは AC 24 V、DC 24 V または AC 100 ~ 230 V で使用でき、IP20 の耐衝撃性を備えています。

コンポーネントは汚染度 2 に対応するように設計されており、水分が内部に溜まらないようにしなければなりません。コンポーネントは適切な保護ハウジングに設置する必要があります。設置する場合は、本説明書に記載された周囲条件に従ってください。

2.3 労働安全

ユーザーは以下の安全条件を順守する責任があります。

- 設置ガイドライン
- 現地規格および規制
- 防爆規制

電磁適合性

- 電磁適合性に関して、この製品は工業用途に適用される国際規格に従ってテストされています。
- 示されている電磁適合性は、これらの取扱説明書の指示に従って接続されている機器にしか適用されません。

2.4 操作上の安全性

全測定点の設定を実施する前に：

1. すべて正しく接続されているか確認してください。
2. 電気ケーブルおよびホース接続に損傷が生じていないことを確かめてください。
3. 損傷した製品は操作しないでください。そして、意図せずに作動しないよう安全を確保してください。
4. 損傷のある製品にはその旨を明記したラベルを掲示してください。

操作中：

- ▶ 不具合を解消できない場合は、製品を停止させ、意図せずに作動しないよう安全を確保してください。

注意

洗浄システムは校正中またはメンテナンス中にオフにならない

測定物または洗浄剤による負傷の危険があります。

- ▶ 洗浄システムが接続されている場合は、洗浄システムをオフにした後でセンサを媒体から取り外してください。
- ▶ 洗浄機能をテストするために洗浄システムをオフにしない場合は、保護服、保護ゴーグル、および保護手袋を着用するか、その他の適切な措置を講じてください。

2.5 製品の安全性

2.5.1 最先端技術

本機器は最新の安全要件に適合するよう設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されています。関連法規および国際規格に準拠します。

2.5.2 IT セキュリティ


弊社は、取扱説明書に記載されている条件に従って使用されている場合のみ保証いたします。本機器は、いかなる予期しない設定変更に対しても保護するセキュリティ機構を備えています。

弊社機器を使用する事業者の定義する IT セキュリティ規格に準拠し、尚且つ機器と機器のデータ伝送に関する追加的な保護のために策定される IT セキュリティ対策は、機器の使用者により実行されなければなりません。

3 機器説明

3.1 標準機器

3.1.1 概要

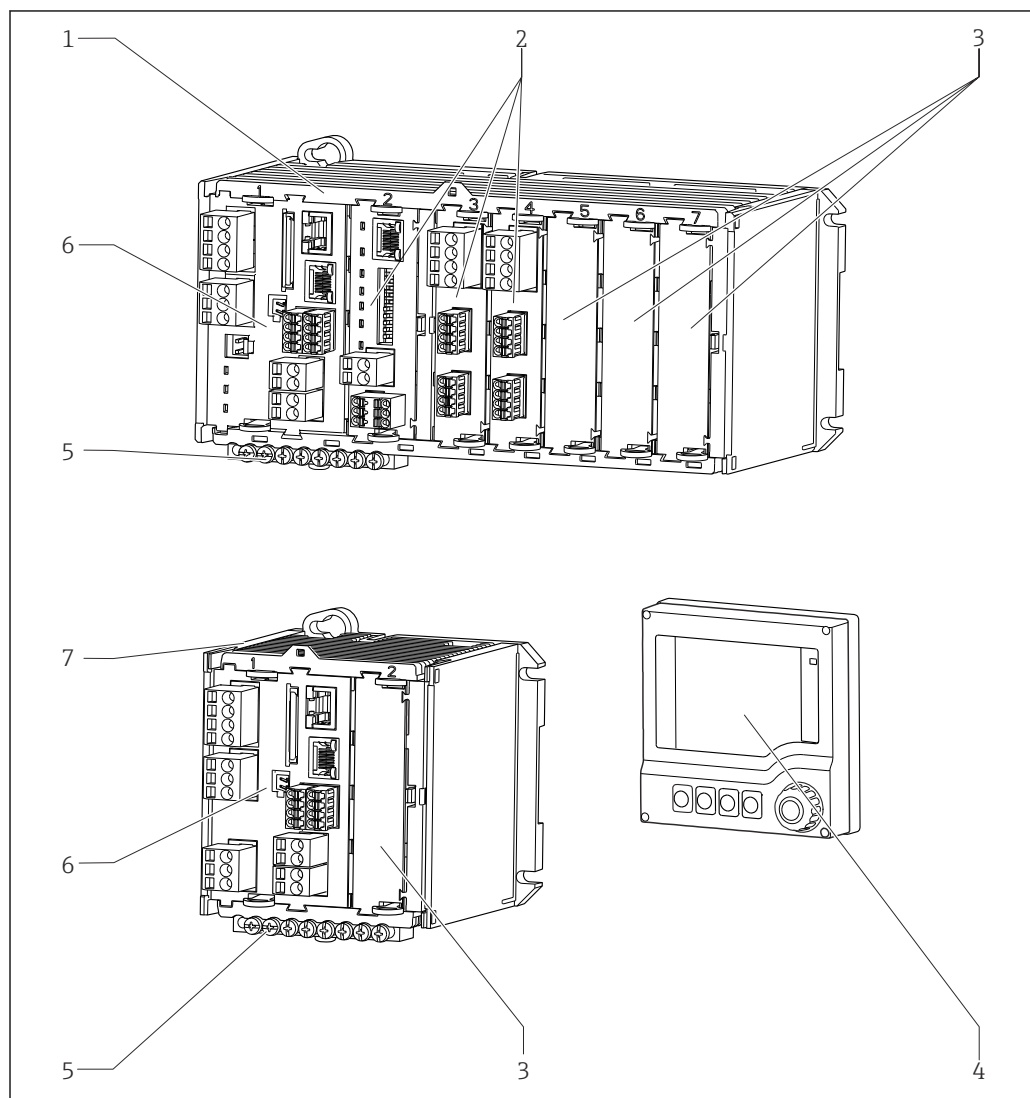

A0039726

図 1 外部ディスプレイ（オプション）付き機器（ケーブルを除く）

- | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 4 チャンネルまたは 8 チャンネル機器 | 5 | 端子ストリップ |
| 2 | 拡張モジュール（オプション） | 6 | ベーシックモジュール |
| 3 | 衝撃保護、ダミーモジュール | 7 | 2 チャンネル機器 |
| 4 | 外部ディスプレイ（オプション） | 8 | 外部電源ユニット（CM444R または CM448R のみ） |

3.2 センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i 付き機器

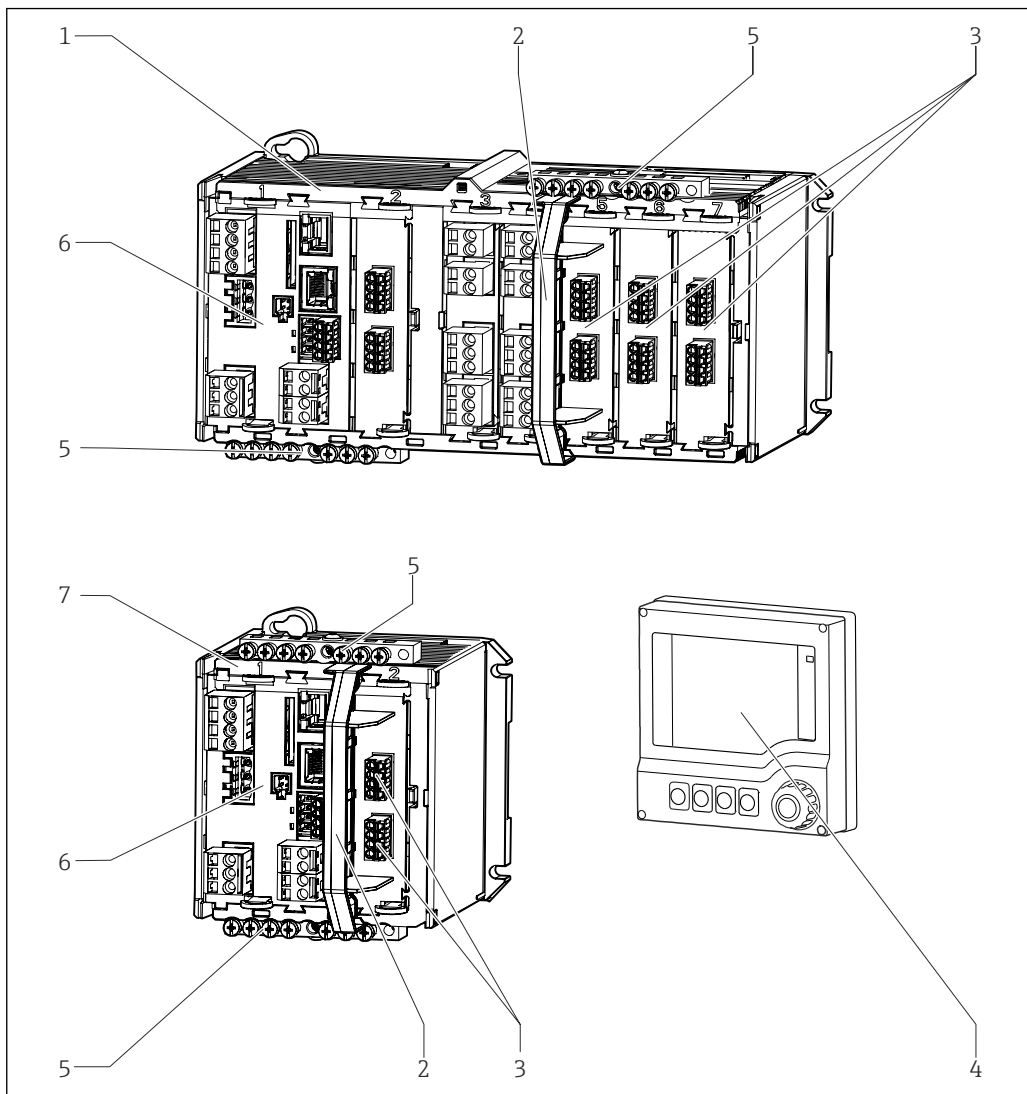


図 2 センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i およびオプションの外部ディスプレイ（ケーブルなし）付き機器

- | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 4 チャンネルまたは 8 チャンネル機器 | 5 | 端子ストリップ |
| 2 | 分離エレメント（取付済み） | 6 | ベースモジュール（危険場所バージョンの場合、センサ接続は無効） |
| 3 | 本質安全センサ接続 | 7 | 2 チャンネル機器 |
| 4 | 外部ディスプレイ（オプション） | 8 | 外部電源ユニット（CM444R または CM448R のみ） |

3.3 スロットとポートの割当て

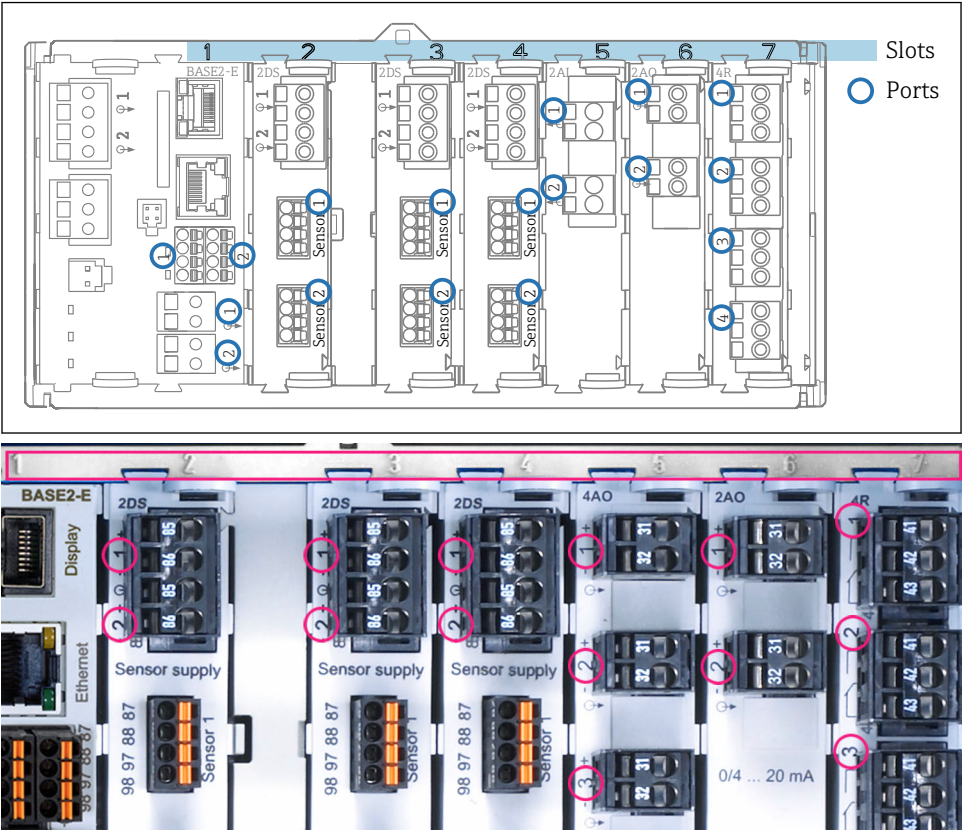


図 3 ハードウェアモジュールのスロットとポートの割当て

Outlet 1		OK
CH1: 1:1 pH Glass	ATC 6.95 pH	Port Slot
CH2: 1:2 TU/TS	500.0 g/l	
CH3: 5:1 SAC	500.0 1/m	
CH4: 5:2 Cond i	ATC 2.62 mS/cm	
CH5: 6:1 Chlorine	28.33 mg/l	
CH6: 6:2 Redox	± 51 mV	
CH7: 7:1 Oxygen (am...	32.86 mg/l	
CH8: 7:2 Cond c	ATC 131.1 µS/cm	
MENU CAL DIAG HOLD		

図 4 ディスプレイのスロットとポートの割当て

- 入力、スロットとポートの測定チャンネルに昇順で割り当てられます。
左の例：
「CH1: 1:1 pH ガラス」という表示の意味：
チャンネル 1 (CH1) がスロット 1 (ベーシックモジュール)：ポート 1 (入力 1) に割り当てられ、pH ガラス電極センサがここで接続
- 出力およびリレーはその機能に応じて、たとえば「電流出力」と呼ばれ、スロットとポート番号が昇順にディスプレイに表示されます。

3.4 端子図


 各端子名は、以下の要素を組み合わせたものです。

スロット番号：ポート番号：端子

例：リレーの NO 接点

デジタルセンサ用の 4 x 入力、4 x 電流出力、4 x リレーを備える機器

- ベースモジュール BASE2-E (2 x センサ入力と 2 x 電流出力を含む)
- 2DS モジュール (2 x センサ入力)
- 2AO モジュール (2 x 電流出力)
- 4R モジュール (4 x リレー)

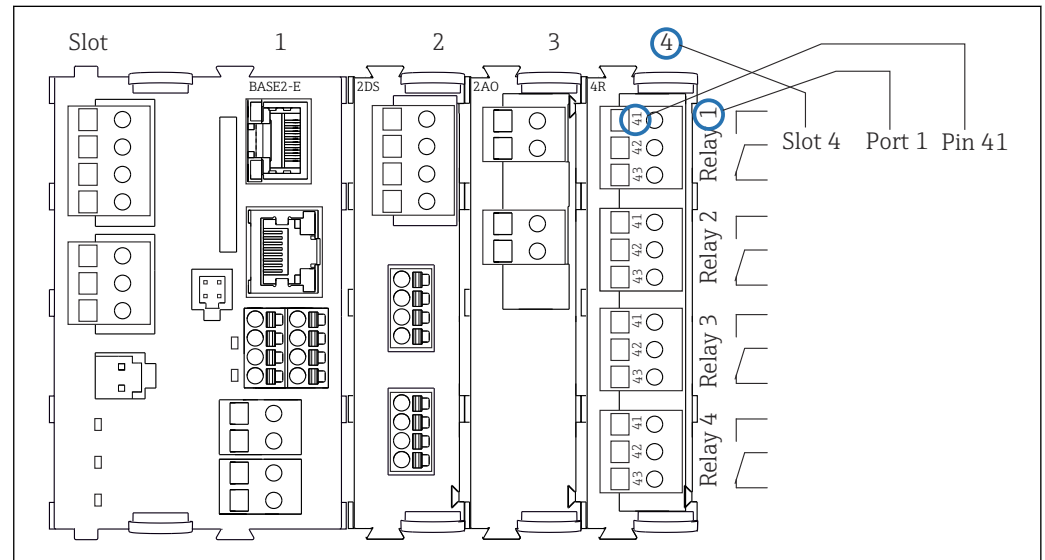

A0039621

図 5 リレーの NO 接点（端子 41）の例を使用した端子図作成

4 納品内容確認および製品識別表示

4.1 納品内容確認

1. 梱包が破損していないことを確認してください。
 - ↳ 梱包が破損している場合は、サプライヤに通知してください。
問題が解決されるまで破損した梱包を保管してください。
2. 内容物が破損していないことを確認してください。
 - ↳ 納品物が破損している場合は、サプライヤに通知してください。
問題が解決されるまで破損した製品を保管してください。
3. すべての納入品目が揃っており、欠品がないことを確認してください。
 - ↳ 発送書類と注文内容を比較してください。
4. 保管および輸送用に、衝撃や湿気から確実に保護できるように製品を梱包してください。
 - ↳ 弊社出荷時の梱包材が最適です。
許容周囲条件を必ず遵守してください。

ご不明な点がございましたら、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

4.2.1 銘板

銘板には機器に関する以下の情報が記載されています。

- 製造者証明書
- オーダーコード
- 拡張オーダーコード
- シリアル番号
- ファームウェアのバージョン
- 周囲条件とプロセス条件
- 入出力値
- アクティベーションコード
- 安全上の注意と警告
- 危険場所ごとの Ex マーキング

- ▶ 銘板の情報と発注時の仕様を比較確認してください。

4.2.2 製品識別表示

製品ページ

www.endress.com/cm442r

www.endress.com/cm444r

www.endress.com/cm448r

オーダーコードの解説

製品のオーダーコードとシリアル番号は以下の位置に表示されています。

- 銘板上
- 出荷書類

製品情報の取得

1. www.endress.com に移動します。

2. サイト検索を呼び出します（虫眼鏡）。
3. 有効なシリアル番号を入力します。
4. 検索ボタンを押します。
 - ↳ 製品構成がポップアップウィンドウに表示されます。
5. ポップアップウィンドウの製品画像をクリックします。
 - ↳ 新しいウィンドウ（**Device Viewer**）が開きます。ご使用の機器に関連するすべての情報と製品ドキュメントがこのウィンドウに表示されます。

製造者所在地

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.3 納入範囲

納入範囲：

- 1 x 発注されたバージョンのマルチチャンネルコントローラ
 - 1 x 取付プレート
 - 1 x 外部ディスプレイ（オプションで選択した場合）¹⁾
 - 1 x DIN レール電源ユニット、付属ケーブル（CM444R および CM448R のみ）
 - 1 x DIN レール電源ユニットの印刷された取扱説明書
 - 1 x 印刷された簡易取扱説明書（注文した言語）
 - 分離エレメント（危険場所バージョンタイプ 2DS Ex-i に取付済み）
 - 端子ストリップ
- ▶ ご不明な点がございましたら
製造元もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.4 認証と認定

4.4.1 CE マーク

本製品はヨーロッパの統一規格の要件を満たしています。したがって、EU 指令による法規に適合しています。Endress+Hauser は本機器が試験に合格したことを、CE マークの添付により保証いたします。

4.4.2 EAC

本製品は、欧州経済地域（EEA）で適用される TP TC 004/2011 および TP TC 020/2011 ガイドラインに従って認定を取得しています。EAC 適合マークが製品に貼付されています。

4.4.3 cCSAus

本機器は、電気的安全性および Class I Div. 2 cCSAus 防爆環境の認定を取得しています。本機器は以下の規格の要件を満たしています。

- CLASS 2252 06 - プロセス制御機器
- CLASS 2252 86 - プロセス制御機器 - 米国規格認証取得
- CLASS 2258 03 - プロセス制御機器 - 本質安全防爆方式 - 危険場所用
- CLASS 2258 83 - プロセス制御機器 - 本質安全防爆方式 - 危険場所用 - 米国規格認証取得
- FM3600

1) 外部ディスプレイは注文コードのオプションとして選択できます。また、後からアクセサリとして注文することもできます。

- FM3611
- FM3810
- UL50E
- IEC 60529
- CAN/CSA-C22.2 No. 0
- CAN/CSA C22.2 No. 94
- CSA Std. C22.2 No. 213
- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
- CAN/CSA-C22.2 No. 60529
- UL/ANSI/ISA 61010-1
- ANSI - ISA 12 12 01

4.4.4 船級認定

選択可能な機器およびセンサは、次の船級協会によって発行された船舶アプリケーション用型式認証を取得しています：ABS (American Bureau of Shipping)、BV (Bureau Veritas)、DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanischer Germanische Lloyd) および LR (Lloyd's Register)。認定を取得した機器およびセンサのオーダーコード、設置および周囲条件の詳細は、インターネットの製品ページにある船舶アプリケーション用の関連認定書に記載されています。

4.4.5 ATEX / IECEx 認定


バージョン CM44x2R-BM
ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC
XA02419C

バージョン CM44x(R)-IE
IECEx [Ex ia Ga] IIC
XA02419C

5 設置


5.1 設置条件

5.1.1 寸法

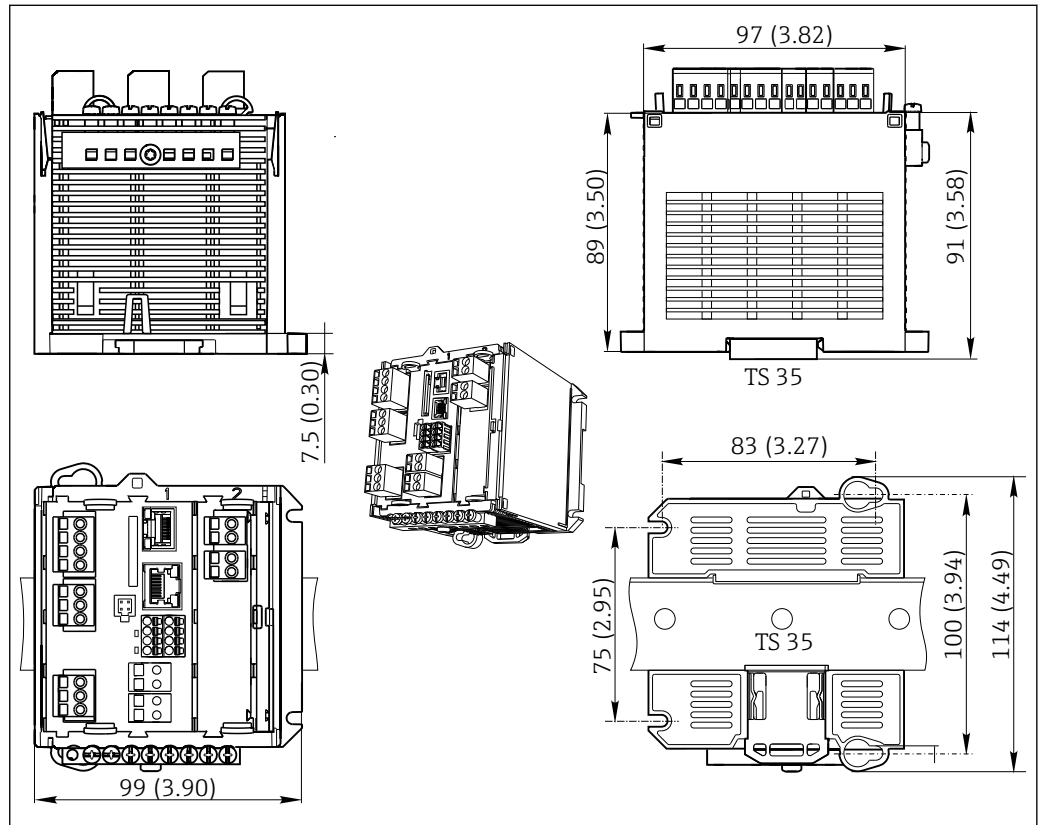

A0039729

6 寸法 (mm (インチ) 単位)

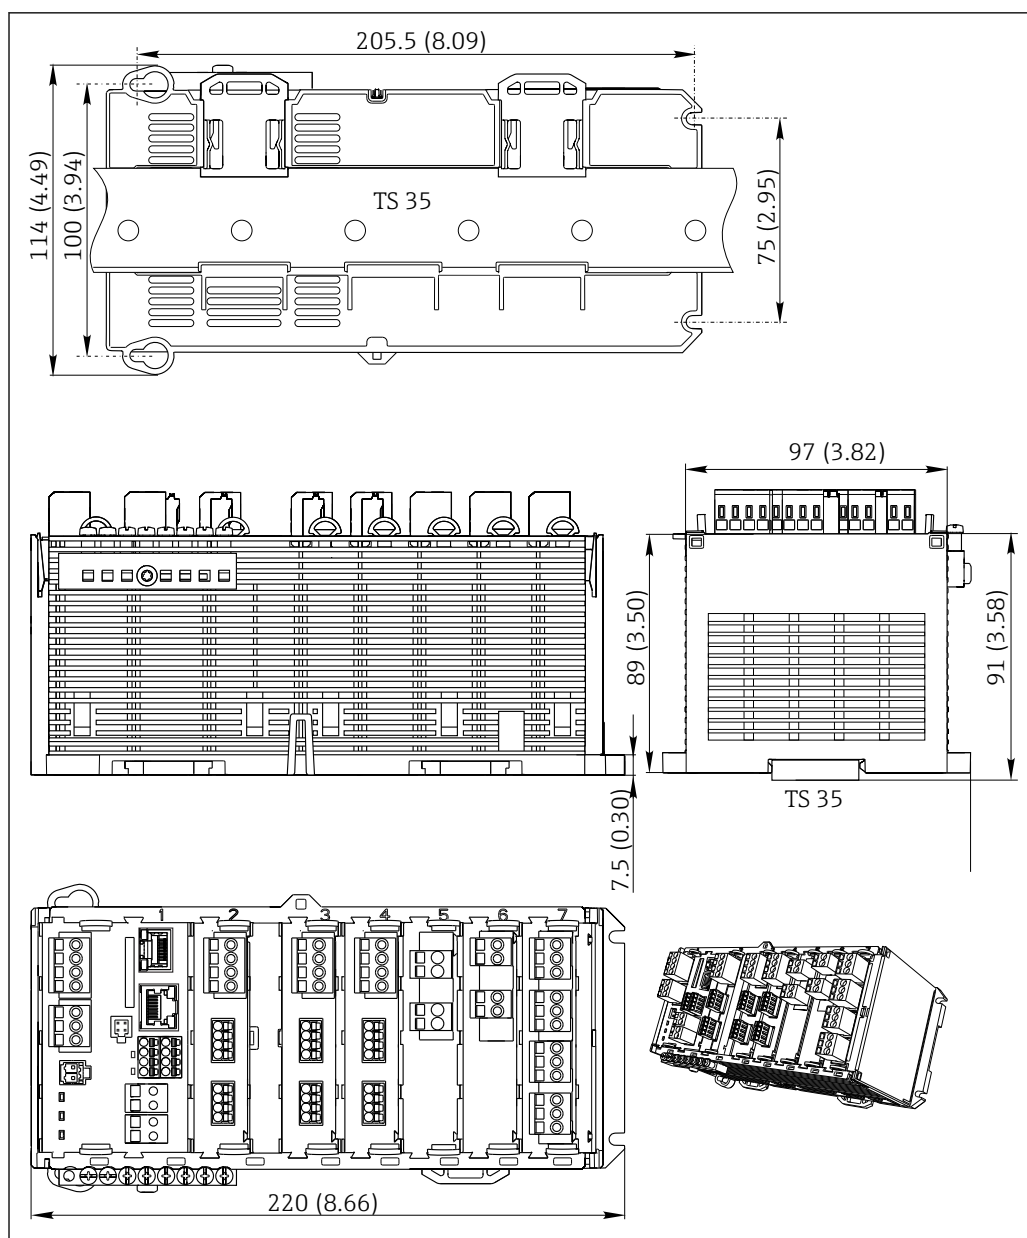

A0039730

図 7 寸法 (mm (インチ) 単位)

5.1.2 IEC 60715 準拠の DIN レール取付

⚠ 注意

電源ユニットは最大負荷で使用すると非常に高温になることがあります。

やけどの危険

- ▶ 作動中の電源ユニットには触らないでください。
- ▶ 他の機器との最小距離を順守してください。
- ▶ 電源ユニットをオフにした後、温度が下がるまで待ってから作業を開始してください。

⚠ 注意

機器内の水分の凝集は許容されません。

ユーザーの安全が危険にさらされます。

- ▶ 本機器には、IP20 準拠の耐衝撃性があります。絶対に機器内に水分が凝集しないようにしてください。
- ▶ たとえば、機器を適切な保護容器に設置するなどして、指定された周囲条件を順守してください。


注記

キャビネット内の取付位置が不適切な場合、距離制限が順守されていない場合
発熱や隣接する機器との干渉により故障が発生する可能性があります。

- ▶ 機器を熱源の真上に配置しないでください。温度仕様に注意してください。
- ▶ 基板および部品は対流冷却するように設計されています。温度上昇を避けてください。開口部がふさがれないように注意してください（例：ケーブルにより）。
- ▶ 他の機器との所定の距離を順守してください。
- ▶ 本機器と周波数変換器や高圧機器を物理的に分離してください。
- ▶ 推奨の取付方向：水平。所定の周囲条件、特に周囲温度については、水平取付にのみ適用されます。
- ▶ 垂直方向への取付も可能です。ただし、機器を DIN レール上の位置に保つため、設置場所に追加の固定クランプが必要となります。
- ▶ CM444R および CM448R の電源ユニットの推奨の設置位置：機器の左側。

以下の最小間隔仕様を順守してください。


- 他の機器（電源ユニットを含む）および操作盤壁面との横方向の距離：
最低 20 mm (0.79 inch)
- 機器の上下および前後の距離（操作盤のドアまたはそこに設置されている他の機器との距離）：
最低 50 mm (1.97 inch)

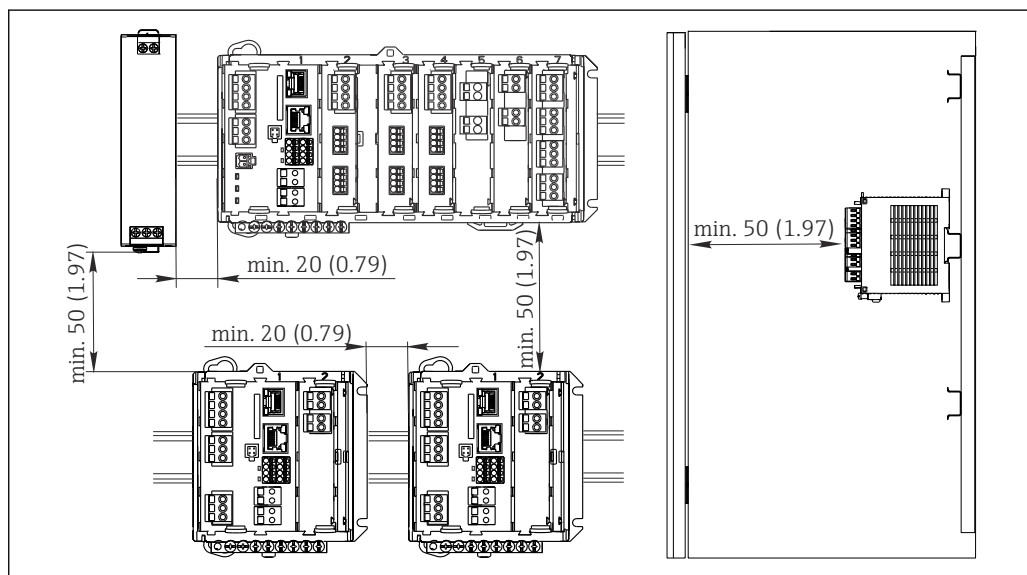

A0039735

図 8 最小間隔 mm (in)

5.1.3 壁面取付け

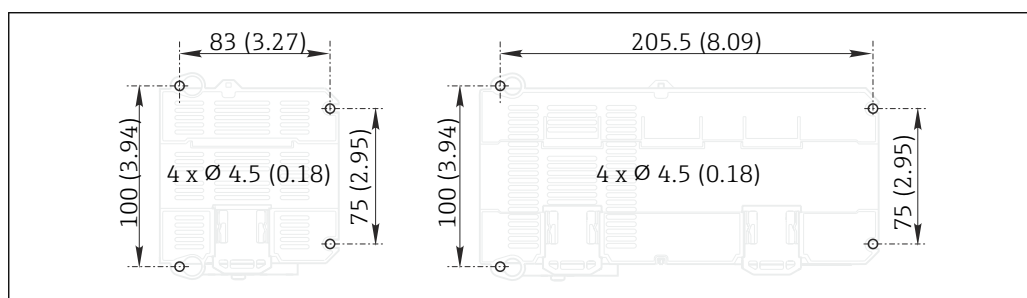

A0025370

図 9 壁面取付の穴あけパターン mm (in)

5.1.4 外部ディスプレイの取付け

i 取付プレートはドリル穴あけテンプレートとしても使用できます。側面のマークはドリル穴の位置を決めるのに役立ちます。

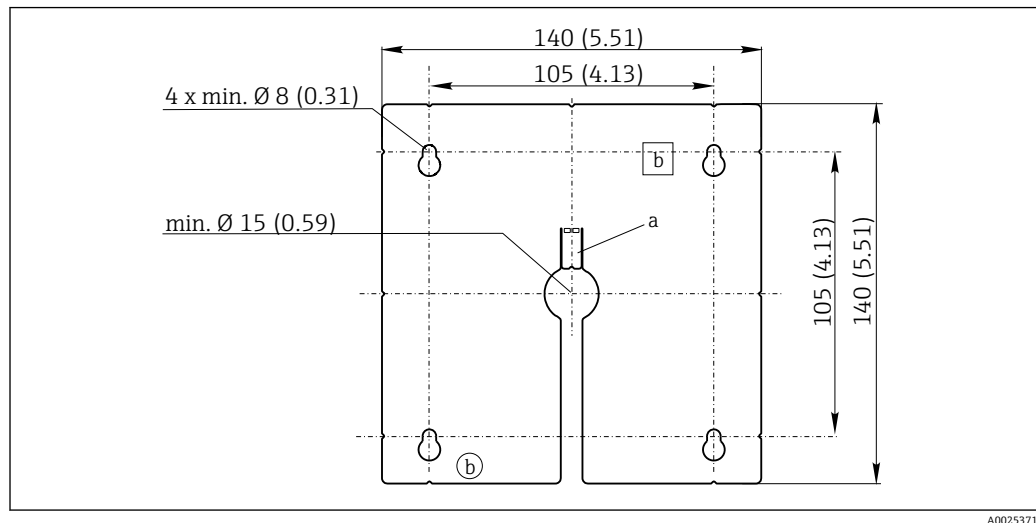


図 10 外部ディスプレイの取付プレート、寸法単位：mm (in)

a 固定タブ

b 製造関連の切欠き、ユーザーには関係ありません。

5.1.5 ディスプレイ（オプション）のケーブル長

納入されるディスプレイケーブルの長さ：

3 m (10 ft)

許容されるディスプレイケーブルの最大長：

5 m (16.5 ft)


5.2 機器の取付け

5.2.1 DIN レール取付け


取付方法はすべての Liquiline 機器に共通です。CM448R が例として示されています。

1. 注文時の設定では、DIN レールを固定するために、固定クリップが「締め付けられて」います。


固定クリップを下向きに引っ張って緩めてください。

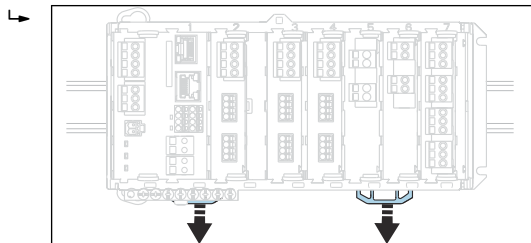

2. 機器を上方から DIN レール (a) に取り付け、押し下げて固定します (b)。

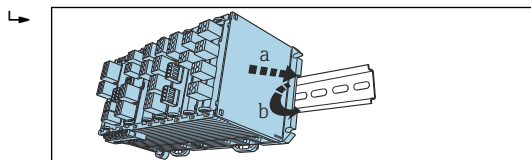

3. 固定クリップをカチッと音がするまでスライドさせると、DIN レールに機器が固定されます。

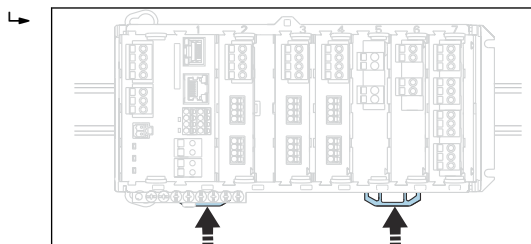

4. **CM444R および CM448R のみ**

同じようにして、外部電源ユニットを取り付けます。

5.2.2 壁面取付け

- i** 取付材料 (ネジ、ダボ) は納入範囲に含まれないため、ユーザーが用意する必要があります。

CM444R および CM448R : 外部電源ユニットは DIN レールにのみ取り付けることが可能です。

ハウジングの裏側を使用して、取付け用の穴をマークします。(→ 図 9, 図 19)

1. 対応する穴をあけて、必要に応じて壁プラグを挿入します。
2. ハウジングを壁にネジで固定します。

5.2.3 外部ディスプレイ（オプション）の取付け



⚠ 注意

バリのある、縁の鋭いドリル穴に注意



けがに注意！ディスプレイケーブルが損傷する恐れがあります。

▶ 特に、ディスプレイケーブル用の中央のドリル穴はバリを取ってください。


操作盤ドアへのディスプレイの取付け

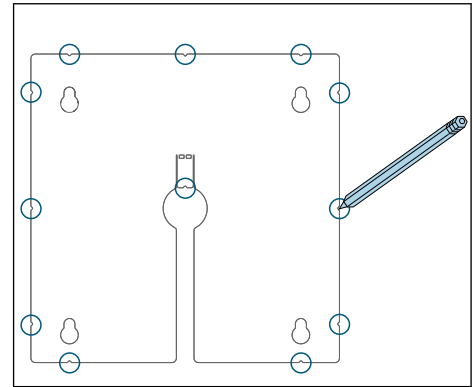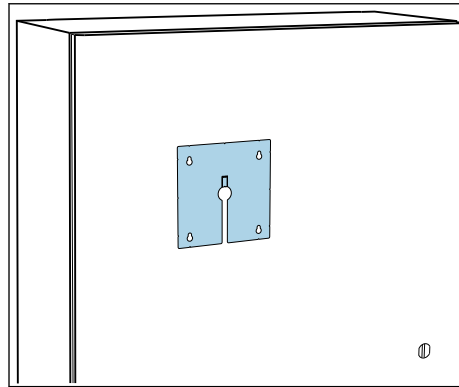


1. 操作盤のドアに対して外側から取付プレートを保持します。ディスプレイを設置したい場所を選択します。
2. すべてのマークを付けます。

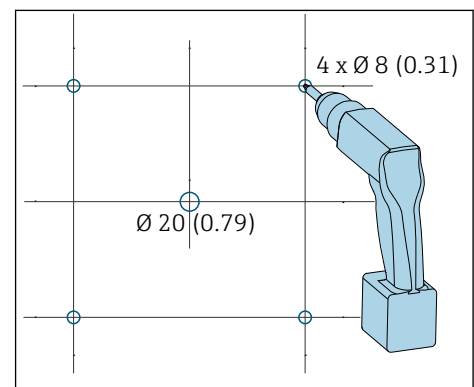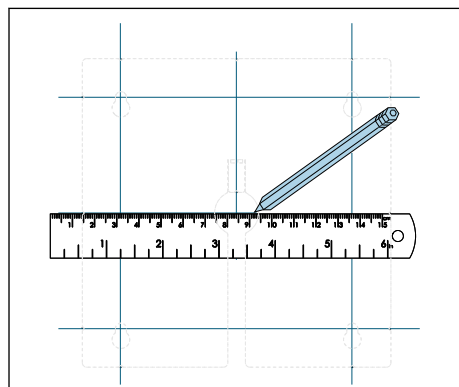

3. 線を引いて、すべてのマークを相互接続します。
↳ これにより、設置に必要な5つのドリル穴の位置が決まります。
4. 穴をあけます (→ 図 10, 図 20)。

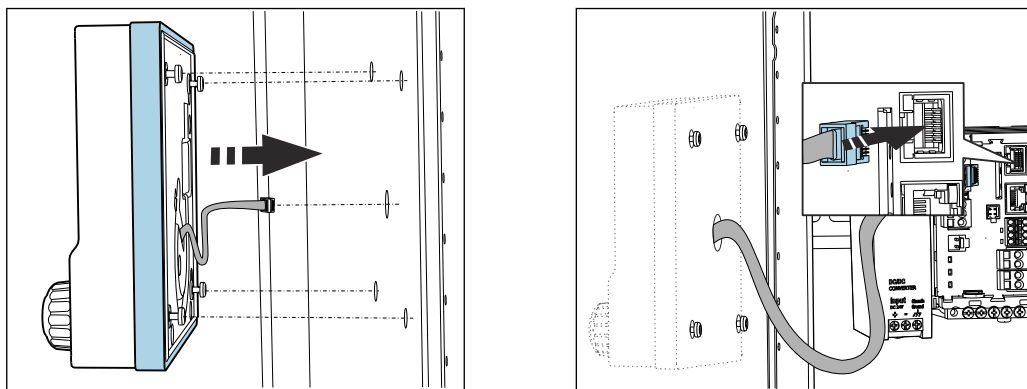

5. 中央のドリル穴にディスプレイケーブルを通して、固定用にあけた4つの穴を使用してディスプレイを外側から固定します。ネジは、ネジが最後に半分回る程度に緩めておく必要があります（ただし、穴に収まっていること）。ラバーフレーム（シール、青くハイライトされた部分）が損傷していないこと、機器がドア表面の正しい位置に取り付けられていることを確認します。
6. ディスプレイケーブルをベースモジュールのRJ-45ソケットに接続します。

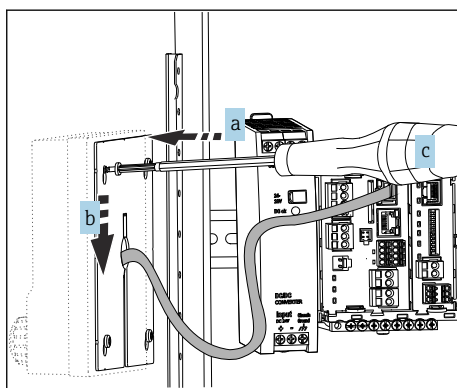

7. 取付プレートを内側からネジに取り付け (a)、プレートを下にスライドさせて (b) ネジを締め付けます (c)。
 ↳ これで、ディスプレイの取付けが完了し、使用する準備が整いました。

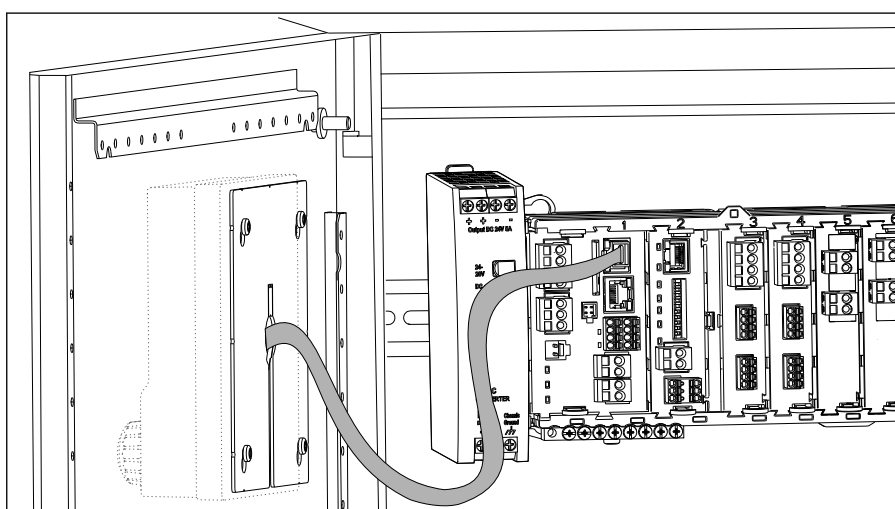


図 11 取付けが完了したディスプレイ

注記**不適切な取付け**

ケーブルなどの損傷または故障の原因となる可能性があります。

- ▶ ケーブルが押しつぶされないように配線してください（例：操作盤ドアを閉じた場合などに）。
- ▶ ディスプレイケーブルはベースモジュールの RJ45 ソケットにのみ接続してください。そうでない場合は、ディスプレイが作動しません。


5.3 設置状況の確認

1. 設置後は、すべての機器（コントローラ、電源ユニット、ディスプレイ）に損傷がないかチェックしてください。
2. 所定の設置間隔が確保されているか確認してください。
3. 固定クリップがすべて所定の位置にカッチッとはめ込まれており、コンポーネントが DIN レール上にしっかりと固定されているか確認してください。
4. 設置位置の温度限界が順守されているか確認してください。

6 電気接続

6.1 接続条件

6.1.1 HART 経由（例：HART モデムおよび FieldCare を使用）

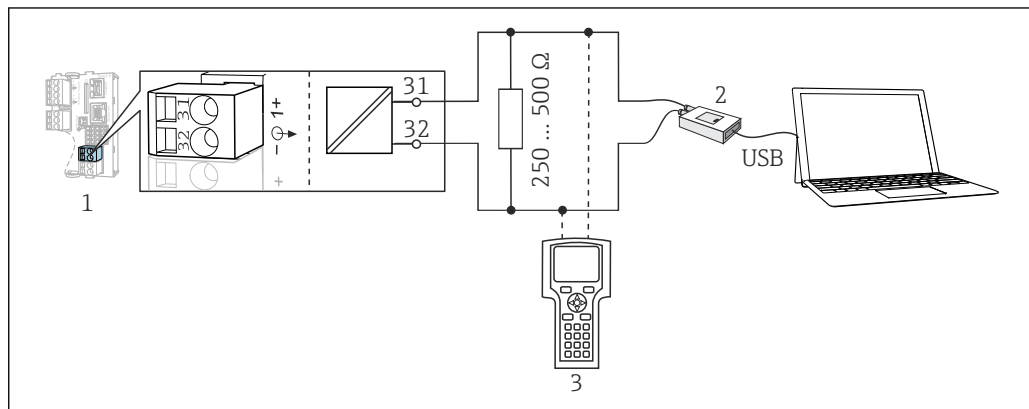


A0039620

図 12 HART モデムを使用

- 1 機器モジュール Base2-L、-H または -E : HART による電流出力 1
 - 2 PC との接続用 HART モデム（例：Commubox FXA191 (RS232) または FXA195 ¹⁾ (USB)
 - 3 HART ハンドヘルドターミナル
- ¹⁾ スイッチ位置「オン」（レジスタの代わり）

6.1.2 PROFIBUS DP 経由

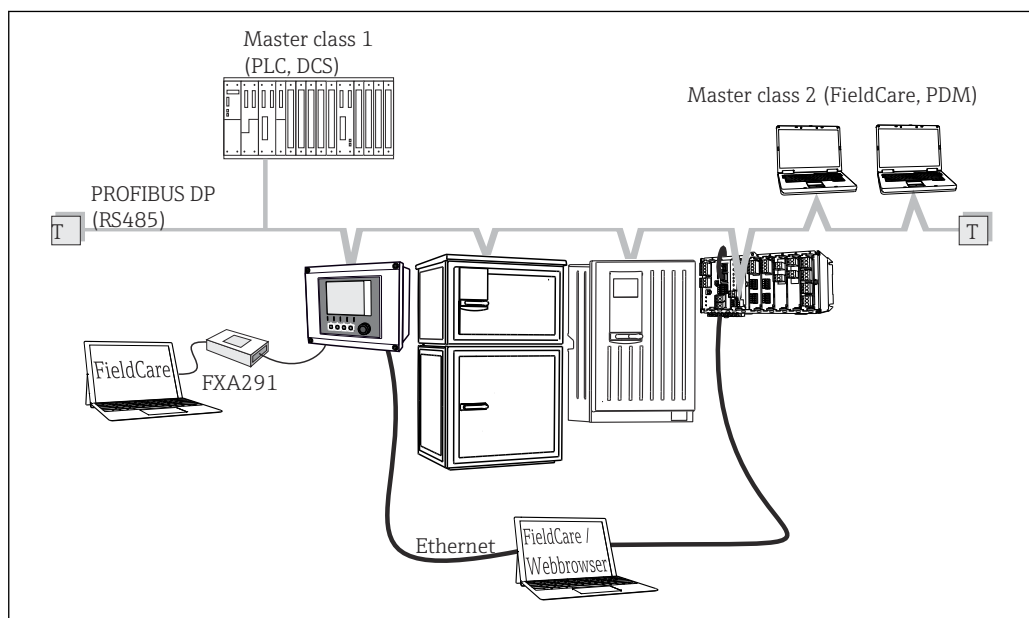

A0039617

図 13 PROFIBUS DP

T 終端レジスタ

6.1.3 Modbus RS485 経由

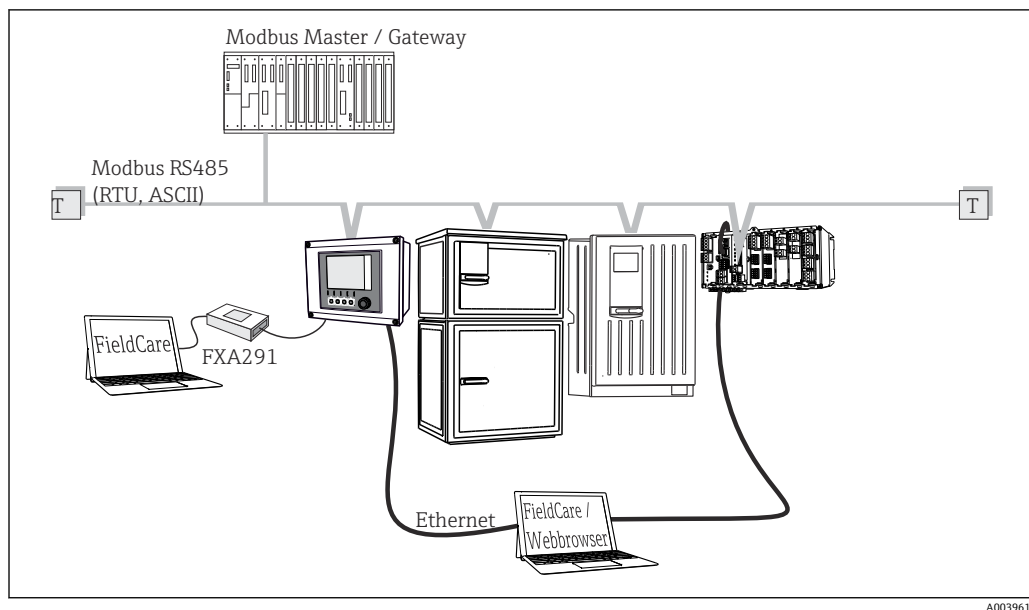


図 14 Modbus RS485

T 終端レジスタ

6.1.4 Ethernet 経由 : Web サーバー/Modbus TCP/PROFINET/EtherNet/IP

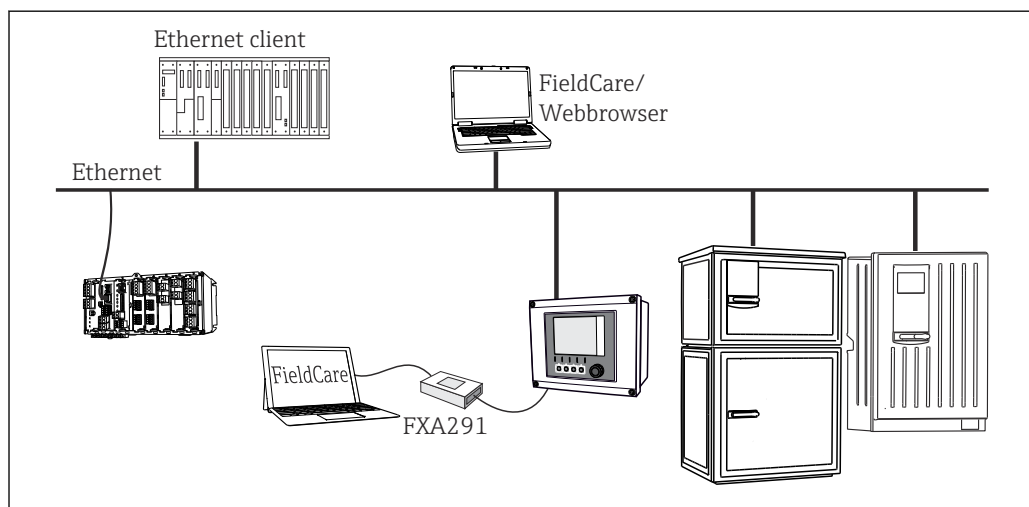


図 15 Modbus TCP または EtherNet/IP または PROFINET

6.2 機器の接続

⚠ 警告

機器には電気が流れています

接続を誤ると、負傷または死亡の危険性があります。

- ▶ 電気接続は電気技師のみが行えます。
- ▶ 電気技師はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
- ▶ 接続作業を始める**前に**、どのケーブルにも電圧が印加されていないことを確認してください。


注記

機器には電源スイッチがありません。

- ▶ 設置場所の機器の近くに保護回路遮断器を用意してください。
- ▶ 遮断器として、スイッチまたは電源スイッチを使用する必要があります。また、必ずこの機器の遮断器であることを記載したラベルを貼付しておいてください。
- ▶ 供給点において、電源は、二重絶縁または強化絶縁（24 V 電源用機器の場合）によって、電気が流れている危険なケーブルから絶縁する必要があります。

6.2.1 ケーブル端子


Memosens 接続用および PROFIBUS/RS485 接続用のプラグイン端子

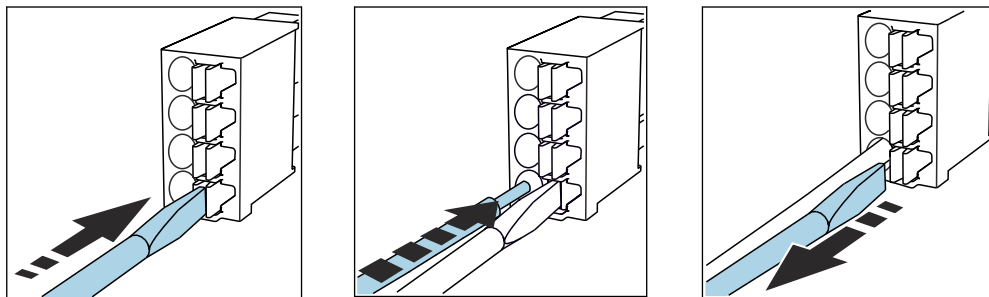

- ▶ クリップにドライバを押し付けます（端子を開く）。
- ▶ 突き当たるまでケーブルを挿入します。
- ▶ ドライバを抜きます（端子を閉じる）。

i 接続後、すべてのケーブル端が所定の位置にしっかりと固定されていることを確認してください。特に終端処理済みケーブルの端は、突き当たるまで正しく挿入されていない場合、簡単に緩む傾向があります。

他のすべてのプラグイン端子

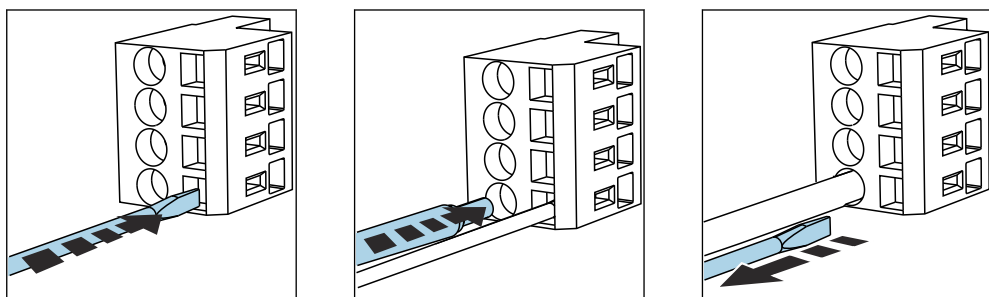

- ▶ クリップにドライバを押し付けます（端子を開く）。
- ▶ 突き当たるまでケーブルを挿入します。
- ▶ ドライバを抜きます（端子を閉じる）。

6.2.2 CM442R の供給電圧の接続

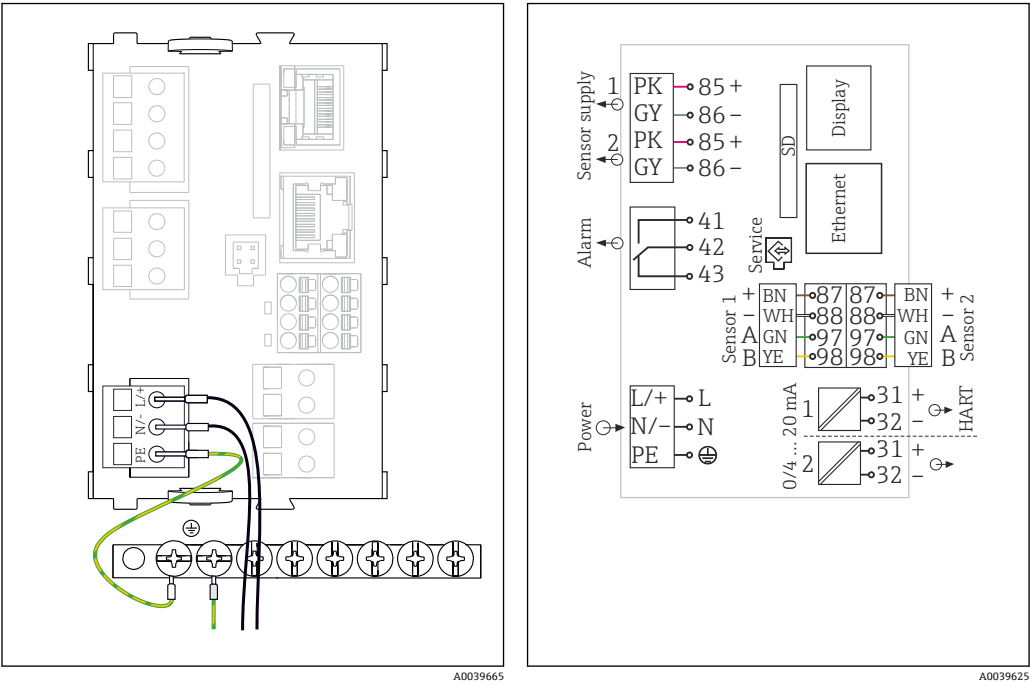


図 16 BASE2-H または -L の電源接続

図 17 BASE2-H または -L の全体配線図

H 電源ユニット AC 100～230 V
L 電源ユニット AC 24 V または DC 24 V


注記

不適切な接続およびケーブルが分離して配線されていない場合

信号またはディスプレイケーブルの干渉、不正確な測定値、表示エラーが発生する可能性があります。

- ▶ ディスプレイケーブルのケーブルシールドを PE に接続しないでください(機器の端子台)。
- ▶ 操作盤内では、信号/ディスプレイケーブルを通电しているケーブルと分離して配線してください。

6.2.3 CM444R および CM448R の供給電圧の接続

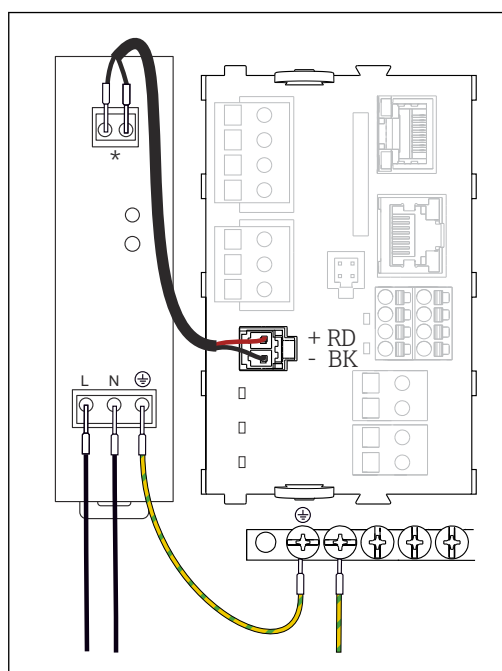

A0039668

図 18 BASE2-E との電源接続

* 電源ユニットに応じた割当て（接続が正しいか確認してください）


i 2つの機器バージョンは、必ず支給される電源ユニットと付属のケーブルを使用し、動作させる必要があります。支給される取扱説明書の情報にも注意してください。

注記

不適切な接続およびケーブルが分離して配線されていない場合

信号またはディスプレイケーブルの干渉、不正確な測定値、表示エラーが発生する可能性があります。

- ▶ ディスプレイケーブルのケーブルシールドを PE に接続しないでください（機器の端子台）。
- ▶ 操作盤内では、信号/ディスプレイケーブルを通电しているケーブルと分離して配線してください。

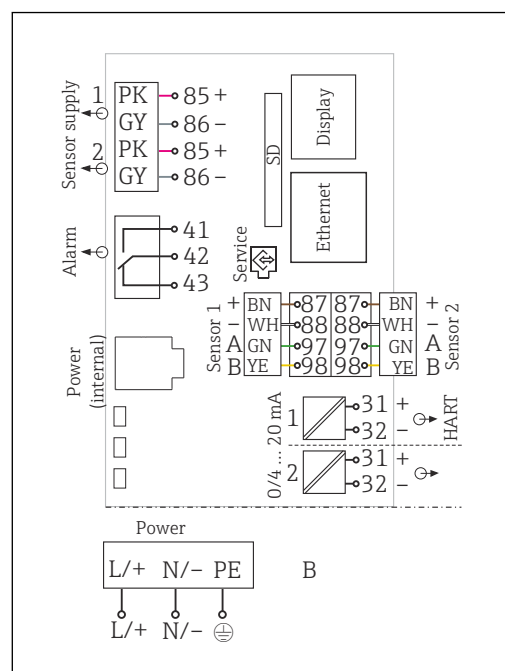

A0039624

図 19 BASE2-E および外部電源ユニット (B) の全体配線図

6.3 センサの接続

6.3.1 Memosens プロトコルを搭載した非危険場所用のセンサタイプ

Memosens プロトコル対応センサ

センサタイプ	センサケーブル	センサ
追加内部電源なしのデジタルセンサ	電磁誘導式プラグインコネクタ付き	■ pH センサ ■ ORP センサ ■ 複合センサ ■ 溶存酸素センサ（隔膜式および光学式） ■ 電極式導電率センサ ■ 塩素センサ（滅菌）
	固定ケーブル	電磁式導電率センサ
追加内部電源付きデジタルセンサ	固定ケーブル	■ 濁度センサ ■ 界面測定用センサ ■ 分光吸光度（SAC）測定用センサ ■ 硝酸センサ ■ 光学式溶存酸素センサ ■ イオン選択性 センサ

CUS71D センサを接続する場合は、以下のルールが適用されます。

- CM442R
 - 接続可能な CUS71D は 1 台のみです。追加のセンサを接続することはできません。
 - 第 2 センサ入力に別のタイプのセンサを使用することもできません。
- CM444R
 - 制約はありません。必要に応じて、すべてのセンサ入力を使用できます。
- CM448R
 - CUS71D を接続する場合、使用可能なセンサ入力の数は最大 4 つに制限されます。
 - 4 つの入力すべてを CUS71D センサに使用できます。
 - 接続するセンサの合計数が 4 台を超えないかぎり、CUS71D と他のセンサを自由に組み合わせて使用できます。

6.3.2 Memosens プロトコルを搭載した危険場所用のセンサタイプ


Memosens プロトコル対応センサ

センサタイプ	センサケーブル	センサ
追加内部電源なしのデジタルセンサ	電磁誘導式プラグインコネクタ付き	■ pH センサ ■ ORP センサ ■ 複合センサ ■ 溶存酸素センサ（隔膜式および光学式） ■ 電極式導電率センサ ■ 塩素センサ（殺菌）
	固定ケーブル	電磁式導電率センサ

 爆発性雰囲気中使用する本質安全センサは、センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i にのみ接続できます。認証の対象になっているセンサのみを接続できます (XA を参照)。

ベースモジュールの非防爆センサ用のセンサ接続は無効になっています。

6.3.3 センサ通信モジュール 2DS Ex-i 用の端子台の取付け

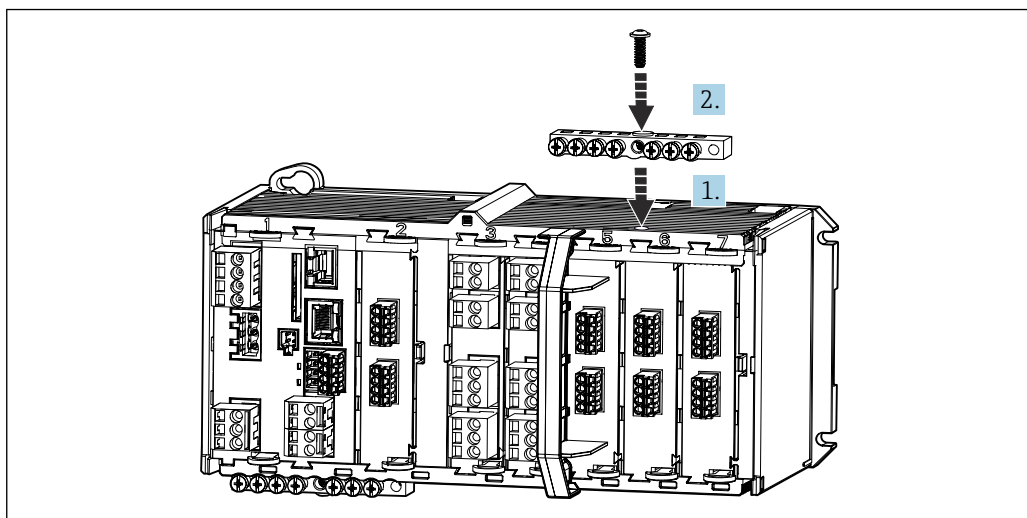


A0045451

1. センサ通信モジュール 2DS Ex-i のネジにケーブルダクトの中心穴を合わせます。
2. ケーブルダクトを締め付けます。
3. ケーブルダクトの接地を確立します（例：ベースモジュールのケーブルダクトを経由）。

6.3.4 機能接地接続

必ず操作盤の中央ノードから端子台に PE を接続する必要があります。
機能接地を機器の端子台と接続するには、Memosens ケーブルと一緒に支給されるケーブルクランプ付きの導体を使用します。

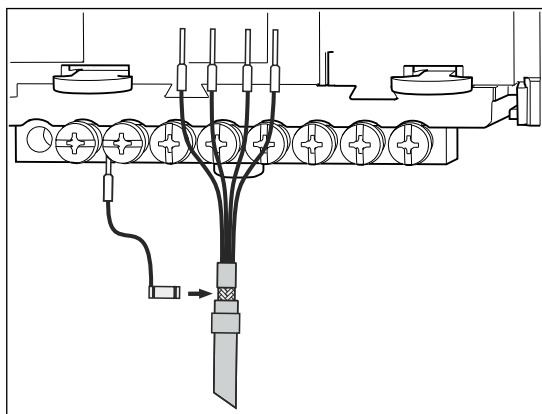

20 保護接地接続

- i** 必ず、端子台の各ネジに対して 1 つの機能接地のみを接続してください。そうでない場合は、遮蔽が保証されません。


6.3.5 非危険場所用のセンサの接続

接続

センサモジュール 2DS またはベースモジュール -L、-H または -E (→ 21 以降) の端子コネクタにセンサケーブルを直接接続


▶ 直接接続されたセンサケーブル

センサケーブルを、センサモジュール 2DS またはベースモジュール Base2-L、-H または -E の Memosens 端子コネクタに接続します。

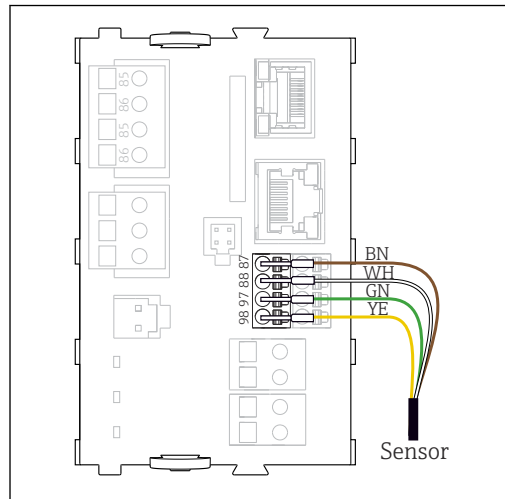


A0039629

図 21 追加供給電圧なしのセンサ

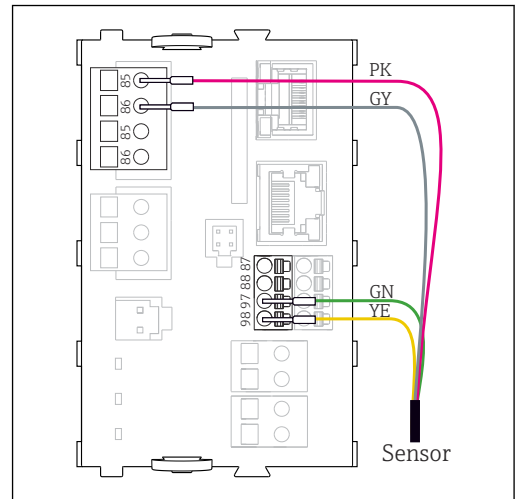

A0039622

図 22 追加供給電圧付きセンサ

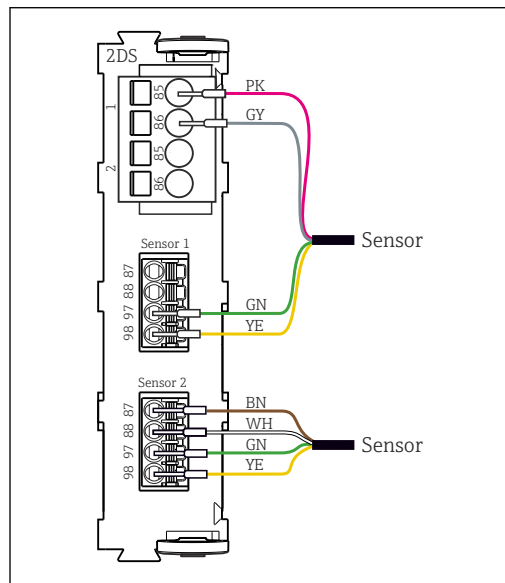


A0033206

図 23 センサモジュール 2DS における追加供給電圧付きセンサと追加供給電圧なしのセンサ

6.3.6 本質安全センサとセンサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i の接続

直接接続されたセンサケーブル

- ▶ センサケーブルをセンサモジュール 2DS Ex-i の端子コネクタに接続します。

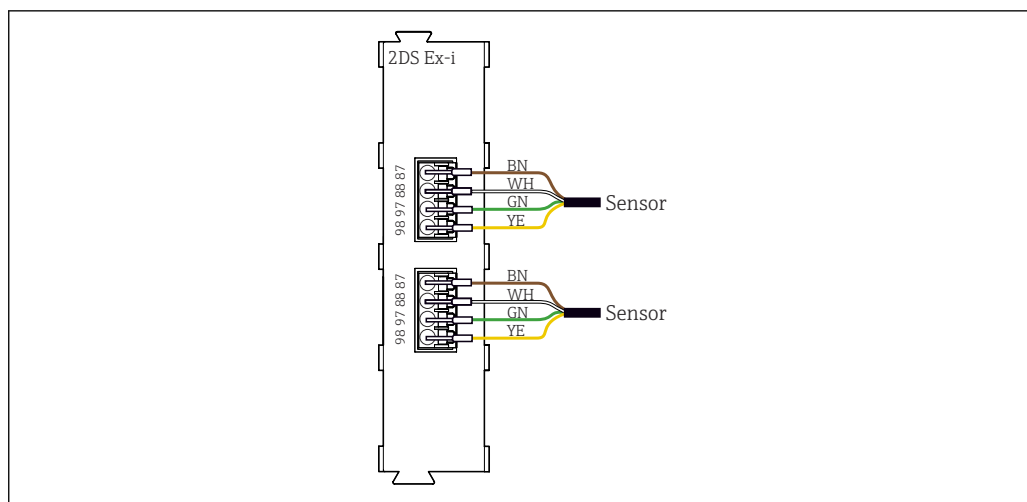

A0045345

図 24 センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i に接続された追加の電源電圧のないセンサ

i 爆発性雰囲気中使用する本質安全センサは、センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i にのみ接続できます。認証の対象になっているセンサのみを接続できます (XA を参照)。

6.4 追加の入力、出力またはリレーの接続

警告

カバーされていないモジュール

衝撃保護されません。感電の危険があります！



- ▶ **非危険場所**用のハードウェアの変更または拡張：スロットは必ず、左から右に挿入してください。隙間を残さないでください。
- ▶ **非危険場所**用の機器で未使用のスロットがある場合：必ずダミーカバーまたはエンドカバーを最後のモジュールの右(→ 図 1, 図 10)のスロットに挿入してください。これにより、ユニットが確実に衝撃保護されます。
- ▶ 特にリレーモジュール (2R、4R、AOR) の場合にユニットが衝撃保護されていることを必ず確認してください。
- ▶ **危険場所**用のハードウェアは変更できません。製造者のサービス部門のみが、認定取得機器を別の認定取得バージョンに改造することができます。これには、内蔵 2DS Ex-i モジュールを搭載した変換器のすべてのモジュール、ならびに非本質安全モジュールに関する変更が含まれます。

i 端子台を使用してケーブルシールドを接続します。

- ▶ 追加のシールドが必要な場合は、ユーザーが用意した端子台を介して操作盤中央の PE に接続してください。

6.4.1 デジタル入力および出力

DIO モジュール

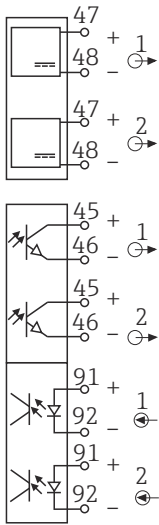
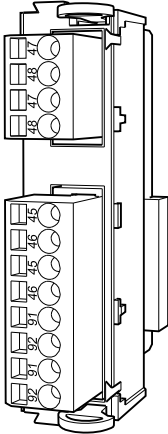


 25 モジュール

 26 配線図

6.4.2 電流入力





モジュール 2AI

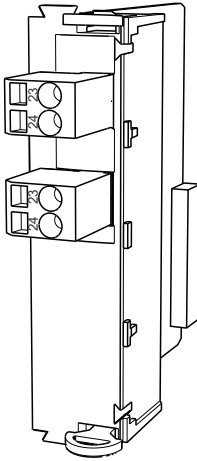





 27 モジュール

 28 配線図

6.4.3 電流出力

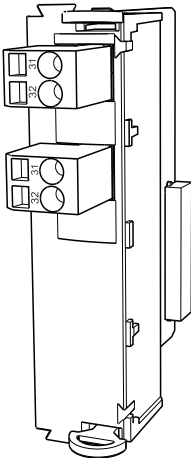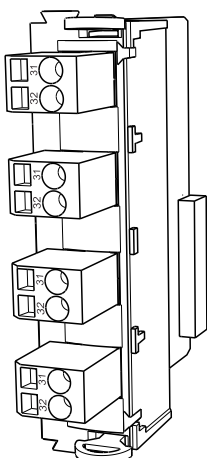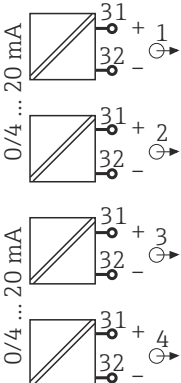2AO		4AO	
			
■ 29 モジュール	■ 30 配線図	■ 31 モジュール	■ 32 配線図

6.4.4 リレー

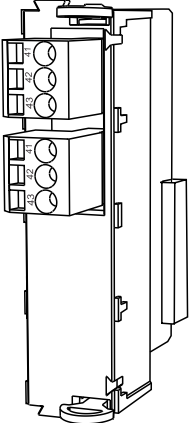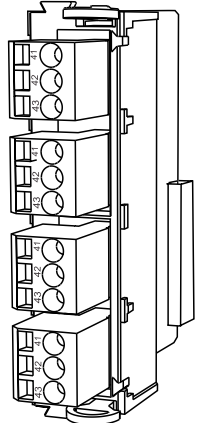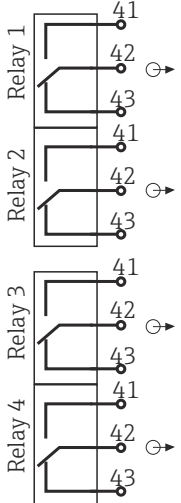
モジュール 2R		モジュール 4R	
			
■ 33 モジュール	■ 34 配線図	■ 35 モジュール	■ 36 配線図

例：CAS40D 用洗浄ユニット 71072583 の接続

注記**Liquiline アラームリレーの消費電力が高すぎる**

ベースモジュールが修繕不可能な損傷を負う可能性があります。


- ▶ 洗浄ユニットは必ず追加モジュール（AOR、2R または 4R）の端子にのみ接続し、ベースモジュールのアラームリレーには**接続しない**でください。

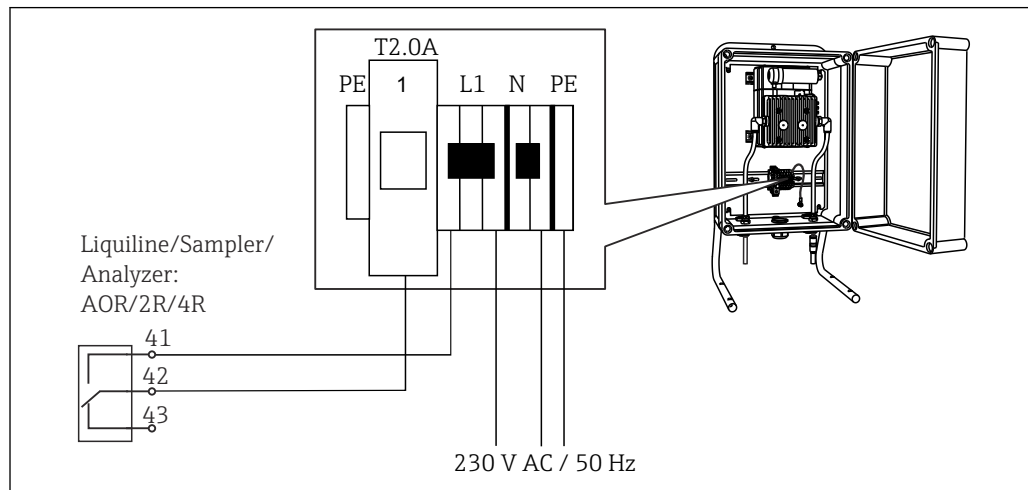

A0028597

図 37 CAS40D 用洗浄ユニットの接続

例：Chemoclean CYR10 インジェクター洗浄ユニットの接続

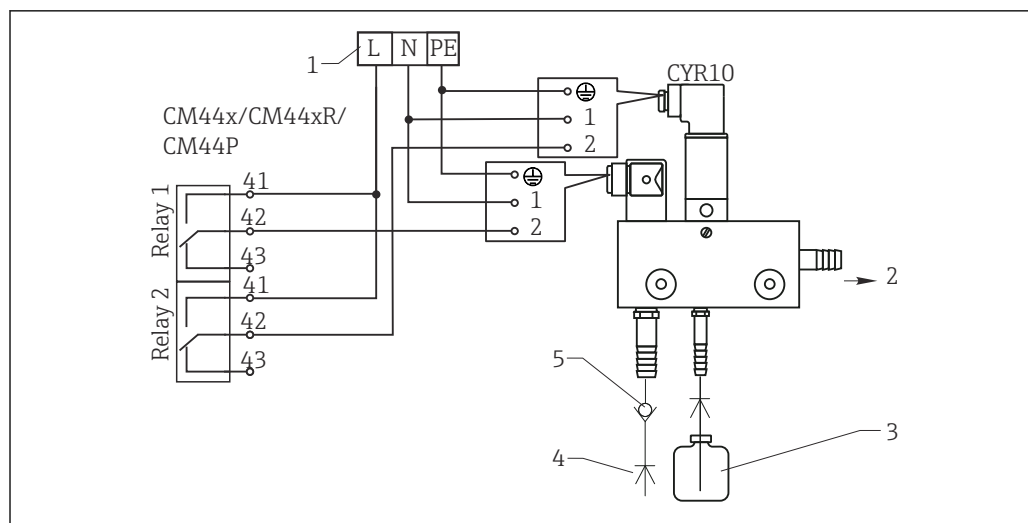


A0028598

図 38 CYR10 インジェクター洗浄ユニットの接続

- 1 外部電源
- 2 スプレーヘッドに供給される洗浄剤
- 3 洗浄剤を含む容器
- 4 2～12 bar (30～180 psi) の誘水
- 5 逆流弁（ユーザーが用意）

6.5 PROFIBUS DP または Modbus RS 485 の接続

6.5.1 モジュール 485

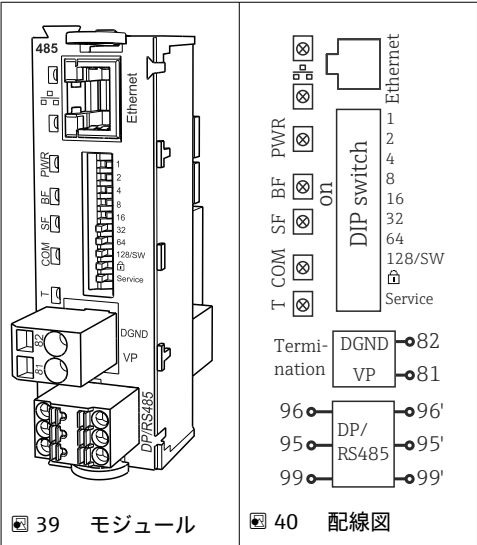

端子	PROFIBUS DP	Modbus RS485
95	A	B
96	B	A
99	接続なし	C
82	DGND	DGND
81	VP	VP

モジュールの正面の LED

LED	名称	色	説明
RJ45	LNK/ACT	緑	RJ45 は使用できません。Ethernet 通信は BASE2 モジュール経由で行われます。
RJ45	10/100	黄	
PWR	電源	緑	供給電圧が印加され、モジュールが初期化されている
BF	バス故障	赤	バス故障
SF	システム故障	赤	内部エラー
COM	通信	黄	送信または受信された Modbus メッセージ
T	バス・ターミネーション	黄	■ 消灯 = 終端なし ■ 点灯 = 終端が使用されている

モジュールの正面の DIP スイッチ

DIP	初期設定	割当て
1-128	ON	バスアドレス (→ 「設定/通信」)
⌘	OFF	書き込み保護 : "ON" = バスを介した設定は不可、ローカル操作を介した設定のみ
サービス	OFF	スイッチには機能が設定されていません。

6.5.2 バス終端処理

バスを終端処理する 2 つの方法：

1. 内部終端処理（モジュール基板の DIP スイッチを使用）

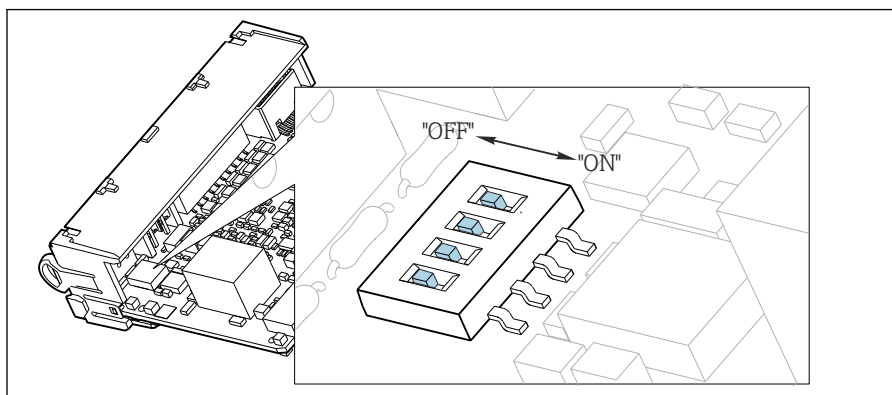


図 41 内部終端処理用の DIP スイッチ

- ▶ ピンセットなどの工具を用いて、4 つの DIP スイッチをすべて「ON」位置に設定してください。
- ↳ 内部終端が使用されます。

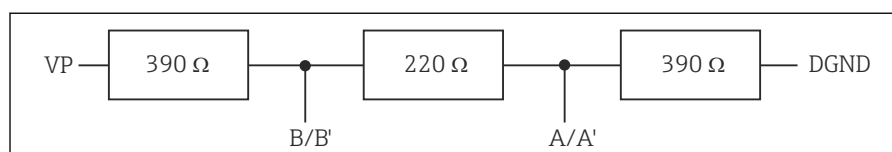


図 42 内部終端の構造

2. 外部終端処理

モジュール基板の DIP スイッチを「OFF」位置（初期設定）のままにしておいてください。


- ▶ 外部終端を 5V 電源用モジュール 485 の正面の端子 81 および 82 に接続してください。
- ↳ 外部終端が使用されます。

6.6 ハードウェア設定

バスアドレスの設定

1. ハウジングを開きます。
2. モジュール 485 の DIP スイッチを介して必要なバスアドレスを設定します。

i PROFIBUS DP の場合、有効なバスアドレスは 1～126 で、Modbus の場合は 1～247 です。無効なアドレスを設定すると、ローカル設定またはフィールドバスを介してソフトウェアアドレス指定が自動的に有効になります。

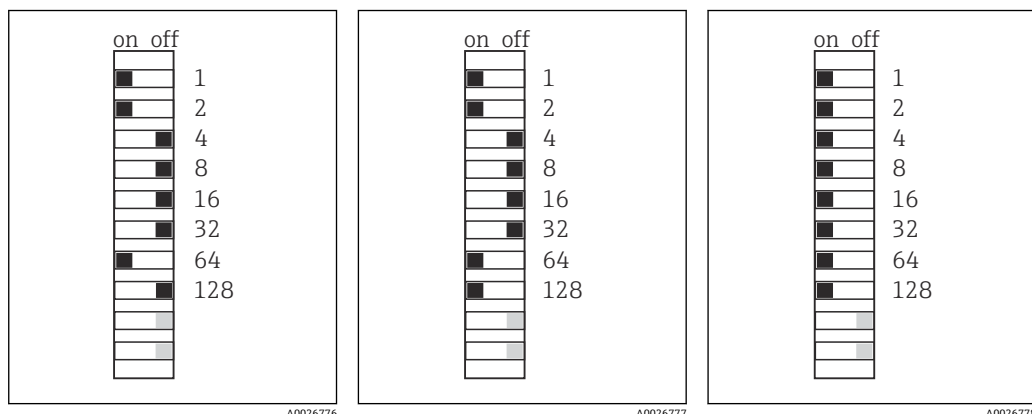

■ 43 有効な PROFIBUS アドレス 67

■ 44 有効な Modbus アドレス 195

■ 45 無効なアドレス 255 ¹⁾

¹⁾ 発注時の設定、ソフトウェアアドレス指定が有効、工場で設定されたソフトウェアアドレス：PROFIBUS 126、Modbus 247

6.7 保護等級の保証

この機器に使用できるのは、これらの説明書で説明する機械的接続と電気的接続のみであり、各接続は指定された用途に応じて必要になります。

▶ 作業時には十分に注意してください。

この製品で個別に確認されている保護等級（気密性（IP）、電気的安全性、EMC 干渉波の適合性、防爆）はは次のような場合には保証されません。

- カバーが外れている
- 支給されたものではない電源ユニットを使用する
- ケーブルグラウンドの締付けが不十分（IP 保護等級を保証するには 2 Nm (1.5 lbf ft) Nm の締付けが必要）
- ケーブルグラウンドに適合しないケーブル径が使用される
- モジュールが完全に固定されていない
- ディスプレイが完全に固定されていない（密閉性が不十分なため湿気が侵入する危険性あり）
- ケーブル/ ケーブルの端の緩みまたは不十分な締付け
- 機器に導電性ケーブルストランドが残されている

6.8 配線状況の確認

警告

接続エラー

接続を誤ると、作業員の安全性および測定点が危険にさらされます。製造者は、本説明書の指示に従わなかった結果として生じたエラーおよび損害について一切の責任を負いません。

- ▶ 次の**すべての**チェック項目が確実に施工されていることを**確認した上**、機器を作動させてください。

機器の状態および仕様

- ▶ 機器およびすべてのケーブルの表面に損傷はありませんか？

電気接続

- ▶ 取り付けたケーブルの歪みは解消されていますか？
- ▶ ケーブルが輪になったり交差したりしていませんか？
- ▶ 信号ケーブルが、配線図に従って正しく接続されていますか？
- ▶ すべてのプラグイン端子がしっかりとめ込まれていますか？
- ▶ すべての接続ワイヤはしっかりとケーブル端子に接続されていますか？

7 システム統合

7.1 Web サーバー

i フィールドバスなしのバージョン：Web サーバーのアクティベーションコードが必要です。

7.1.1 接続

► Base2 モジュールの Ethernet ポートにコンピュータの通信ケーブルを接続します。

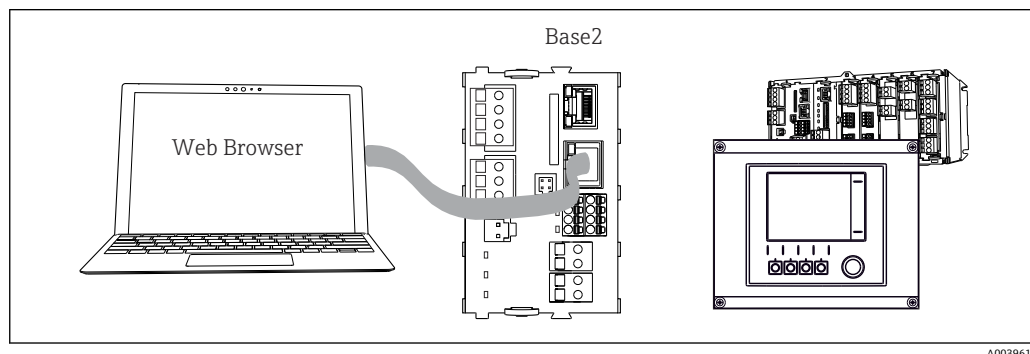


図 46 Web サーバー/Ethernet 接続

7.1.2 データ接続の確立

PROFINET を除くすべてのバージョン：

機器に有効な IP アドレスが割り当てられるよう、Ethernet 接続で **DHCP** パラメータを無効にする必要があります。(メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/イーサネット/設定)

同じメニューを使用して IP アドレスを手動で割り当てることもできます (ポイントツーポイント接続)。

PROFINET を含むすべてのバージョン：

機器の IP アドレスおよびサブネットマスクは **DIAG/システム情報/イーサネット** にあります。

1. PC を起動します。
2. まず、オペレーティングシステムのネットワーク接続設定で手動 IP アドレスを設定します。

例：Microsoft Windows 10

3. ネットワークと共有センターを開きます。
 - ↳ 標準のネットワークとは別に、追加のイーサネット接続が表示されます (例：「未確認ネットワーク」)。
4. この Ethernet 接続のリンクを選択します。
5. ポップアップウィンドウで「プロパティ」ボタンを選択します。
6. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をダブルクリックします。
7. 「次の IP アドレスを使用する」を選択します。
8. 必要な IP アドレスを入力します。このアドレスは、機器の IP アドレスと同じサブネット内に存在する必要があります。例：
 - ↳ Liquiline の IP アドレス：192.168.1.212 (事前に設定)
 - PC の IP アドレス：192.168.1.213
9. インターネットブラウザを起動します。

10. プロキシサーバーを使用してインターネットに接続する場合：
プロキシを無効にします（「接続/LAN の設定」の下のブラウザの設定）。
 11. アドレスバーに機器の IP アドレスを入力します（例：192.168.1.212）。
↳ 接続の確立にしばらく時間がかかり、その後、CM44 Web サーバーが起動します。パスワードを要求される場合があります。初期設定ではユーザー名が「admin」、パスワードが「admin」となっています。
 12. 次のアドレスを入力してログブックをダウンロードします。
↳ 192.168.1.212/logbooks_csv.fhtml （CSV 形式のログブックの場合）
192.168.1.212/logbooks_fdm.fhtml （FDM 形式のログブックの場合）
- i** FDM 形式でのダウンロードは、エンドレスハウザー社の「フィールドデータマネージャソフトウェア」を使用して伝送、保存、視覚化することが可能です。
(→ www.endress.com/ms20)

7.1.3 操作

Web サーバーのメニュー構造は本体操作に対応しています。

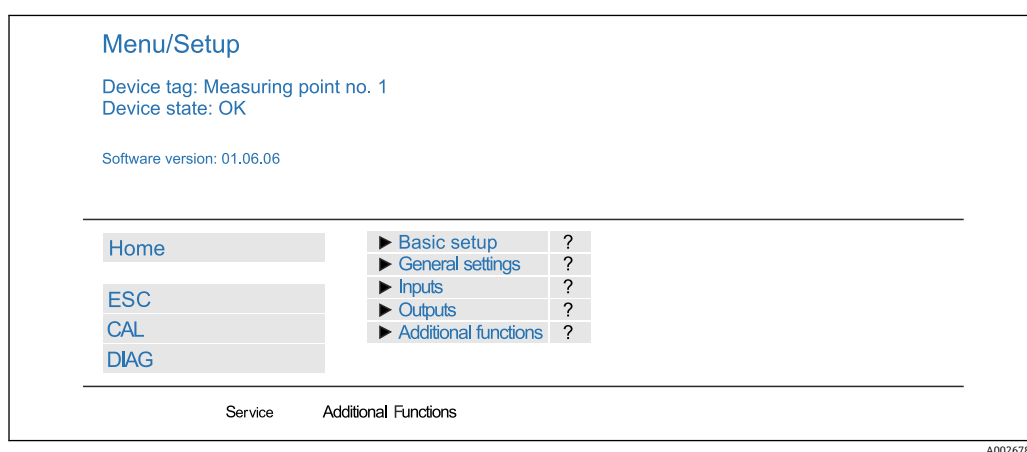


図 47 Web サーバーの例（メニュー/言語 = 英語）

- メニュー名または機能をクリックすることは、ナビゲータを押すことに対応します。
- コンピュータのキーボードを使用して設定を簡単に行うことができます。

i インターネットブラウザの代わりに、Ethernet を介した設定に FieldCare を使用することもできます。そのために必要な Ethernet DTM は、「Endress+Hauser インターフェイス機器 DTM ライブラリ」の不可欠な要素となっています。

ダウンロード： <https://portal.endress.com/webdownload/FieldCareDownloadGUI/>

7.1.4 Heartbeat 検証

Heartbeat 検証を Web サーバーから開始することもできます。これには、SD カードを使用しなくてもブラウザで結果を直接確認できるというメリットがあります。


1. メニューを開きます：**診断/システムテスト/Heartbeat**。
2. **ベリフィケーション実行** を選択します。
3. **▶検証結果**（即座に結果を表示して SD カードにエクスポート）または**追加機能**（下限ラインを下回った場合の追加メニュー→ 図 47）を選択します。
4. **追加機能/Heartbeat**：PDF ファイルの言語を選択します。
↳ 検証レポートがブラウザに表示され、これを印刷したり、PDF ファイルとして保存したりすることができます。

7.2 サービスインターフェイス

サービスインターフェイスを介して機器をコンピュータに接続し、「FieldCare」を使用して設定することができます。さらに、設定を保存、転送および文書化することもできます。

7.2.1 接続

1. Liquiline のベースモジュール上のインターフェイスにサービスコネクタを接続し、これを Commubox に接続します。
2. USB 接続を介して、Commubox を FieldCare がインストールされているコンピュータに接続します。

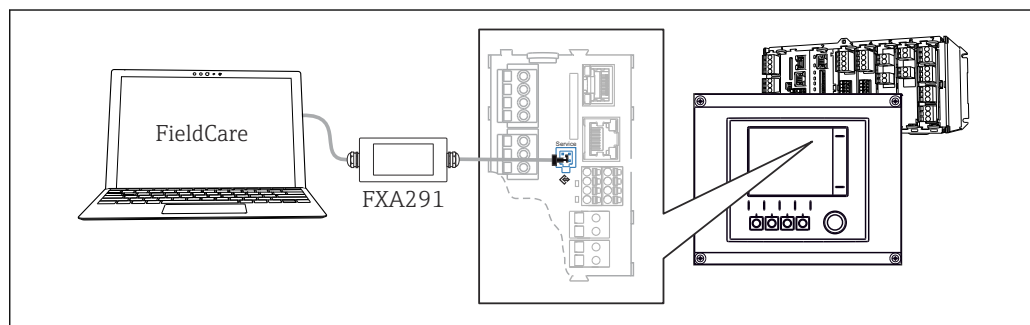

A0039618

図 48 接続概要

7.2.2 データ接続の確立

1. FieldCare を開始します。
2. Commubox への接続を確立します。それには、「CDI 通信 FXA291」ComDTM を選択します。
3. 次に「Liquiline CM44x」DTM を選択し、設定を開始します。

これで DTM を介してオンライン設定を開始できるようになりました。

オンライン設定は機器の現場操作と競合します。つまり、オンライン設定と現場操作は相互に競合（ブロック）します。両側で、反対側からのアクセスを取り除くことができます。

7.2.3 操作

- DTM のメニュー構造は本体操作に対応しています。Liquiline ソフトキーの機能は、左側のメインウィンドウに表示されます。
- メニュー名または機能をクリックすることは、ナビゲータを押すことに対応します。
- コンピュータのキーボードを使用して設定を簡単に行うことができます。
- FieldCare を使用して、ログブックを保存し、設定のバックアップを作成し、他の機器に設定を転送することができます。
- 設定を印刷したり、PDF として保存することもできます。

7.3 フィールドバス

7.3.1 HART

電流出力 1 を介して HART プロトコルを使用して通信できます。

1. 電流出力 1 に HART モデムまたは HART ハンドヘルドターミナルを接続します（通信抵抗 250～500 Ω）。
2. HART 機器を介して接続を確立します。

3. HART 機器を介して Liquiline を操作します。操作方法については、取扱説明書の指示に従ってください。

 HART 通信の詳細については、インターネットの製品ページ (→ BA00486C) を参照してください。

7.3.2 PROFIBUS DP

フィールドバスモジュール 485 と適切な機器バージョンを使用すると、PROFIBUS DP を介して通信できます。

- ▶ 記載された方法でフィールドバスモジュールの端子に PROFIBUS データケーブルを接続します (→ 図 37)。

 「PROFIBUS 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ (→ SD01188C) を参照してください。

7.3.3 Modbus

フィールドバスモジュール 485 と適切な機器バージョンを使用すると、Modbus RS485 を介して通信できます。

Modbus TCP 用 BASE2 モジュールを使用します。

RTU および ASCII プロトコルは Modbus RS485 を介して接続すると使用できます。本機器で ASCII に切り替えることが可能です。

- ▶ 記載された方法でフィールドバスモジュール (RS 485) の端子または BASE2 モジュールの RJ45 ソケットに Modbus データケーブルを接続します。

 「Modbus 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ (→ SD01189C) を参照してください。

7.3.4 EtherNet/IP

BASE2 モジュールと適切な機器バージョンを使用すると、Ethernet/IP を介して通信できます。

- ▶ BASE2 モジュールの RJ45 ソケットに EtherNet/IP データケーブルを接続します。

 「EtherNet/IP 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ (→ SD01293C) を参照してください。

7.3.5 PROFINET

BASE2 モジュールと適切な機器バージョンを使用すると、PROFINET を介して通信できます。


- ▶ BASE2 モジュールの RJ45 ソケットに PROFINET データケーブルを接続します。

 「PROFINET 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ (→ SD02490C) を参照してください。

8 操作オプション

8.1 概要

8.1.1 表示部および操作部（オプションのディスプレイ付きのみ）

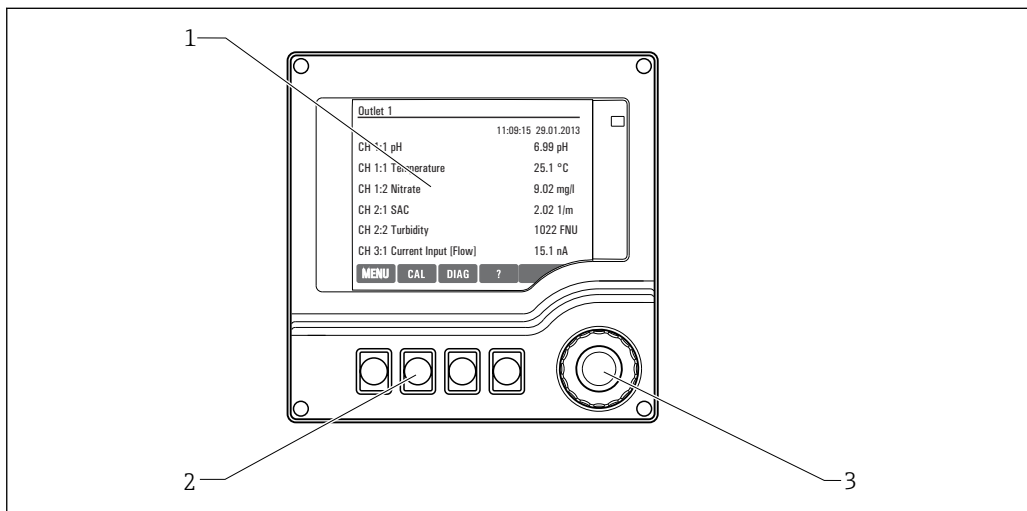


A0025231

49 操作の概要

- 1 表示部（アラーム状態ではバックグラウンドが赤色に変化）
- 2 ソフトキー（機能はメニューによって異なる）
- 3 ナビゲータ（ジョグ/シャトルおよび押す/ホールド機能）

8.1.2 表示

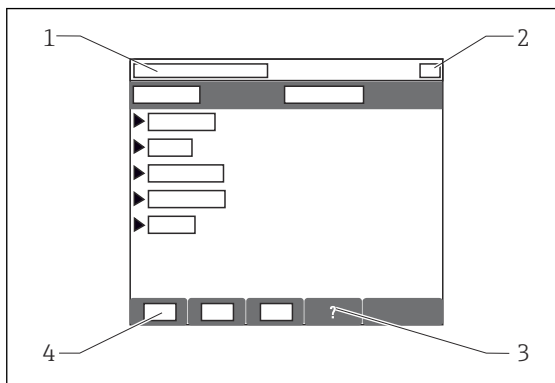


- 1 メニューパスおよび/または機器の ID
- 2 ステータス表示
- 3 利用可能な場合は、ヘルプ
- 4 ソフトキーの割り付け


A0037692

8.2 現場表示器による操作メニューへのアクセス


8.2.1 操作コンセプト（オプションのディスプレイを使用）

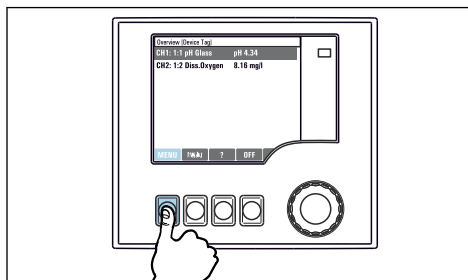


▶ ソフトキーを押す：メニューを直接選択します

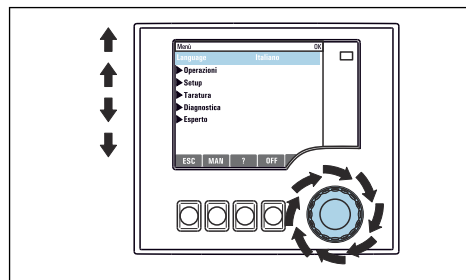


▶ ナビゲータをまわす：メニューのカーソルを移動させます

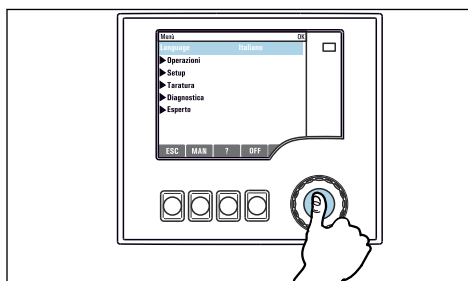


▶ ナビゲータを押す：機能を起動します

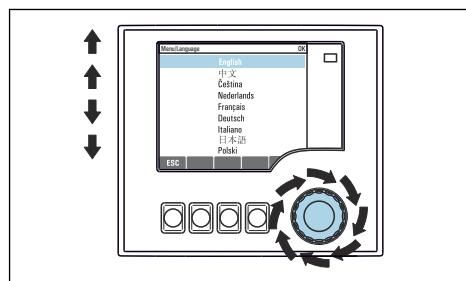

▶ ナビゲータをまわす：（例えば、リストから）値を選択します

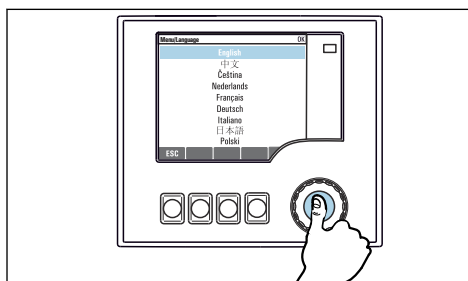

▶ ナビゲータを押す：新しい値を採用します

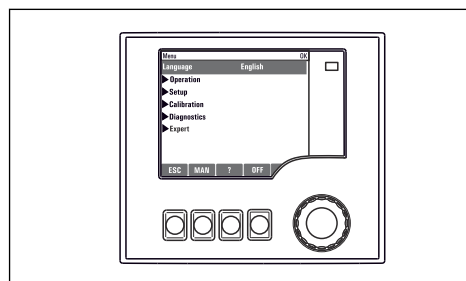

↳ 新しい設定が受け入れられました

8.2.2 操作キーのロックまたはロック解除

操作キーのロック

1. ナビゲータを 2 秒以上押します。

- ↳ 操作キーをロックするためのコンテキストメニューが表示されます。
キーのロックでは、パスワード保護の有無を選択できます。「パスワードあり」を選択した場合、正しいパスワードを入力しないとキーをロック解除できなくなります。このパスワードは以下で設定できます：**メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/データマネージメント/キーロックパスワードを変更してください**を選択します。

2. キーをロックする場合のパスワード使用の有無を選択します。
 - ↳ キーがロックされ、入力できなくなります。ソフトキーのバーに  シンボルが表示されます。

 機器の工場出荷時のパスワードは 0000 に設定されています。**パスワードを変更した場合は必ず書き留めておいてください。**パスワードを忘れてしまった場合、キーパッドをロック解除できなくなってしまうします。

操作キーのロック解除

1. ナビゲータを 2 秒以上押します。
 - ↳ 操作キーをロック解除するためのコンテキストメニューが表示されます。
2. **キーロック解除** を選択します。
 - ↳ キーのロックにパスワードを使用していない場合は、キーが即座にロック解除されます。パスワードを使用している場合は、パスワードの入力を求められます。
3. キーパッドをパスワードで保護している場合のみ、正しいパスワードを入力します。
 - ↳ キーがロック解除されます。これで現場の操作全体にアクセスできるようになります。 シンボルがディスプレイに表示されなくなります。

8.3 設定オプション

8.3.1 表示のみ


- 値を読み取ることのみ可能です。変更することはできません。
- 標準的な読み取り専用値：センサデータ、システム情報
- 例：メニュー/設定/入力/./センサタイプ

8.3.2 選択リスト

- オプションのリストが表示されます。場合によっては、これは複数選択ボックスの形で表示されることもあります。
- 通常は 1 つのオプションのみを選択します。まれに、1 つ以上のオプションを選択する場合があります。
- 例：メニュー/設定/一般設定/温度単位

8.3.3 数値

- 変数を変更します。
- この変数の最大値および最小値がディスプレイに表示されます。
- このリミット内で値を設定します。
- 例：メニュー/動作/ディスプレイ/コントラスト

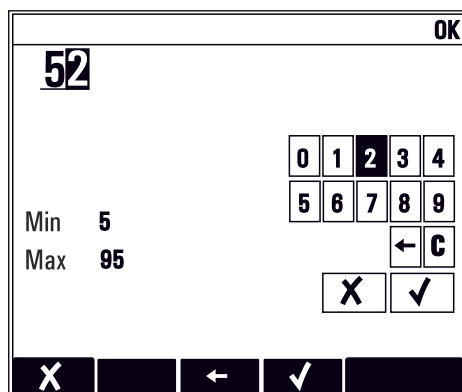


8.3.4 アクション

- 適切な機能を持つアクションを実行します。
- 次の記号が先行している場合、当該項目がアクションであることが分かります。▷
- 典型的なアクションの例には、以下のものがあります。
 - ログエントリーの削除
 - 設定の保存またはロード
 - 洗浄プログラムの実行
- 例：診断/ログブック/設定ログブック/全ての登録を削除


8.3.5 フリーテキスト

- 個々の ID を割り当てます。
- テキストを入力してください。この目的のためにエディタで文字（大文字、小文字、数字、特殊文字）を使用できます。
- ソフトキーを使用して、次のことができます。
 - データを保存せずに入力をキャンセル (x)
 - カーソルの前の文字を削除 (X)
 - カーソルを 1 つ前の位置に移動 (←)
 - 入力を終了し、保存 (✓)
- 例：メニュー/設定/一般設定/デバイスタグ

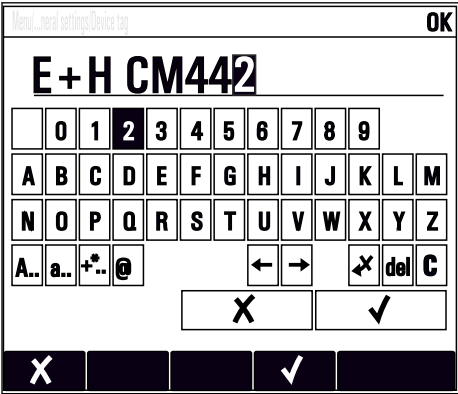

8.3.6 表

- 演算機能のマッピングにはテーブルが必要です。
- テーブルを編集するには、ナビゲータで行および列内を移動し、セルの値を変更します。
- 数値のみ編集できます。コントローラが工学単位を自動的に処理します。
- テーブルへの行の追加 (INSERT)、またはテーブルから行の削除 (DEL)。
- その後、テーブルを保存します (SAVE)。
- また、ソフトキー X を使用して、いつでも入力をキャンセルできます。
- 例：メニュー/設定/入力/pH/測定液補償

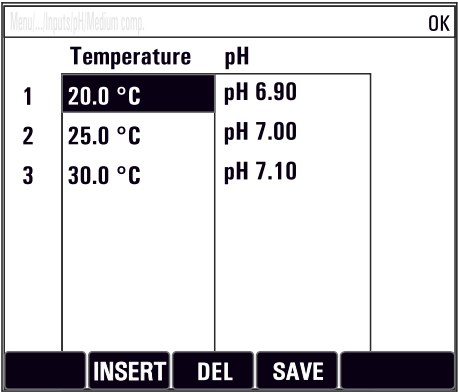

9 設定

9.1 機能チェック

警告

接続が間違っている。供給電圧が間違っている。

要員の安全性に関するリスクと機器の誤動作

- ▶ すべての接続が配線図どおりに正しく行われていることをチェックしてください。
- ▶ 供給電圧が銘板に示されている電圧と一致していることを確認してください。

設定をスクリーンショットで保存

オプションのディスプレイを使用して、いつでもスクリーンショットを撮り、それをSDカードに保存することができます。

1. ベースモジュールのSDカードスロットにSDカードを挿入します。
2. ナビゲータボタンを3秒以上押します。
3. コンテキストメニューで **スクリーンショット** 項目を選択します。
 - ↳ 現在の画面がビットマップファイルとしてSDカードの「スクリーンショット」フォルダに保存されます。

9.2 起動

i 機器の始動中は、初期化前の数秒間、リレーおよび電流出力のステータスは未定義です。接続されている可能性があるアクチュエータに対する影響に注意してください。

9.2.1 操作言語の設定

言語の設定

1. 電源のスイッチを入れます。
 - ↳ 初期化が完了するまで待ちます。
2. 初期化が完了するまでお待ちください。 **MENU** . 一番上のメニュー項目で言語を設定します。
 - ↳ 指定した言語で機器を操作できるようになります。

9.2.2 表示動作

メニュー/動作/ディスプレイ		
機能	オプション	情報
コントラスト	5～95 % 初期設定 50 %	作業環境に合わせて画面設定を調整してください。 バックライト = 自動 ボタンを押さない場合、バックライトは、しばらくすると自動的にオフになります。ナビゲータボタンを押すと、バックライトはすぐに再度オンになります。
バックライト	選択 ■ オン ■ オフ ■ 自動 初期設定 自動	バックライト = オン バックライトは自動的にオフになりません。
表示切替	選択 ■ 手動 ■ 自動 初期設定 手動	「自動」を選択した場合、単一チャンネル計測値表示があるチャンネルから1つおきに次のチャンネルに切り替わります。

9.3 ユーザ定義スクリーン

メニュー/動作/ユーザ定義スクリーン		
機能	オプション	情報
▶ 測定表示 1 ... 6		独自の測定画面を 6 つ作成して名前を付けることができます。機能は 6 つの測定画面すべてで同じです。
測定表示	選択 ■ オン ■ オフ 初期設定 オフ	独自の測定画面を定義したら、ここでその画面をオンにできます。新しい画面は、測定モードの ユーザ定義スクリーン にあります。
ラベル	カスタマイズテキスト、20 文字	測定画面の名前 ディスプレイのステータスバーに表示されます。
ライン数	1~8 初期設定 8	表示される測定値の数を指定してください。
▶ Line 1 ... 8	ユーザーインターフェイス ラベル	各行のサブメニューで ラベル の内容を設定します。
データソース	選択 ■ なし ■ 「情報」列のリストを参照 初期設定 なし	▶ データソースを選択します。 以下から選択可能： ■ センサ入力 ■ センサ入力の Heartbeat 診断 ■ コントローラ ■ 電流入力 ■ フィールドバス信号 ■ 演算機能 ■ バイナリ入力および出力 ■ 電流出力 ■ リレー ■ 計測レンジスイッチ
測定値 データソース は入力	選択 入力に依存 初期設定 なし	入力タイプに応じて、様々なメイン測定値、第 2 測定値、生測定値を表示できます。ここでは、出力のオプションは選択できません。
アクチュエータタイプ データソース はコントローラ	選択 ■ なし ■ 両極 ■ 単極 - ■ 単極 + 初期設定 なし	コントローラおよび操作変数の詳細： → 71
ラベル	カスタマイズテキスト、20 文字	表示されるパラメータのユーザ定義の名前
▷ ラベルを "%0V" に設定します ¹⁾	アクション	このアクションを実行する場合、自動的に提案されるパラメータ名を受け入れます。固有のパラメータ名 (ラベル) は失われます！

- 1) 「%0V」は文脈依存のテキストを表します。このテキストはソフトウェアによって自動作成され、%0V の場所に挿入されます。最も単純な状況では、生成されたテキストが、たとえば測定チャンネルの名前になります。

9.4 基本設定

基本設定

1. **設定/基本設定** メニューに移動します。
 - ↳ 次の設定を行います。
2. **デバイスタグ** : 機器に任意の名前を付けます (32 文字以内)。
3. **日付設定** : 必要に応じて設定されている日付を修正します。
4. **時刻設定** : 必要に応じて設定されている時刻を修正します。
 - ↳ クイック設定の場合、出力、リレーなどの追加設定を無視できます これらの設定は、後で特定のメニューで行うことができます。
5. 測定モードに戻る場合 : 「**ESC**」ソフトキーを 1 秒以上押したままにします。
 - ↳ これで、コントローラは基本設定で機能するようになりました。接続されているセンサは、当該センサタイプの初期設定と、最後に保存された個々の校正設定を使用します。

次のメニューにある最も重要な入出力パラメータを設定したい場合は、以下の手順を実行します。 **基本設定** :

- ▶ 時刻設定の後に続くサブメニューで、電流出力、リレー、リミットスイッチ、コントローラ、機器自己診断および洗浄サイクルを設定します。

10 操作

10.1 表示

10.1.1 測定モードでのソフトキー

ディスプレイの一番下の行に、測定画面の 4 つのソフトキーが表示されます。

- **MENU**、**CAL** および **DIAG** を押すと、特定のソフトウェアメニューに直接移動します。
- **HOLD** を押すと、直ちにセンサのホールドを作動させることが可能です。これにより、すべてのリンクされた出力、コントローラ、洗浄サイクルもホールドに設定されます。実行中のセンサ洗浄プログラムがすべて中断されます。ただし、ホールド作動中にセンサの手動洗浄は開始できます。

10.1.2 測定モード

各種の表示モードがあります。

(モードを切り替えるには、ナビゲータボタンを押します。)

- (1) すべての入力および出力の概要
- (2) 入力または出力のメイン測定値あるいはリレーのステータス
- (3) センサ入力のメイン測定値および第 2 測定値
- (4) センサ入力のすべての測定値
- (5) **界面測定の場合のみ**：
分離ゾーンのグラフィック表示

サブメニューもあります。

- (6) ユーザー定義可能な測定メニュー (定義済みの場合のみ使用可能)
事前に設定した画面の選択 (→ 50)
- (7) **Heartbeat 診断**
機器および Heartbeat Technology 対応の接続された各センサの健全性に関する簡単な概要

モード (2) ~ (5) へのチャンネルの変更

- ▶ ナビゲータを回します。
↳ 表示がチャンネルからチャンネルに切り替わります。

センサタイプ	メイン測定値	メイン測定値/ 第 2 測定値	すべての値
pH、ガラス	pH 値	pH 値、温度	主測定値, 生値, 温度, ガラスインピーダンス
pH および ORP 複合センサ	pH 値、ORP 値、または rH 値	pH 値、ORP 値、または rH 値、温度	主測定値, 生値, 温度, ガラスインピーダンス
pH、ISFET	pH 値	pH 値、温度	主測定値, 生値, 温度
ORP	ORP	ORP、温度	主測定値, 生値, オフセット, 温度
電磁式導電率	導電率、濃度	導電率、濃度、温度	主測定値, 生値, 温度
電極式導電率	導電率、抵抗率、濃度	導電率、抵抗率、濃度、温度	主測定値, 生値, 温度
溶存酸素、光学式および隔膜式	酸素	溶存酸素、温度	分圧, 飽和, 濃度, 温度
殺菌	塩素または二酸化塩素 (センサに応じて)	塩素または二酸化塩素、温度	主測定値, 生値, 温度
硝酸	硝酸	硝酸、温度	主測定値, 生値, 温度
濁度	濁度	濁度、温度	主測定値, 生値, 温度

センサタイプ	メイン測定値	メイン測定値/ 第 2 測定値	すべての値
スペクトルの吸光度 (SAC)	SAC	SAC、温度	主測定値, 生値, 温度
汚泥濃度	濁度	濁度、温度	主測定値, 生値, 温度
アンモニア、イオン選択性	アンモニア	アンモニア、温度	主測定値, 生値, 温度
硝酸、イオン選択性	硝酸	硝酸、温度	主測定値, 生値, 温度
カリウム、イオン選択性	カリウム	カリウム、温度	主測定値, 生値, 温度
界面測定	UIS	UIS	主測定値, 生値, 温度 分離ゾーン (グラフィック表示)

Heartbeat diagnostics

(オプション、または追加のアクティベーションコードを使用)

- 機器およびセンサの健全性のグラフィック表示、メンテナンスタイマーまたは (センサに応じて) 校正タイマーを示す **Heartbeat** 診断画面
- 機器の健全性およびセンサの状態に関する **Heartbeat** ステータス情報 → 図 53
 - ☺: センサ/機器の状態またはメンテナンスタイマー > 20 %, 対策措置は不要
 - ☹: センサ/機器の状態またはメンテナンスタイマー > 5 ≤ 20 %, メンテナンスはまだ緊急でないが計画が必要
 - ☹: センサ/機器の状態またはメンテナンスタイマー < 5 %, メンテナンスを推奨
- **Heartbeat** センサの状態は、校正結果およびセンサ診断機能の評価を示すものです。

悲しい顔文字は、校正結果、測定値ステータス、または稼働時間のリミット超過が原因と考えられます。このリミットは、センサ設定で **Heartbeat** 診断をアプリケーションに適合させることによって設定できます。

Heartbeat および NAMUR カテゴリー

NAMUR カテゴリー (F、C、M、S) による測定値の信頼性評価中に、センサまたは機器の状態が **Heartbeat** ステータスに示されます。2 つの条件を相互に関連付けることが可能ですが、そうする必要はありません。

■ 例 1

- センサの残りの洗浄サイクル数が、設定された最大数の 20% に達しました。
Heartbeat シンボルが ☺ から ☹ に変わります。測定値は依然として信頼性が高いため、NAMUR ステータス信号は変化しません。
- 洗浄サイクルの最大数が超過した場合、**Heartbeat** シンボルは ☹ から ☹ に変わります。測定値は依然として信頼性が高いものの、NAMUR ステータス信号は M (メンテナンス要求) に変わります。

■ 例 2

センサが破損しました。**Heartbeat** ステータスが直ちに ☹ から ☹ に変わり、NAMUR ステータス信号も直ちに F (故障) に変わります。

10.1.3 機器ステータス

ディスプレイ上のアイコンは、特別な機器状態に対する警告を表します。

アイコン	場所	説明
F	ヘッダーバー	診断メッセージ「故障」
M	ヘッダーバー	診断メッセージ「メンテナンス要求」
C	ヘッダーバー	診断メッセージ「チェック」
S	ヘッダーバー	診断メッセージ「仕様範囲外」
↔	ヘッダーバー	フィールドバスまたは TCP/IP 通信作動
⏸	ヘッダーバー	ホールド作動 (センサの場合)
⏸	測定値	アクチュエータ (電流出力、リミットスイッチなど) のホールドが作動

アイコン	場所	説明
⊕	測定値 ¹⁾	オフセットが測定値に追加されている
⊗	測定値	「悪」状態または「アラーム」状態での測定値
ATC	測定値	自動温度補償作動（センサの場合）
MTC	測定値	手動温度補償作動（センサの場合）
SIM	ヘッダーバー	シミュレーションモード作動または Memocheck SIM が接続されている
SIM	測定値	測定値が、シミュレートされた値の影響を受けている
SIM	測定値	表示測定値がシミュレートされている（センサの場合）
😊	チャンネル番号の後	Heartbeat 診断：センサの状態は良好
😞	チャンネル番号の後	Heartbeat 診断：センサの状態は不良
😊	チャンネル番号の後	Heartbeat 診断：センサの状態は OK
☐	ヘッダーバー	コントローラが作動

1) pH または ORP 測定のみ

i 2 つ以上の診断メッセージが同時に発生した場合、最も高い優先度を持つメッセージのアイコンのみがディスプレイに表示されます（優先順位は NAMUR に準拠、→ 114）。

10.1.4 割当ビュー

「チャンネル割当ビュー」などの「割当ビュー」は、メニューの多くのセクションで最後の機能として表示されます。この機能を使用して、どのアクチュエータまたは機能が入力または出力に接続されているかを確認できます。割当ては階層的順序で表示されます。

10.2 一般設定

10.2.1 基本設定

メニュー/設定/一般設定		
機能	オプション	情報
デバイスタグ	カスタマイズテキスト、32 文字	▶ コントローラには任意の名前を選択します（例：タグ番号を使用）。
温度単位	選択 ■ °C ■ °F ■ K 初期設定 °C	
電流出力レンジ	選択 ■ 0..20 mA ■ 4..20 mA 初期設定 4..20 mA	Namur NE43 に準拠し、リニアレンジは 3.8 ~ 20.5 mA (4..20 mA) または 0~20.5 mA (0..20 mA) です。このレンジから逸脱すると、電流値はレンジ限界で停止し、診断メッセージ (460 または 461) が出力されます。
エラー電流	0.0~23.0 mA 初期設定 22.5 mA	この機能は NAMUR NE43 を満たしています。 ▶ エラー発生時に電流出力で出力する電流値を設定してください。

メニュー/設定/一般設定		
機能	オプション	情報
 「エラー電流」の値は測定範囲外を指定します。電流出力レンジ = 0..20 mA と決定した場合は、20.1 ~ 23 mA のエラー電流を設定します。電流出力レンジ = 4..20 mA の場合は、エラー電流として < 4 mA の値を定義することもできます。 機器は測定範囲内のエラー電流を許容します。そのような場合、このことがプロセスに影響を及ぼす可能性があることに注意してください。		
アラーム遅延	0 ~ 9999 s 初期設定 0 s	ソフトウェアは、設定された遅延時間よりも長く存在しているエラーしか表示しません。これにより、短時間だけ発生し、かつ、プロセス固有の正常変動に起因するメッセージを抑制できます。
デバイスホールド	選択 ■ 不可 ■ 可能 初期設定 不可	ここで、直ちにホールド（センサの場合）を作動させることが可能です。この機能は、画面の「HOLD」ソフトキーと同じように作用します。

10.2.2 日付と時刻

メニュー/設定/一般設定/日付/時間		
機能	オプション	情報
日付設定	フォーマットに依存	編集モード： 日 (2桁) : 01 ~ 31 月 (2桁) : 01 ~ 12 年 (4桁) : 1970 ~ 2106
時刻設定	フォーマットに依存	編集モード： hh (時) : 00 ~ 23 / 0 am ~ 12 pm mm (分) : 00 ~ 59 ss (秒) : 00 ~ 59
▶ 追加セットアップ		
日付フォーマット	選択 ■ DD.MM.YYYY ■ YYYY-MM-DD ■ MM-DD-YYYY 初期設定 DD.MM.YYYY	▶ 日付フォーマットを選択します。
時間フォーマット	選択 ■ HH:MM am (12h) ■ HH:MM (24h) ■ HH:MM:SS (24h) 初期設定 HH:MM:SS (24h)	▶ 12 時間表示または 24 時間表示のいずれかを選択します。後者のバージョンでは、秒も表示できます。
タイムゾーン	選択 ■ なし ■ 35 個の時間ゾーンの中から選択 初期設定 なし	なし = グリニッジ標準時 (ロンドン)
サマータイム	選択 ■ オフ ■ ヨーロッパ ■ USA ■ 手動 初期設定 オフ	ヨーロッパまたはアメリカの夏時間を選択した場合、コントローラは夏時間と通常時間の切替えを自動的に調整します。手動は、夏時間の開始および終了を自分で指定できます。この場合、2 つの追加サブメニューが表示され、そこで切替日時を指定します。

10.2.3 ホールド設定

メニュー/設定/一般設定/ホールド設定		
機能	オプション	情報
自動ホールド設定		
ホールド解放時間	0~600 秒 初期設定 0 s	測定モードに切り替えると、ホールド状態が遅延時間の間維持されます。
メニュー設定	選択 ■ 不可 ■ 可能 初期設定 不可	▶ 特定のメニューが開かれた場合に機器出力を指定されたホールド状態に切り替えるかどうかを決定します。
診断メニュー		
校正起動中		
	初期設定 可能	

 機器固有のホールド状態が作動した場合、その前にスタートした洗浄が中断されます。ホールド作動中は、手動洗浄しか開始できません。

10.2.4 ログブック

ログブックは次のイベントを記録します。

- 校正/調整イベント
- オペレータイイベント
- 診断イベント

ログブックがデータを記憶する方法を定義します。

さらに、個々のデータログブックを定義することもできます。

1. ログブック名を割り当てます。
2. 記録する測定値を選択します。
3. スキャン時間を設定します (**スキャン時間**)。
 - ↳ データログブックごとに個別にスキャン時間を設定できます。

 ログブックの詳細：→  121

メニュー/設定/一般設定/ログブック		
機能	オプション	情報
ログブック識別	カスタマイズテキスト、16 文字	ログブックエクスポート時のファイル名の一部
イベントログブック	選択 ■ オフ ■ 上書バッファ ■ 上書禁止バッファ 初期設定 上書バッファ	すべての診断メッセージが記録されます。 上書バッファ メモリが一杯になった場合、最新のエントリーによって最古のエントリーが自動的に上書きされます。 上書禁止バッファ メモリが一杯になった場合、オーバーフローが発生します。つまり、新しい値を保存することはできません。コントローラが対応する診断メッセージを表示します。その場合、メモリを手動でクリアする必要があります。

メニュー/設定/一般設定/ログブック		
機能	オプション	情報
▶ オーバフロー 警告 イベントログブック = 上書禁止バッファに設定します。		
校正ログブック	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	▶ 関連するログブックのフィルアップバッファのオーバーフローが発生した場合に、診断メッセージを受信するかどうかを決定します。
診断ログブック		
設定ログブック		
▶ データログブック		
▶ 新規		最大 8 つのデータログブックを作成できます。
ログブック名	カスタマイズテキスト、 20 文字	
データソース	選択 ■ センサ入力 ■ Heartbeat 信号 ■ コントローラ ■ 電流入力 ■ フィールドバス信号 ■ バイナリ入力 ■ 演算機能 初期設定 なし	▶ ログブックに記録するデータソースを選択してください。 以下から選択可能： ■ 接続されたセンサ ■ 使用可能なコントローラ ■ 電流入力 ■ フィールドバス信号 ■ バイナリ入力信号 ■ 演算機能
測定値	選択 次に依存： データソース 初期設定 なし	データソースによって異なる測定値を記録できます。
スキャン時間	0:00:01～1:00:00 初期設定 0:01:00	2 つのエントリー間の最小時間間隔 フォーマット：H:MM:SS
データログブック	選択 ■ 上書バッファ ■ 上書禁止バッファ 初期設定 上書バッファ	上書バッファ メモリが一杯になった場合、最新のエントリーによって最古のエントリーが自動的に上書きされます。 上書禁止バッファ メモリが一杯になった場合、オーバーフローが発生します。つまり、新しい値を保存することはできません。コントローラが対応する診断メッセージを表示します。その場合、メモリを手動でクリアする必要があります。
オーバーフロー 警告 イベントログブック = 上書禁止バッファに 設定します。	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	▶ 関連するログブックのフィルアップバッファのオーバーフローが発生した場合に、診断メッセージを受信するかどうかを決定します。
▷ 別のログブック追加	アクション	別のデータログブックを即座に作成したい場合のみ。後から新規データログブックを追加する場合は、 新規 を使用します。
▷ 終了	アクション	新規 メニューを終了することができます。

メニュー/設定/一般設定/ログブック		
機能	オプション	情報
▷ 同時開始 / 停止	アクション	複数のデータログブックを作成した場合に表示されます。1 回クリックするだけで、すべてのデータログブックの記録を開始または停止できます。
▶ ログブック名		このサブメニューの名前はログブックの名前に基づいており、表示されるのはログブックを作成した場合だけです。
 複数のデータログブックがある場合、このメニューは複数回表示されます。		
データソース	読み取り専用	これは情報提供のみを目的としています。別の値を記録したい場合は、このログブックを削除し、新しいデータログブックを作成してください。
測定値		
ログブック残時間 イベントログブック = 上書禁止バッファに設定します。	読み取り専用	ログブックが一杯になるまでの残りの日数、時間および分を表示します。
ログブックサイズ イベントログブック = 上書禁止バッファに設定します。	読み取り専用	ログブックが一杯になるまでの残りのエントリー数を表示します。
ログブック名	カスタマイズテキスト、 20 文字	ここで名前を再度変更できます。
スキャン時間	0:00:01~1:00:00 初期設定 0:01:00	同上 2 つのエントリー間の最小時間間隔 フォーマット : H:MM:SS
データログブック	選択 ■ 上書バッファ ■ 上書禁止バッファ 初期設定 上書バッファ	上書バッファ メモリが一杯になった場合、最新のエントリーによって最古のエントリーが自動的に上書きされます。 上書禁止バッファ メモリが一杯になった場合、オーバーフローが発生します。つまり、新しい値を保存することはできません。コントローラが対応する診断メッセージを表示します。その場合、メモリを手動でクリアする必要があります。
オーバーフロー 警告 イベントログブック = 上書禁止バッファに設定します。	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	▶ 関連するログブックのフィルアップバッファのオーバーフローが発生した場合に、診断メッセージを受信するかどうかを決定します。

メニュー/設定/一般設定/ログブック		
機能	オプション	情報
▶ ラインプロッタ		グラフィック表示を定義するためのメニュー
軸	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	軸 (x, y) を表示するか (オン)、表示しないか (オフ) ?
オリエンテーション	選択 ■ 水平 ■ 縦 初期設定 水平	値を示す曲線を左から右に表示するか (水平)、上から下に表示するか (縦) を選択できます。2つのデータログブックを同時に表示する場合は、ここで両方のログブックの設定が同じであることを確認してください。
X-ディスクリプション	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	▶ 軸の説明を表示するかどうかと、グリッド線を表示するかどうかを決定してください。さらに、ピッチを表示するかどうかも決定できます。
Y-ディスクリプション		
グリッド		
ピッチ		
X ピッチ/グリッド 距離	10～50 % 初期設定 10 %	▶ ピッチを指定します。
Y ピッチ/グリッド 距離		
▷ 削除	アクション	このアクションにより、データログブックが削除されます。保存されていないデータはすべて失われます。

例：新しいデータログブック（設定/一般設定/ログブック/データログブック/新規）

1. 設定を行います。

- ログブック名
名前を割り当てます。例：「01」
- データソース
データソースを選択します。例：チャンネル 1 (CH1) に接続されているセンサ
- 測定値
記録する測定値を選択します。例：pH 値
- スキャン時間
2つのログブックエントリー間の時間間隔を指定します。
- データログブック
ログブックをアクティブにします。データ記憶方法を指定します。

2. ../終了：動作を実行します。

- ↳ 機器のデータログブックリストに新しいログブックが表示されます。

3. ログブック「01」を選択します。

- ↳ 追加表示：ログブック残時間

4. 上書禁止バッファの場合のみ：

オーバフロー 警告：オンまたはオフを設定します。

- ↳ **オン**：メモリのオーバーフローが発生すると、機器に診断メッセージが表示されます。

5. ラインプロッタサブメニュー：グラフィック表示のタイプを設定します。

10.2.5 追加セットアップ

診断設定

表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。

メニュー/設定/ (一般設定 または 入力<センサチャンネル>)/追加セットアップ/診断設定/診断症状		
機能	オプション	情報
診断メッセージのリスト		▶ 変更するメッセージを選択してください。その後のみ、このメッセージの設定を行うことができます。
診断コード	読み取り専用	
診断メッセージ	選択 ■ オン ■ オフ 初期設定 メッセージに依存	ここで診断メッセージをオフまたは再びオンにできます。 オフは次のことを意味します。 ■ 測定モードでエラーメッセージが発生しない ■ 電流出力からエラー電流が出力されない
エラー電流	選択 ■ オン ■ オフ 初期設定 メッセージに依存	▶ 診断メッセージの表示をオンにした場合に、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定してください。  一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力されます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力からのみエラー電流が出力されます。
ステータス信号	選択 ■ メンテナンス (M) ■ 仕様範囲外 (S) ■ 機能チェック (C) ■ 故障 (F) 初期設定 メッセージに依存	メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。 ▶ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更するかどうかを決定してください。
診断出力	選択 ■ なし ■ アラームリレー ■ バイナリ出力 ■ リレー 1 ~ n (機器バージョンに依存) 初期設定 なし	この機能を使用して、診断メッセージの割当先となる出力を選択できます。 出力にメッセージを割り当てる前に、まずリレー出力を「診断」。(メニュー/設定/出力: 「診断」機能を割り当て、「操作モード」を「割当」に設定します)。
 機器バージョンに関係なく、必ずアラームリレーが 1 つ用意されます。他のリレーはオプションです。		
洗浄プログラム (センサの場合)	選択 ■ なし ■ 洗浄 1 ■ 洗浄 2 ■ 洗浄 3 ■ 洗浄 4 初期設定 なし	▶ 診断メッセージが洗浄プログラムをトリガするかどうかを決定してください。 次のメニューから洗浄プログラムを定義できます。 メニュー/設定/追加機能/洗浄。
詳細情報	読み取り専用	ここで、診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示を確認できます。

HART バスアドレス

表示される診断メッセージのリストは、選択されているバスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/HART		
機能	オプション	情報
バスアドレス	0～63 初期設定 0	機器のアドレスを変更して、複数の HART 機器を単一のネットワークに統合できます (Multidrop モード)。

 機器設定を初期設定にリセットした場合でも（診断/リセット/工場デフォルト設定）、バスアドレスはリセットされません。設定は保持されます。

PROFIBUS DP

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/PROFIBUS		
機能	オプション	情報
可能	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	ここで通信をオフにできます。その場合、ソフトウェアにはローカル操作でしかアクセスできません。
終端	読み取り専用	機器がバス内の最後の機器である場合、ハードウェアを介して終端できます。 → 38
バスアドレス	1～125	ハードウェアを介してバスをアドレス指定した場合 (モジュールの DIP スイッチ、→ 38)、ここではアドレスの読み取りのみ可能です。ハードウェアを介して無効なアドレスが設定された場合、ここで、あるいはバスを介して機器に有効なアドレスを割り当てる必要があります。
識別番号	選択 ■ 自動 ■ PA プロファイル 3.02 (9760) ■ Liquiline CM44x (155D) ■ 製造者特定の 初期設定 自動	

Modbus

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/Modbus		
機能	オプション	情報
可能	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	ここで通信をオフにできます。その場合、ソフトウェアにはローカル操作でしかアクセスできません。
終端	読み取り専用	機器がバス内の最後の機器である場合、ハードウェアを介して終端できます。 → 38

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/Modbus		
機能	オプション	情報
設定		
伝送モード	選択 ■ TCP ■ RTU ■ ASCII 初期設定 (Modbus-RS485 のみ) RTU	注文したバージョンに応じた伝送モードが表示されます。 RS485 伝送の場合、 RTU または ASCII から選択できます。Modbus-TCP の場合は選択できません。
ボーレート Modbus-RS485 のみ	選択 ■ 1200 ■ 2400 ■ 4800 ■ 9600 ■ 19200 ■ 38400 ■ 57600 ■ 115200 初期設定 19200	
パリティ Modbus-RS485 のみ	選択 ■ 偶数 (1 ストップビット) ■ 奇数 (1 ストップビット) ■ なし (2 ストップビット) 初期設定 偶数 (1 ストップビット)	
バイト順	選択 ■ 1-0-3-2 ■ 0-1-2-3 ■ 2-3-0-1 ■ 3-2-1-0 初期設定 1-0-3-2	
監視	0～999 s 初期設定 5 秒	データ転送が行われない時間が設定時間を超えた場合、これは、通信の中断を示す指標になります。この時間が経過した後、 Modbus を介して受信した入力値は無効と見なされます。

Web サーバー

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/ウェブサーバ		
機能	オプション	情報
ウェブサーバ	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	ここで通信をオフにできます。その場合、ソフトウェアにはローカル操作でしかアクセスできません。
ウェブサーバ TCP ポート 80	読み取り専用	伝送制御プロトコル (TCP) は、コンピュータ間のデータ交換方法に関する取り決め (プロトコル) です。ポートは、ネットワークプロトコルにデータセグメントを割り当てるアドレスの一部です。

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/ウェブサーバ		
機能	オプション	情報
ウェブサーバログイン	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	ここでユーザー管理のオン/オフを切り替えることができます。これにより、パスワードでアクセスできる複数のユーザーの作成が可能となります。
ユーザ管理者		
すでに作成済みのユーザーリスト	表示/編集	ユーザー名またはパスワードの変更、ユーザーの削除を行うことができます。工場で作成済みのユーザー:「admin」(パスワード「admin」)
新規ユーザー:		
名前	フリーテキスト	新規ユーザーの作成 1. INSERT . 2. 新規ユーザーに任意の名前を割り当てます。 3. ユーザーのパスワードを選択します。 4. パスワードを確定します。 ↳ いつでもパスワードを変更できます。
新しいユーザパスワードを入力	フリーテキスト	
新しいユーザパスワード確認	フリーテキスト	
ユーザパスワードの変更	フリーテキスト	

PROFINET

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/PROFINET		
機能	オプション	情報
ステーション名	読み取り専用 初期設定 空の文字列	PROFINET システムのフィールド機器を一意的に識別するための識別名。パラメータは DCP プロトコルを使用してのみ書き込みできます。

Ethernet/IP または Ethernet (プロトコルに応じて)

-  PROFINET が使用されていると、このメニュー内の設定は読み取り専用になります。ネットワーク設定は PROFINET-DCP プロトコルを介してのみ作成できます。
-  「PROFINET 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ (→ SD02490C) を参照してください。

- ▶ 以下の表にあるすべての機能と設定オプションは PROFINET には適用されません。

メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/イーサネット		
機能	オプション	情報
可能	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	ここで通信をオフにできます。その場合、ソフトウェアにはローカル操作でしかアクセスできません。
設定		
リンク設定	選択 ■ 自動ネゴシエーション ■ 100Mbps 半二重通信 ■ 100Mbps 全二重通信 ■ 100Mbps 半二重通信 ■ 100Mbps 全二重通信 初期設定 自動ネゴシエーション	通信チャンネルの伝送方式 ■ 全二重： データを同時に送受信できます。 ■ 半二重： データは送信と受信が交互にしかできません（つまり、同時は不可）。
DHCP	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（DHCP）を使用すると、サーバーを介してクライアントにネットワーク設定を割り当てることができます。DHCP では、手動設定なしで既存のネットワークに機器を自動的に統合できます。通常、クライアント側で設定する必要があるのは IP アドレスの自動割当てのみです。起動中に DHCP サーバーから IP アドレス、ネットマスクおよびゲートウェイが取得されます。  機器の IP アドレスを手動で割り当てますか？その場合は、 DHCP= オフ に設定します。
IP アドレス	xxx.xxx.xxx.xxx	IP アドレスは、インターネットプロトコル (IP) に基づくコンピュータネットワーク内のアドレスです。 DHCP がスイッチオフの場合は IP アドレスのみを設定できます。
ネットマスク	xxx.xxx.xxx.xxx	機器の IP アドレスに基づいて、ネットマスクは、独自のネットワーク内で機器が検索する IP アドレス、ルータを介して他のネットワーク内でアクセスできるアドレスを指定します。したがって、ネットマスクは IP アドレスをネットワーク部分（ネットワークプレフィックス）と機器部分に分割します。ネットワーク部分は個々のネットワーク内のすべての機器で同じである必要があり、機器部分はネットワーク内の機器ごとに異なる必要があります。
ゲートウェイ	x.x.x.x	ゲートウェイ（プロトコルコンバータ）は、プロトコルが全く異なるネットワーク間の通信を可能にします。
サービススイッチ	読み取り専用	
MAC アドレス	読み取り専用	MAC アドレス（メディアアクセスコントロールアドレス）は、コンピュータネットワーク内の機器を一意に識別するために使用されるネットワークアダプタごとのハードウェアアドレスです。
イーサネット IP ポート 44818	読み取り専用	ポートは、ネットワークプロトコルにデータセグメントを割り当てるアドレスの一部です。

設定の承認

IP アドレスなどの設定を手動で変更しましたか？

- ▶ **イーサネット**メニューから移動する前に：

SAVE を選択して設定を適用してください。

- ↳ **診断/システム情報**メニューで、新しい設定が使用されているかどうか確認できます。

データマネージメント

ファームウェアアップデート

 コントローラで利用できるファームウェア更新とその旧バージョンとの互換性については、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

現在のファームウェアバージョン：：メニュー/診断/システム情報/

- ▶ 現在の設定およびログブックを SD カードにバックアップします。

ファームウェア更新をインストールするには、その更新情報をあらかじめ SD カードに保存しておく必要があります。

1. コントローラカードリーダーに SD カードを挿入します。
2. **メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/データマネージメント/ファームウェアアップデート**に移動します。
 - ↳ SD カード上の更新ファイルが表示されます。
3. 目的の更新を選択し、次のメッセージが表示されたら「はい」を選択します。

現在のファームウェアは書き換えられます。
その後、機器は再起動されます。
実行しますか？

 - ↳ ファームウェアがロードされ、機器が新しいファームウェアで起動します。

設定保存

セットアップを保存すると、特に次の利点があります。

- 他の機器用に設定をコピーできる
- ユーザーグループごとに、あるいはセンサタイプの変更を繰り返す場合などに、様々なセッ
- 設定を大幅に変更して元の設定が分からなくなった場合などに、元のセットアップを復元できる

1. コントローラカードリーダーに SD カードを挿入します。
2. 次のメニューに移動します。**メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/データマネージメント/設定保存**
3. **名前**：ファイル名を割り当てます。
4. 次に **保存** を選択します。
 - ↳ ファイル名をすでに割り当てている場合は、既存のセットアップを上書きするかどうかを尋ねられます。
5. **OK** で確定するか、またはキャンセルして新しいファイル名を割り当てます。
 - ↳ セットアップが SD カードに保存されるため、後でこのセットアップを機器に迅速にアップロードできます。

設定読み込み

セットアップをロードすると、現在の設定は上書きされます。

1. コントローラカードリーダーに SD カードを挿入します。セットアップが SD カードに保存されていないと表示されます。

2. 次のメニューに移動します。**メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/データマネージメント/設定読み込み**
 - ↳ SD カード上のすべてのセットアップのリストが表示されます。
カードに有効なセットアップが保存されていない場合、エラーメッセージが表示されます。
3. 目的のセットアップを選択します。
 - ↳ 警告が表示されます：
現在のパラメータは上書きされ機器はリブートされます
警告：洗浄および制御プログラムは起動できます
実行しますか？
4. **OK** で確定するか、またはキャンセルします。
 - ↳ **OK** を選択して確定すると、目的のセットアップを使用して機器が再始動します。

設定転送

セットアップをエクスポートすると、特に次の利点があります。

- スタイルシート付きの XML フォーマットでエクスポートできるため、以下のように XML 互換性のあるアプリケーションで書式付き表示が可能：Microsoft Internet Explorer
- データのインポートが可能（XML ファイルをブラウザのウィンドウにドラッグアンドドロップする）

1. コントローラカードリーダーに SD カードを挿入します。
2. 次のメニューに移動します。**メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/データマネージメント/設定転送**
3. **名前**：ファイル名を割り当てます。
4. 次に **転送** を選択します。
 - ↳ ファイル名をすでに割り当てている場合は、既存のセットアップを上書きするかどうかを尋ねられます。
5. **OK** で確定するか、またはキャンセルして新しいファイル名を割り当てます。
 - ↳ セットアップが SD カードの「Device」フォルダに保存されます。

 エクスポートしたセットアップを機器に再度アップロードすることはできません。このためには、「**設定保存**」を使用する必要があります。SD カードにセットアップを保存し、後でこれを再ロードまたは他の機器にアップロードする唯一の方法となります。

アクティベーションコード

以下の場合にアクティベーションコードが必要です。

- 追加機能（例：フィールドバス通信）
- ファームウェアアップグレード
- 変更（例：フィールドバスプロトコルの非アクティブ化）

 出荷時の機器にアクティベーションコードが付いている場合、これは銘板に記載されています。該当する機器の機能は工場ではアップグレードされているため、コードが必要になるのは機器の点検・修理時、またはフィールドバスプロトコルを非アクティブ化する場合のみです。

1. アクティベーションコードを入力します：**メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/データマネージメント/アクティベーションコード**
2. 入力値を確定します。
 - ↳ 新しいハードウェアまたはソフトウェア機能が起動され、設定できるようになります。

アクティベーションコードにより有効になる機能：

機能	アクティベーションコードの冒頭
2 番目の Memosens 入力 (CM442R のみ)	062...
485 モジュールを取り外した場合のフィールドバスの非アクティブ化 ¹⁾	0B0...
2 つの電流出力 (BASE2-E モジュールのみ)	081...
Web サーバー ²⁾	351...
HART	0B1...
PROFIBUS DP	0B3...
Modbus TCP	0B8...
Modbus RS485	0B5...
EtherNet/IP	0B9...
PROFINET	0B7...
測定範囲スイッチ、設定 1	211...
計測レンジスイッチ、設定 2 ³⁾	212...
フィードフォワード制御	220...
Chemoclean Plus	25...
演算機能 陽イオン交換器量	301...
Heartbeat モニタリング	2D1...
Heartbeat 検証	2E1...

- 1) フィールドバスプロトコルがアクティブになっている 485 モジュールを取り外すと、エラーメッセージが表示されます。銘板の内側に明記されたアクティベーションコードを入力する必要があります。これを実施しないと、フィールドバスの非アクティブ化はできません。その後、ベースモジュールの電流出力をアクティブにするため、適切なアクティベーションコードを入力しなければなりません。追加の電流出力 (CM444R および CM448R のみ) は、対応するモジュールを使用するとアクティブになります。
- 2) Base2 モジュールの Ethernet ソケット経由、Ethernet フィールドバスを使用しないバージョン用
- 3) 「計測レンジスイッチ」オプションを注文すると、2 つのアクティベーションコードが支給されます。2 つの計測レンジスイッチの設定をアクティベートするには、両方のコードを入力してください。

パスワードの変更

パスワードを使用して操作キーをロックできます (ナビゲータを長押しするとコンテキストメニューにアクセス可能)。キーは、正しいパスワードを入力した場合にのみ使用できるようになります。

キーをロックするパスワードを設定できます。**メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/データマネージメント/キーロックパスワードを変更してください**

1. 現在のパスワードを入力します (初期設定 0000)。
 - ↳ 新しいパスワードを入力してください
2. 新規パスワードを入力します。
 - ↳ 新しいパスワード確認
3. 新規パスワードを再度入力します。
 - ↳ パスワードは変更されました

ナビゲータを長押しして測定モードに戻ります。

10.3 電流入力

入力、リミットスイッチ、ログブックなどのデータソースとして使用できます。さらに、外部値をコントローラのセットポイントとして使用できるようにすることもできます。

メニュー/設定/入力/電流入力 x:y ¹⁾		
機能	オプション	情報
モード	選択 ■ オフ ■ 0 - 20mA ■ 4 - 20mA 初期設定 4 - 20mA	▶ データソース（接続されている機器）と同じ電流レンジを選択してください。
入力モード	選択 ■ 流量 ■ パラメータ ■ 電流 初期設定 電流	▶ 入力変数を選択してください。
測定値フォーマット	選択 ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### 初期設定 #.#	▶ 小数点以下の桁数を指定してください。
パラメータ名 入力モード = パラメータ	カスタマイズテキスト、 16 文字	▶ パラメータ名など、データソースも使用する有用な名前を割り当ててください。
測定単位 入力モード = パラメータ	カスタマイズテキスト、 16 文字	リストから単位を選択することはできません。単位を使用したい場合は、ここにカスタマイズテキスト形式で入力する必要があります。
低レンジ値 入力モード = パラメータ	-20.0 ... 高レンジ値 <測定単位> 初期設定 0.0 <工学単位>	▶ 測定範囲を入力してください。低レンジ値と高レンジ値は、0 または 4 mA 値と 20 mA 値にそれぞれ割り当てられます。システムは、事前に入力された工学単位を使用します。
高レンジ値 入力モード = パラメータ	低レンジ値 ~10000.0 <工学単位> 初期設定 10.0 <工学単位>	
ダンピング	0~60 s 初期設定 0 s	ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。

1) x:y = スロット番号 : 入力番号

10.4 出力

10.4.1 電流出力

ベーシックバージョンの機器には、必ず 2 つの電流出力が備えられています。

拡張モジュールを使用すると追加の電流出力を設定できます。

電流出力範囲の設定

▶ **メニュー/設定/一般設定 : 0..20 mA または 4..20 mA** を選択します。

メニュー/設定/出力/電流出力 x:y ¹⁾		
機能	オプション	情報
電流出力	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能を使用して、電流出力で出力される変数をオンまたはオフにできます。
データソース	選択 ■ なし ■ 接続されている入力 ■ コントローラ 初期設定 なし	提供されるデータソースは、機器バージョンに依存します。 入力に接続されているすべてのセンサとコントローラを選択することが可能です。
測定値	選択 ■ なし ■ 次に依存：データソース 初期設定 なし	選択できる測定値は、「データソース」で選択したオプションに応じて異なります。
 選択可能な測定値の一覧は、「測定値」表に記載されており、これは「データソース→ 69」に応じて異なります。 接続されたセンサからの測定値に加えて、コントローラをデータソースとして選択できます。これを行うには、「追加機能」メニューを使用します。そこでは、被制御変数の出力用に電流出力の選択と設定を行うことが可能です。		
レンジ低値	補正および初期設定の範囲は次に依存： 測定値	電流出力で測定範囲全体またはその一部だけを出力できます。そのためには、必要に応じて高レンジ値と低レンジ値を指定してください。
レンジ高値		
ホールド 症状	選択 ■ Freeze last value ■ 固定値 ■ 無視 初期設定 チャンネル：出力に依存	Freeze last value 機器が最後の電流値を保持します。 固定値 定義された固定電流値を出力します。 無視 電流出力は保持されません。
ホールド 電流 ホールド 症状 = 固定値 に設定します。	0.0～23.0 mA 初期設定 22.0 mA	► 電流出力で出力する固定値を指定してください。

1) x:y = スロット：出力番号

測定値（データソース に応じて）

データソース	測定値
pH ガラス電極	選択 ■ 生値 mV ■ pH ■ 温度
pH 半導体電極	
ORP	選択 ■ 温度 ■ ORP mV ■ ORP %
溶存酸素(隔膜式)	選択 ■ 温度 ■ 分圧 ■ 液体濃度 ■ 飽和 ■ 生値 nA (溶存酸素(隔膜式) のみ) ■ 生値 μS (溶存酸素(光学式) のみ)
溶存酸素(光学式)	

データソース	測定値
電磁式導電率	選択 ■ 温度 ■ 導電率 ■ 抵抗 (電極式導電率のみ) ■ 濃度 (電磁式導電率 および 4 電極式導電率のみ)
電極式導電率	
4 電極式導電率	
消毒	選択 ■ 温度 ■ センサ電流 ■ 濃度
ISE	選択 ■ 温度 ■ pH ■ アンモニウム ■ 硝酸 ■ カリウム ■ 塩素
濁度/SS	選択 ■ 温度 ■ 濁度 g/l (濁度/SSのみ) ■ 濁度 FNU (濁度/SSのみ) ■ 濁度ホルマジン (濁度のみ) ■ 濁度固体 (濁度のみ)
濁度	
硝酸	選択 ■ 温度 ■ 硝酸 ■ 硝酸態窒素
汚泥界面	選択 ■ 温度 ■ 界面 ■ 濁度
SAC	選択 ■ 温度 ■ SAC ■ 伝送 ■ 吸収 ■ COD ■ BOD
コントローラ 1	選択 ■ 両極 (電流出力の場合のみ) ■ 単極 + ■ 単極 -
コントローラ 2	
演算機能	すべての演算機能をデータソースとして使用することもできます。また、計算値を測定値として使用できます。

電流出力を介したコントローラ操作変数の出力

単極 + を、測定値の増加が可能なアクチュエータが接続されている出力に割り当ててください。**単極 -** を、測定値の減少が可能なアクチュエータが接続されている出力に割り当ててください。

大部分のアクチュエータは (両方向ではなく) 一方向にしかプロセスに影響を及ぼすことができないため、2 サイドコントローラの操作変数を出力するには、一般に正の操作

変数と負の操作変数を別々のアクチュエータに出力する必要があります。この目的のため、本機は両極操作変数 y を 2 つの単極操作変数 ($y+$ および $y-$) に分割します。変調リレーへの出力に選択できるのは、この 2 つの単極操作変数部分だけです。電流出力を介して値を出力する場合、両極操作変数 y を 1 つの電流出力のみに出力する可能性もあります（範囲分割）。

10.4.2 アラームリレーとオプションリレー

ベーシックバージョンの機器には、必ず 2 つのアラームリレーが備えられています。機器のバージョンに応じて、追加のリレーも使用できます。

リレーを介して以下の機能を出力できます。

- リミットスイッチステータス
- アクチュエータ制御用のコントローラ操作変数
- 診断メッセージ
- ポンプまたはバルブ制御用の洗浄機能ステータス

 たとえば、複数のセンサを 1 つの洗浄ユニットで洗浄するために、リレーを複数の入力に割り当てることが可能です。

メニュー/設定/出力/アラームリレーまたはチャンネル番号のリレー		
機能	オプション	情報
機能	選択 ■ オフ ■ リミットスイッチ ■ コントローラ ■ 診断 ■ 洗浄 (センサ) ■ Formula (センサ) 初期設定 ■ アラームリレー : 診断 ■ 他のリレー : オフ	次の機能は、選択されているオプションに依存します。 各オプションの理解を促進するよう、それぞれのバージョンについて後続のセクションに個別の説明が記載されています。 機能 = オフ リレー機能はオフとなり、それ以上の設定は必要ありません。

リミットスイッチのステータスの出力


機能 = リミットスイッチ		
機能	オプション	情報
データソース	選択 リミットスイッチ 1...8 初期設定 なし	リレーのステータスを出力するのに使用されるリミットスイッチを選択してください。 リミットスイッチはメニューで設定します。 設定/追加機能/リミットスイッチ.  1 回の操作ですべてのリミットスイッチの選択/選択解除を行うには、 ALL および NONE ソフトキーを使用します。
ホールド 症状	選択 ■ Freeze last value ■ 固定値 ■ 無視 初期設定 無視	

コントローラの操作変数の出力

リレーを介してコントローラ操作変数を出力するために、そのリレーが変調されます。このリレーは起動され（パルス、 t_1 ）、その後、停止されます（間隔、 t_0 ）。


機能 = コントローラ		
機能	オプション	情報
データソース	選択 ■ なし ■ コントローラ 1 ■ コントローラ 2 初期設定 なし	▶ データソースとして機能するコントローラを選択してください。
操作モード	選択 ■ PWM ■ PFM 初期設定 PWM	PWM= パルス幅変調 PFM= パルス周波数変調

1. **PWM**（パルス幅変調）：
デューティサイクルは周期 T ($T=t_1+t_0$) 内で変動します。サイクル期間は一定のままです。

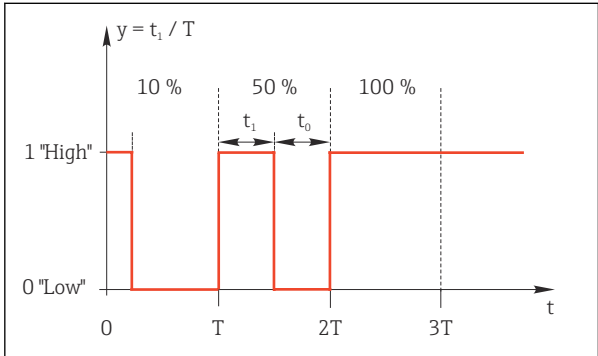

50 主用途：ソレノイドバルブ

2. **PFM**（パルス周波数変調）：
ここでは、一定長のパルス (t_1) が出力され、パルス間の間隔が変動します (t_0)。最大周波数で、 $t_1 = t_0$ となります。

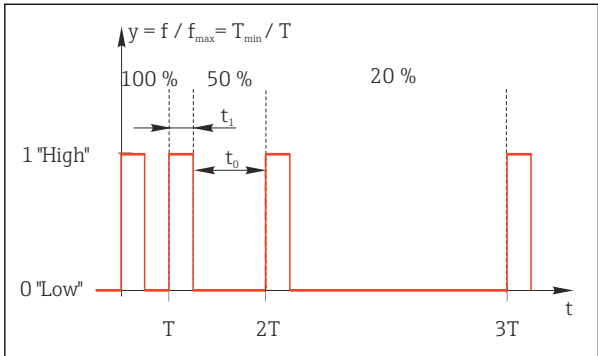

51 主用途：投与ポンプ

機能 = コントローラ		
機能	オプション	情報
アクチュエータタイプ	選択 ■ なし ■ 単極 (-) ■ 単極 (+) 初期設定 なし	ここでは、コントローラのどの部分がリレーを駆動するかを指定します。 単極 (+) は、(加熱などの目的で) プロセス値の増加のためにコントローラが使用する操作変数の一部です。あるいは、(冷却などの目的で)、アクチュエータをリレーに接続して被制御変数を減らす場合は、 単極 (-) を選択します。
繰り返し期間 操作モード = PWM に設定します。	最小実行時間 ~ 999.0 秒 初期設定 10.0 秒	▶ デューティサイクルが変動するサイクル期間を指定してください (PWM のみ)。
 繰り返し期間と最小実行時間の設定は相互に影響を及ぼします。次が適用されます： 繰り返し期間 ≥ 最小実行時間		
最小実行時間 操作モード = PWM に設定します。	0.3 秒 ~ 繰り返し期間 初期設定 0.3 秒	アクチュエータを保護するために、この限界値より短いパルスは出力されません。
最大周波数 操作モード = PFM に設定します。	1 ~ 180 分 ⁻¹ 初期設定 60 分 ⁻¹	1 分当たりの最大パルス数 コントローラはこの設定に基づいてパルス持続時間を計算します。
ホールド 症状	選択 ■ Freeze last value ■ 固定値 ■ 無視 初期設定 無視	

リレーを介した診断メッセージの出力

リレーを診断リレーとして定義すると (**機能 = 診断**)、「フェールセーフモード」で作動します。

つまり、エラーが発生していない基本状態では、リレーは常に通電しています (「ノーマルクローズ」、NC)。このようにして、たとえば、電圧降下を示すことも可能です。アラームリレーは常にフェールセーフモード作動します。

リレーを介して次の 2 つのカテゴリの診断メッセージを出力できます。

- 4 つの Namur クラスの 1 つからの診断メッセージ (→ 114)
- リレー出力に個別に割り当てた診断メッセージ

次に示す 2 つのメニューでメッセージをリレー出力に個別に割り当てます。

- **メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/診断設定/診断症状**
(機器固有のメッセージ)
- **メニュー/設定/入力/<センサ>/追加セットアップ/診断設定/診断症状**
(センサ固有のメッセージ)

 リレー出力を**診断症状**の特別なメッセージに割り当てるには、最初に**出力/リレー x:y** または **/アラームリレー/機能 = 診断** を選択する必要があります。

機能 = 診断		
機能	オプション	情報
操作モード	選択 ■ 割当 ■ Namur M ■ Namur S ■ Namur C ■ Namur F 初期設定 ■ リレー : 割当 ■ アラームリレー : Namur F	割当 このオプションを選択した場合、リレーに個別に割り当てた診断メッセージがリレーを介して出力されます。 Namur M ... Namur F Namur クラスの 1 つを使用することを決定した場合、個々のクラスに割り当てられているすべてのメッセージがリレーを介して出力されます。診断メッセージごとに Namur クラスの割当てを変更することもできます。 (メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/診断設定/診断症状またはメニュー/設定/入力/<センサ>/追加セットアップ/診断設定/診断症状)
診断メッセージ 操作モード = 割当 に設定します。	読み取り専用	リレー出力に割り当てられているすべてのメッセージがディスプレイに表示されます。ここで情報を編集することはできません。

洗浄機能のステータスの出力

機能 = 洗浄		
機能	オプション	情報
割当	選択 ■ なし ■ 洗浄のタイプに依存 初期設定 なし	ここでは、リレーでの洗浄機能の表示方法を指定できます。 選択した洗浄プログラムに応じて (メニュー/設定/追加機能/洗浄)、以下のオプションを使用できます。 ■ 洗浄タイプ = 標準洗浄 に設定します。 洗浄 1 - 水, 洗浄 2 - 水, 洗浄 3 - 水, 洗浄 4 - 水 ■ 洗浄タイプ = ケモクリーン に設定します。 洗浄 1 - 水, 洗浄 1 - 洗剤, 洗浄 2 - 水, 洗浄 2 - 洗剤, 洗浄 3 - 水, 洗浄 3 - 洗剤, 洗浄 4 - 水, 洗浄 4 - 洗剤 ■ 洗浄タイプ = ケモクリーンプラス に設定します。 4x 洗浄 1 - %OV、4x 洗浄 2 - %OV¹⁾
ホールド 症状	選択 ■ Freeze last value ■ 固定値 ■ 無視 初期設定 無視	Freeze last value 機器が最後の測定値を保持します。 固定値 定義した固定測定値が出力されます。 無視 ホールドは無効になります。

1) %OV は、メニュー/設定/追加機能/洗浄/ケモクリーンプラス/出力ラベル 1 ... 4 で割り当てることができる変数テキストです。

演算

機能 = コントローラ		
機能	オプション	情報
操作モード	選択 ■ PWM ■ PFM 初期設定 PWM	PWM= パルス幅変調 PFM= パルス周波数変調 → 図 72
データソース	選択 ■ 使用可能な数式の一覧 ■ 最大 8 つの数式	タイプ Formula の演算機能が使用できなければなりません ▶ データソースとして使用する数式を選択します。
レンジ低値	0～9999	
レンジ高値	レンジ低値～9999	
繰り返し期間 操作モード = PWM に設定します。	最小実行時間 ～999.0 秒 初期設定 10.0 秒	▶ デューティサイクルが変動するサイクル期間を指定してください (PWM のみ)。
 繰り返し期間と最小実行時間の設定は相互に影響を及ぼします。次が適用されます： 繰り返し期間 ≥ 最小実行時間		
最小実行時間 操作モード = PWM に設定します。	0.3 秒～ 繰り返し期間 初期設定 0.3 秒	アクチュエータを保護するために、この限界値より短いパルスは出力されません。
最大周波数 操作モード = PFM に設定します。	1～180 分 ⁻¹ 初期設定 60 分 ⁻¹	1 分当たりの最大パルス数 コントローラはこの設定に基づいてパルス持続時間を計算します。
ホールド 症状	選択 ■ Freeze last value ■ 固定値 ■ 無視 初期設定 無視	

10.4.3 HART

HART 通信を介してどの機器変数を出力するかを指定してください。

最大 16 個の機器変数を定義できます。

1. データソースを設定します。
↳ センサ入力とコントローラの中から選択できます。
2. 出力する測定値を選択します。
3. 「ホールド」状態での動作を設定します。(データソース, 測定値 および ホールド 症状) → 図 69

ホールド 症状 = フリーズ を選択した場合、システムはステータスにフラグを設定するだけでなく、測定値を実際に「フリーズ」することに注意してください。

 詳細については、以下を参照してください。

取扱説明書「HART 通信」、BA00486C

10.4.4 PROFIBUS DP および PROFINET

機器変数（機器 → PROFIBUS/PROFINET）

ここでは、PROFIBUS 機能ブロックにマップするプロセス値、およびそれによって、PROFIBUS 通信を介した伝送に使用するプロセス値を指定できます。

最大 16 個の機器変数（AI ブロック）を定義できます。

1. データソースを定義します。
↳ センサ入力、電流入力、演算機能の中から選択できます。
2. 伝送する測定値を選択します。
3. 「ホールド」状態で機器がどのように動作するかを定義します。（**データソース、測定値、ホールド 症状**の設定オプション）→ 図 69

ホールド 症状 = フリーズを選択した場合、ステータスにフラグが設定されるだけでなく、実際に測定値が「フリーズ」されることに注意してください。

さらに、8 つのバイナリ変数（DI ブロック）を定義できます。

1. データソースを定義します。
2. ステータスが伝送されるリミットスイッチまたはリレーを選択します。

PROFIBUS/PROFINET 変数（PROFIBUS/PROFINET → 機器）

コントローラ、リミットスイッチまたは電流出力メニューで、最大 4 つのアナログ（AO）および 8 つのデジタル（DO）PROFIBUS 変数を測定値として使用できます。

例：AO または DO 値をコントローラのセットポイントとして使用

メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1

1. 規定のメニューで、データソースとして PROFIBUS を定義します。
2. 測定値として所望のアナログ出力（AO）またはデジタル出力（DO）を選択します。

 「PROFIBUS」の詳細については、PROFIBUS 通信のガイドライン（SD01188C）を参照してください。

 「PROFINET」の詳細については、PROFINET 通信のガイドライン（SD02490C）を参照してください。

10.4.5 Modbus RS485 および Modbus TCP

Modbus RS485 通信または Modbus TCP を介してどのプロセス値を出力するかを指定してください。

Modbus RS485 の場合、RTU と ASCII プロトコルを切り替えることができます。

最大 16 個の機器変数を定義できます。

1. データソースを定義します。
↳ センサ入力、コントローラの中から選択できます。
2. 出力する測定値を選択します。
3. 「ホールド」状態で機器がどのように動作するかを定義します。（**データソース、測定値 および ホールド 症状**）→ 図 69

ホールド 症状 = フリーズを選択した場合、システムはステータスにフラグを設定するだけでなく、測定値を実際に「フリーズ」することに注意してください。

 「Modbus」の詳細については、Modbus 通信のガイドライン（SD01189C）を参照してください。

10.4.6 EtherNet/IP

EtherNet/IP 通信を介して出力するプロセス値を設定します。

最大 16 個のアナログ機器変数 (AI) を定義できます。

1. データソースを定義します。
↳ センサ入力、コントローラの中から選択できます。
2. 出力する測定値を選択します。
3. 「ホールド」状態で機器がどのように動作するかを定義します。(データソース, 測定値 および ホールド 症状) → 図 69
4. コントローラの場合は、操作変数のタイプも指定します。

ホールド 症状 = フリーズ を選択した場合、システムはステータスにフラグを設定するだけでなく、測定値を実際に「フリーズ」することに注意してください。

さらに、個のデジタル機器変数 (DI) を定義できます。

- ▶ データソースを定義します。
↳ リレー、バイナリ入力、リミットスイッチの中から選択できます。

 「EtherNet/IP」の詳細については、EtherNet/IP 通信のガイドライン (SD01293C) を参照してください。


10.5 バイナリ入力および出力

2 つのデジタル入力と 2 つのデジタル出力を備えた「DIO」モジュールまたはフィールドバスモジュール「485」などのハードウェアオプションにより、以下が可能になります。

- デジタル入力信号を介して
 - 導電率用の計測レンジスイッチ (アップグレードコードが必要、→ 図 143)
 - 光学センサの場合に異なるデータセットの切り替え
 - 外部ホールド
 - 洗浄周期の起動
 - PID コントローラのオン/オフ (例: CCA250 の近接スイッチを介して)
 - 入力をパルス周波数変調 (PFM) 用の「アナログ入力」として使用
- デジタル出力信号を介して
 - 診断状態、レベルリミットスイッチ、または同様の状態などの静的伝送 (リレーと同じように)
 - 注入ポンプ制御用などの PFM 信号の動的伝送 (非摩耗「アナログ出力」に相当)

10.5.1 アプリケーション事例

フィードフォワード制御による塩素調節

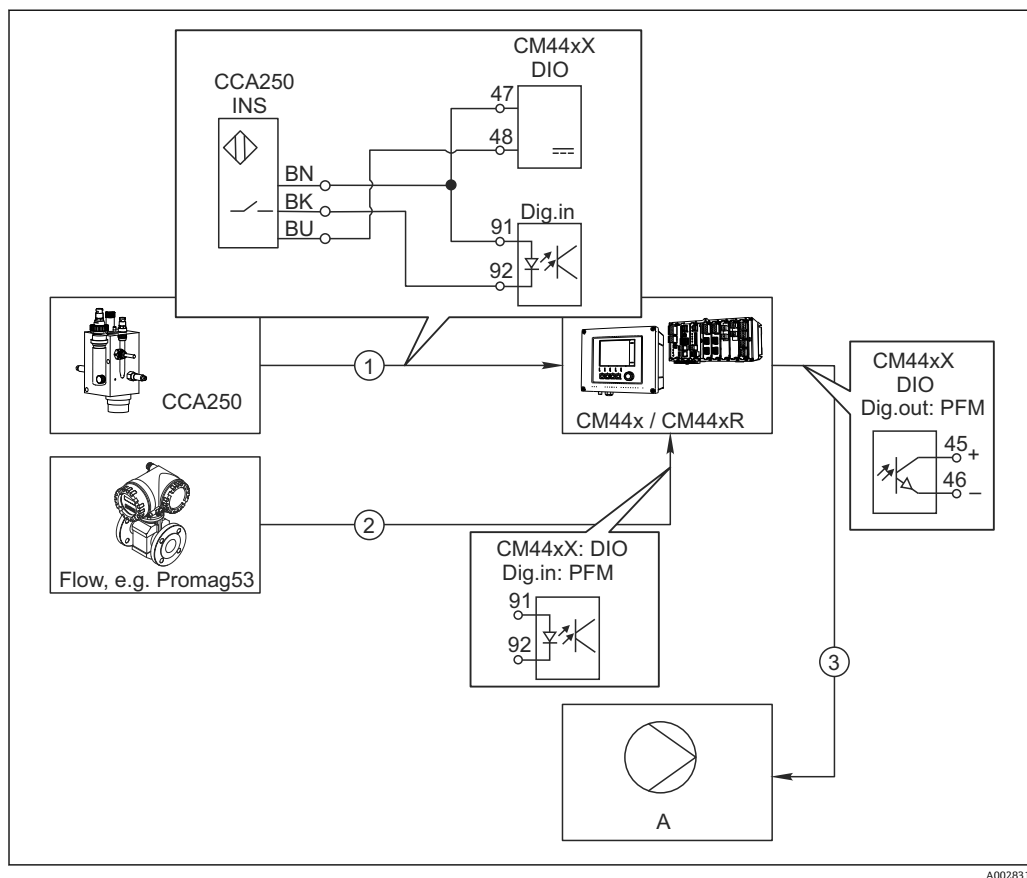

A0028316

図 52 フィードフォワード制御による塩素制御の例

- 1 CCA250 の電磁式近接スイッチ INS と DIO モジュールのデジタル入力への接続
- 2 流量計の信号と DIO モジュールのデジタル入力への接続
- 3 DIO モジュールのデジタル出力を介して（パルス）注入ポンプが起動
- A 注入ポンプ

リレー制御システムと比べて、バイナリ出力を用いた効率的な非摩擦制御のメリットを活用できます。パルス周波数変調 (PFM) を使用すると、高入力周波数で注入ポンプによる連続的な注入を実現できます。

1. ホルダ CCA250 の近接スイッチ INS を DIO モジュールのデジタル入力に接続します (例: スロット 6、ポート 1)。
2. ソフトウェアでコントローラを設定し、ソースとして近接スイッチを接続するバイナリ入力を選択します (例: バイナリ入力 1)。(メニュー/追加機能/コントローラ/コントローラ 1/コントローラ起動可能 = バイナリ入力 1)
3. **信号タイプ**: 選択した入力に対して、初期設定 (静的信号)。
4. 流量計の測定値を DIO モジュールの 2 番目の入力に接続します (例: スロット 6、ポート 2)。
5. **信号タイプ**: この入力に対して **PFM** を選択します。(メニュー/入力/バイナリ入力 6:2/信号タイプ = PFM)
6. **入力モード**: 対応する測定値を選択します (流量)。
 - ➡ これで、コントローラの外乱変数として設定した入力を使用できるようになります²⁾。


2) フィードフォワード制御には、アクティベーションコード、オーダー番号 71211288 が必要です。

7. **外乱変数**：コントローラメニューで、流量測定値を接続したバイナリ入力を選択します。(メニュー/追加機能/コントローラ/コントローラ 1 /外乱変数/データソース = バイナリ入力 6:2 および 測定値 = PFM 値)
8. 注入ポンプは、DIO モジュールのデジタル出力を介して PFM により始動できます。
ポンプを DIO モジュールの出力 (例：スロット 6、ポート 1) に接続し、メニューで次の設定を選択します。メニュー/出力/バイナリ出力 6:1/信号タイプ = PFM および データソース = コントローラ 1 を選択します。

注入の作用方向を考慮してください。適切なパラメータ (**アクチュエータタイプ = 単極 +** または **単極 -**)。

プロセスの条件に応じて、制御を完全にカスタマイズするためには、コントローラメニューで追加設定を行う必要があります。

CM44x を洗浄マスターとして使用する場合

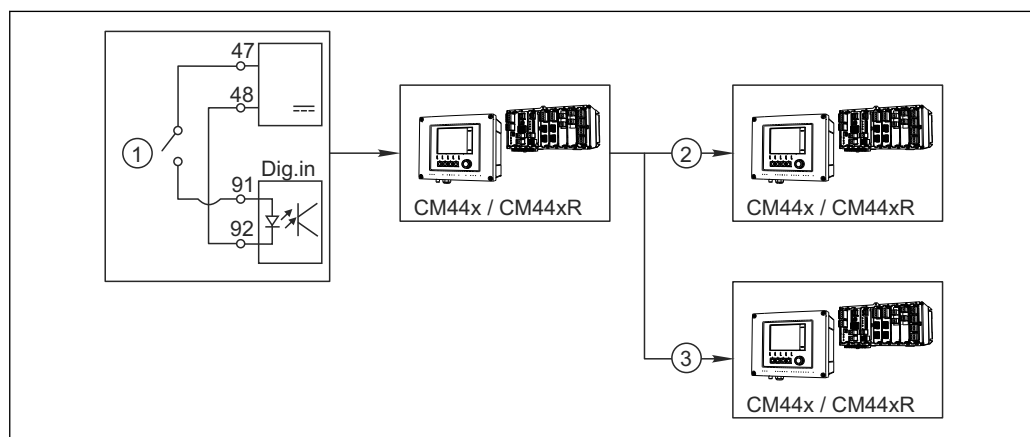

A0028320

図 53 中央洗浄制御の例

- 1 バイナリ入力での外部洗浄トリガ
- 2 洗浄機能が接続されていない他の機器へのバイナリ出力を介した外部ホールドの伝送
- 3 他の自己洗浄測定点へのバイナリ出力を介した洗浄トリガの伝送

1. 外部トリガによりマスターで洗浄作業が作動します。
洗浄ユニットはリレーやバイナリ出力などを介して接続されます。
2. 洗浄トリガがバイナリ出力を介して他の機器に伝送されます。この機器には独自の洗浄ユニットがないが、マスター洗浄の影響を受ける測定物内にそのセンサが取り付けられている場合、トリガによりホールドされるように設定されます。
3. 追加のバイナリ出力を介して、トリガが別の機器に伝送されます。この機器に接続されたセンサには独自の洗浄ユニットがあります。この信号を使用して、自己洗浄とマスター洗浄を同時に作動させることが可能です。

10.5.2 バイナリ入力設定

メニュー/設定/入力/バイナリ入力 x:y ¹⁾		
機能	オプション	情報
バイナリ入力	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	入力オン/オフの切り替え
信号タイプ	選択 ■ 静的信号 ■ PFM 初期設定 静的信号	▶ 信号タイプの選択 静的信号 この設定を使用して、オン/オフスイッチ、電磁式近接スイッチ、PLC バイナリ出力などの位置を読み取ります。 信号アプリケーション：計測レンジスイッチ、外部ホールドの承認、洗浄トリガ、コントローラ起動用 PFM PFM 設定によりパルス周波数変調信号が生成され、その後、これが準連続プロセス値として機器で使用できます。 例：流量計の測定信号
信号タイプ = 静的信号		
信号レベル	選択 ■ 低 ■ 高 初期設定 高	計測レンジスイッチまたは洗浄などのために、どちらの入力信号レベルを有効にするか指定します。 低 DC 0～5 V の入力信号 高 DC 11～30 V の入力信号
信号タイプ = PFM		
最大周波数	100.00～1000.00 Hz 初期設定 1000.00 Hz	PFM 入力信号の最大周波数 これは、測定範囲最大の上限リミットと等しくなります。 選択した値が小さすぎると、それより高い周波数が検出されなくなります。逆に選択した値が大きすぎると、低周波数の分解能が比較的不正確になります。
測定値フォーマット	選択 ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### 初期設定 #.#	▶ 小数点以下の桁数を指定してください。

メニュー/設定/入力/バイナリ入力 x:y ¹⁾		
機能	オプション	情報
入力モード	選択 ■ 周波数 ■ パラメータ ■ 流量 初期設定 周波数	周波数 測定メニューで Hz の表示 パラメータ 次に、パラメータ名と単位を設定します。これらは、測定メニューに表示されます。 流量 流量計の接続用
パラメータ名 入力モード = パラメータ	カスタマイズテキスト、 16 文字	▶ パラメータ名を設定します (例: 圧力)。
測定単位 入力モード = パラメータ	カスタマイズテキスト、 16 文字	▶ パラメータの単位を設定します (例: hPa)。
流量単位 入力モード = 流量	選択 ■ l/s ■ l/h ■ m³/s ■ m³/h ■ cfs ■ cfd ■ mgd 初期設定 l/s	▶ 流量の単位を設定します。 cfs = 立方フィート/秒 cfd = 立方フィート/日 mgd = メガガロン/日
低レンジ値 入力モード = パラメータ または 流量	-2000.00～0.00 初期設定 0.00	測定範囲下限は周波数 0 Hz に対応します。事前に設定した単位が追加表示されます。
高レンジ値 入力モード = パラメータ または 流量	0.00～10000.00 初期設定 0.00	測定範囲上限は、上記で設定した最大周波数に対応します。事前に設定した単位が追加表示されます。
ダンピング	0～60 s 初期設定 0 s	ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。

1) x:y = スロット番号 : 入力番号

10.5.3 バイナリ出力の設定

メニュー/設定/出力/バイナリ出力 x:y ¹⁾		
機能	オプション	情報
バイナリ出力	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	出力オン/オフの切り替え
信号タイプ	選択 ■ 静的信号 ■ PFM 初期設定 静的信号	▶ 信号タイプの選択 静的信号 リレーに相当: 診断状態の出力またはリミットスイッチ PFM 塩素の値やコントローラの操作変数など、測定値の出力が可能です。 「非摩耗」切り替え接点として機能するため、注入ポンプなどに使用できます。

メニュー/設定/出力/バイナリ出力 x:y ¹⁾		
機能	オプション	情報
信号タイプ = 静的信号		
機能	選択 ■ なし ■ リミットスイッチ ■ 診断メッセージ ■ 洗浄 初期設定 なし	出力されたスイッチング状態のソース 次の機能は、選択されているオプションに依存します。 機能 = なし 機能をオフにします。他の設定はありません。
割当 機能 = 洗浄	複数選択 ■ 洗浄 1 - 水 ... ■ 洗浄 4 - 洗剤	ここでは、値やポンプを有効にするために使用するバイナリ出力を設定できます。洗浄プログラムの洗剤/ 水注入用のバイナリ出力に制御信号を具体的に割り当てます。 次のメニューから洗浄プログラムを定義できます。 メニュー/設定/追加機能/洗浄 .
データソース 機能 = リミットスイッチ	複数選択 リミットスイッチ 1 ... 8	▶ バイナリ出力を介して出力するリミットスイッチを選択します。 リミットスイッチの設定: メニュー/設定/追加機能/リミットスイッチ .
操作モード 機能 = 診断メッセージ	選択 ■ 割当 ■ Namur M ■ Namur S ■ Namur C ■ Namur F 初期設定 割当	割当 これを選択した場合、個別に割り当てたバイナリ出力を介して診断メッセージが伝送されます。 Namur M ... F Namur クラスの 1 つを使用することを選択した場合、各クラスに割り当てられているすべてのメッセージが出力されます。 診断メッセージごとに Namur クラスの割当てを変更することができます → 115。
信号タイプ = PFM		
最大周波数	1.00~1000.00 Hz 初期設定 1000.00 Hz	PFM 出力信号の最大周波数 これは、測定範囲最大の上限リミットと等しくなります。
測定値フォーマット	選択 ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### 初期設定 #.##	▶ 小数点以下の桁数を指定してください。

メニュー/設定/出力/バイナリ出力 x:y ¹⁾		
機能	オプション	情報
データソース	選択 ■ なし ■ センサ入力 ■ バイナリ入力 ■ コントローラ ■ フィールドバス信号 ■ 演算機能 初期設定 なし	バイナリ出力を介して周波数として読み出す値のソース
測定値 データソース ≠ コントローラ	選択 次に依存： データソース	▶ バイナリ出力を介して周波数として出力する測定値を選択します。
アクチュエータタイプ データソース = コントローラ	選択 ■ なし ■ 両極 ■ 単極 + ■ 単極 - 初期設定 なし	▶ 接続されたアクチュエータが、どのコントローラコンポーネントをトリガするか設定します（例：注入ポンプ）。 両極 「範囲分割」 単極 + プロセス値を増加させるためにコントローラが使用する操作変数の一部 単極 - 被制御変数を減少させる接続されたアクチュエータ用
ホールド 症状	選択 ■ フリーズ ■ 固定値 ■ なし 初期設定 なし	フリーズ 機器が最後の値を保持します。 固定値 定義した固定電流値が出力に伝送されます。 なし 出力は保持されません。
ホールド値 ホールド 症状 = 固定値	0～100 % 初期設定 0 %	
エラー症状	選択 ■ フリーズ ■ 固定値 初期設定 固定値	フリーズ 機器が最後の値を保持します。 固定値 定義した固定電流値が出力に伝送されます。
エラー値 エラー症状 = 固定値	0～100 % 初期設定 0 %	

1) x:y = スロット番号 : 入力番号

10.6 追加機能

10.6.1 リミットスイッチ

- リミットスイッチを設定するには、次の方法があります。
- スイッチオンポイントとスイッチオフポイントの割当て
 - リレーのスイッチオン遅延とスイッチオフ遅延の割当て
 - アラームしきい値の設定と、エラーメッセージの出力
 - 洗浄機能の始動

メニュー/設定/追加機能/リミットスイッチ/リミットスイッチ 1 ... 8		
機能	オプション	情報
データソース	選択 ■ なし ■ センサ入力 ■ バイナリ入力 ■ コントローラ ■ フィールドバス信号 ■ 演算機能 ■ MRS 設定 1 ... 2 初期設定 なし	▶ リミットスイッチのデータソースとなる入力または出力を指定してください。 提供されるデータソースは、機器バージョンに依存します。 接続されているセンサ、バイナリ入力、フィールドバス信号、演算機能、コントローラ、計測レンジスイッチ設定の中から選択できます。
測定値	選択 次に依存： データソース	▶ 測定値を選択します（次の表を参照）。

測定値（データソース に応じて）



データソース	測定値
pH ガラス電極	選択 ■ 生値 mV ■ pH ■ 温度
pH 半導体電極	
ORP	選択 ■ 温度 ■ ORP mV ■ ORP %
溶存酸素(隔膜式)	選択 ■ 温度 ■ 分圧 ■ 液体濃度 ■ 飽和 ■ 生値 nA (溶存酸素(隔膜式) のみ) ■ 生値 μS (溶存酸素(光学式) のみ)
溶存酸素(光学式)	
電磁式導電率	選択 ■ 温度 ■ 導電率 ■ 抵抗 (電極式導電率 のみ) ■ 濃度 (電磁式導電率 および 4 電極式導電率 のみ)
電極式導電率	
4 電極式導電率	
消毒	選択 ■ 温度 ■ センサ電流 ■ 濃度
ISE	選択 ■ 温度 ■ pH ■ アンモニウム ■ 硝酸 ■ カリウム ■ 塩素

データソース	測定値
濁度/SS	選択 ■ 温度 ■ 濁度 g/l (濁度/SS のみ) ■ 濁度 FNU (濁度/SS のみ) ■ 濁度ホルマジン (濁度 のみ) ■ 濁度固体 (濁度 のみ)
濁度	
硝酸	選択 ■ 温度 ■ 硝酸 ■ 硝酸態窒素
汚泥界面	選択 ■ 温度 ■ 界面 ■ 濁度
SAC	選択 ■ 温度 ■ SAC ■ 伝送 ■ 吸収 ■ COD ■ BOD
コントローラ 1	選択 ■ 両極 (電流出力の場合のみ) ■ 単極 + ■ 単極 -
コントローラ 2	
演算機能	すべての演算機能をデータソースとして使用することもできます。また、計算値を測定値として使用できます。

 操作変数を監視するには、リミットスイッチにコントローラ操作変数を割り当てます (たとえば、投与時間アラームを設定します)。

メニュー/設定/追加機能/リミットスイッチ/リミットスイッチ 1 ... 8		
機能	オプション	情報
洗浄プログラム	選択 ■ なし ■ 洗浄 1 ... 4 初期設定 なし	この機能を使用して、リミットスイッチがアクティブなときに起動される洗浄プログラムを選択してください。
機能	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	リミットスイッチのオン/オフ
操作モード	選択 ■ 上限チェック ■ 下限チェック ■ レンジ内チェック ■ 範囲外チェック ■ 変更レート 初期設定 上限チェック	リミット値監視のタイプ： ■ リミット値のオーバーシュートまたはアンダーシュート →  54 ■ レンジ内またはレンジ外の測定値 →  55 ■ 変更レート →  57

A0028524

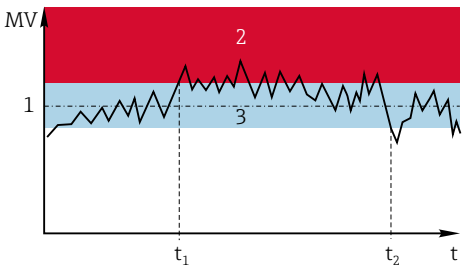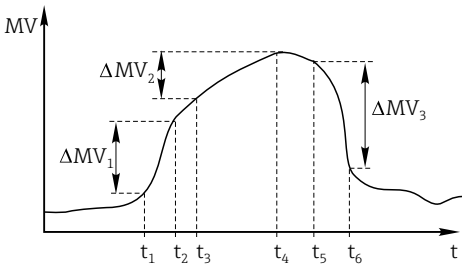メニュー/設定/追加機能/リミットスイッチ/リミットスイッチ 1 ... 8		
機能	オプション	情報
ヒステリシス  図 56 ヒステリシスのリミット値オーバーシュートの例 1 リミット値 2 アラームレンジ 3 ヒステリシスレンジ $t_{1,2}$ イベントの生成	設定は測定値に依存	操作モード ≠ 変更レート ヒステリシスは、安定した切替動作を確保するために必要です。 機器ソフトウェアにより、ここで設定された値がリミット値（リミット値、レンジ低値またはレンジ高値）に対して加算/減算されます。これにより、リミット値前後のヒステリシスレンジで「ヒステリシス」値が2倍になります。測定値（MV）が完全にヒステリシスレンジを超えた場合にのみイベントは生成されます。
開始遅延 操作モード ≠ 変更レート スイッチオフ遅延 操作モード ≠ 変更レート	0~9999 s 初期設定 0 s	同意語：ピックアップ遅延とドロップアウト遅延
Δ 値 Δ 時間 自動確認	設定は測定値に依存 00:00:01 ... 23:59:00 初期設定 01:00:00 00:01~23:59 初期設定 00:01	
 図 57 変更レート		操作モード = 変更レート に設定します。 このモードでは、測定値（MV）のスロープが監視されます。 指定された時間枠（Δ時間）で、測定値が設定値（Δ値）よりも増減した場合、イベントが生成されます。このような急激な値の増加または減少が続く場合は、それ以上イベントが生成されることはありません。スロープがリミット値以下に戻った場合、事前に設定した時間（自動確認）の経過後にアラームステータスがリセットされます。 例えば、以下の条件でイベントがトリガされます。 $t_2 - t_1 < \Delta \text{時間}$ かつ $\Delta MV_1 > \Delta \text{値}$ $t_4 - t_3 > \text{自動確認}$ かつ $\Delta MV_2 < \Delta \text{値}$ $t_6 - t_5 < \Delta \text{時間}$ かつ $\Delta MV_3 > \Delta \text{値}$

10.6.2 時間スイッチ

タイムスイッチは、時間により制御されるバイナリプロセス値を提供します。これは、「数式」演算機能によりソースとして使用できます。.

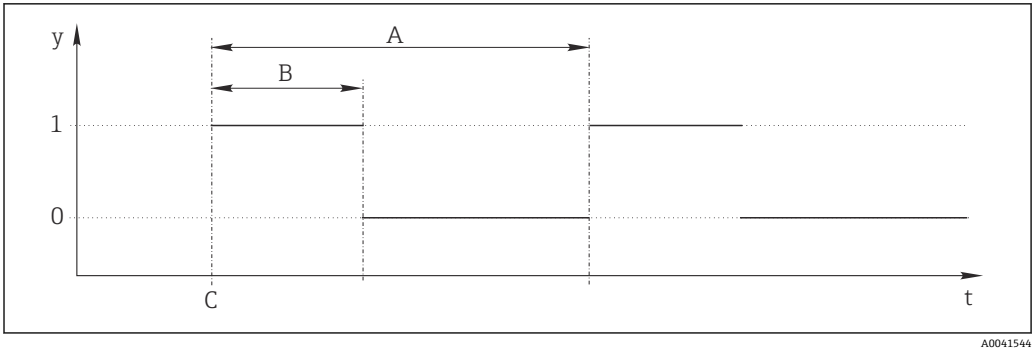



図 58 タイムスイッチの信号パターン

t タイムライン
y 信号レベル (1 = オン、0 = オフ)
A 期間
B 信号継続時間
C 開始時間 (開始日、開始時間)

メニュー/設定/追加機能/タイムスイッチ/ タイムスイッチ 1 ... 8		
機能	オプション	情報
機能	選択 ■ オン ■ オフ 初期設定 オフ	機能のオン、オフを切り替えます。
開始日	01.01.2000～31.12.2099 形式 DD.MM.YYYY	▶ 開始日を入力します。
開始時間	00:00:00～23:59:59 形式 HH:MM:SS	▶ 開始時間を入力します。
信号継続時間	00:00:03～2400:00:00 形式 HH:MM:SS	サイクル開始時の高い信号レベルの継続時間
期間	00:00:03～2400:00:00 形式 HH:MM:SS	サイクル継続時間
信号	表示のみ	タイムスイッチの現在のプロセス値
次の信号日付	表示のみ	次の信号の日付
次の信号時間	表示のみ	次の信号の時間

例 1：時間に基づいた温度コントローラの設定値

温度が毎日 08:00 に 21 °C に上昇し、12:00 から 5 時間は 23 °C で、17.00 からは 18 °C に下降するよう制御する場合を考えます。このためには、**MF1: Formula** 演算機能で使用する 2 つのタイムスイッチを定義します。演算機能を使用して、アナログの温度セットポイントをコントローラで使用できます。

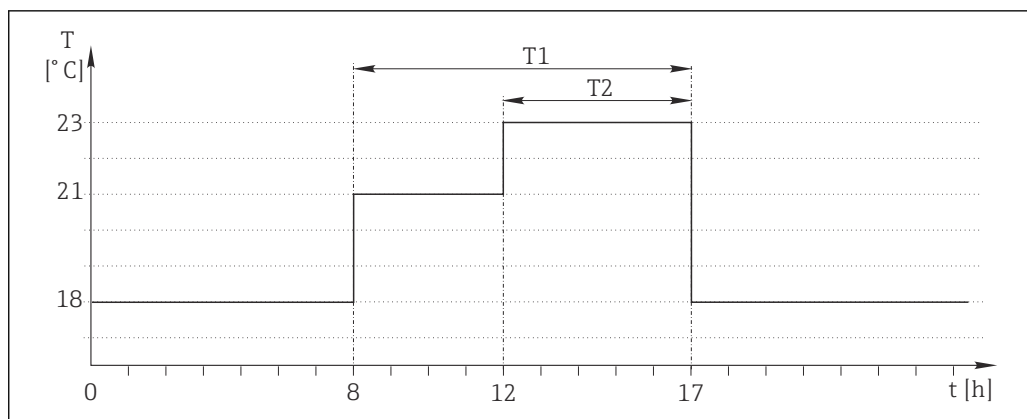

A0041704

図 59 時間に基づいた温度制御

1. タイムスイッチ 1 (T1) をプログラムします。

- 開始日 = 01.01.2020
- 開始時間 = 08:00:00
- 信号継続時間 = 09:00:00
- 期間 = 24:00:00

2. タイムスイッチ 2 (T2) を定義します。

- 開始日 = 01.01.2020
- 開始時間 = 12:00:00
- 信号継続時間 = 05:00:00
- 期間 = 24:00:00

3. Formula 演算機能を作成します。

メニュー/設定/追加機能/演算機能

- MF1: Formula
- トラッキング = オン
- Source A = タイムスイッチ 1
- Source B = タイムスイッチ 2
- Formula = $18.0 + 3 * \text{NUM}(A) + 2 * \text{NUM}(B)$

説明：NUM は論理値を数値に変換し、これにより乗算が可能となります。

- $3 * \text{NUM}(A)$ は、08 : 00 から 17:00 までの値が 3.0 になり、この期間外は 0.0 になります。
- $2 * \text{NUM}(B)$ は、12 : 00 から 17:00 までの値が 2.0 になり、この期間外は 0.0 になります。

したがって、式は時間に応じて、18.0、21.0、または 23.0 のアナログ値のいずれかを生成します。このアナログ値を温度コントローラのセットポイントとして使用します。

例 2 : 時間に基づいた条件

ポンプのスイッチを（リレーを介して）2 時間ごとに 10 分間入れる必要があるとします。これは、pH 値が 4.0 未満の場合にのみ適用します。.

1. タイムスイッチ 1 をプログラムします。

- 開始日 = 01.01.2020
- 開始時間 = 00:00:00
- 信号継続時間 = 00:10:00
- 期間 = 02:00:00

2. Formula 演算機能を作成します。

メニュー/設定/追加機能/演算機能

- MF1: Formula
- トラッキング = オン
- Source A = タイムスイッチ 1
- Source B = Memosens pH 計入力の pH 値
- Formula = A AND (B<4.0)

3. 数式をリレーのデータソースとして使用します。

メニュー/設定/出力/Relay[x:y]

- 機能 = Formula
- 操作モード = 静的信号
- データソース = MF1: Formula

式は論理値 (TRUE または FALSE) を生成し、静的動作モードでリレーを直接トリガできます。**タイムスイッチ 1** は、pH 値が同時に 4 未満に低下した場合にのみ、2 時間ごとに 10 分間 TRUE の値を返します。

10.6.3 コントローラ

ラプラス表現のコントローラ構造

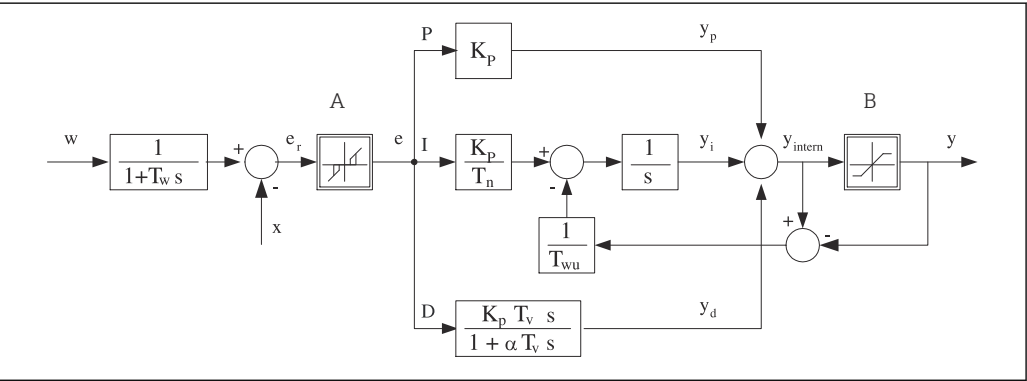


図 60 コントローラ構造のブロック図

A	中立帯	I	積分値
B	出力制限	D	微分値
K _p	ゲイン (P 値)	αT _v	α = 0~1 のダンピング時定数
T _n	積分動作時間 (I 値)	e	制御偏差
T _v	微分動作時間 (D 値)	w	セットポイント
T _w	セットポイントダンピングの時定数	x	被制御変数
T _{wu}	アンチwindアップフィードバックの時定数	y	操作変数
P	比例値		

本機のコントローラ構造は、セットポイントが変更された場合に操作変数の不規則な変化を防止するために、入力にセットポイントダンピングを含んでいます。セットポイント w と被制御変数 (測定値) X の差の結果、中立帯によってフィルタされる制御偏差が生じます。

中立帯は、小さすぎる制御偏差 (e) を抑制するために使用されます。このようにしてフィルタされた制御偏差は、P (比例)、I (積分) および D (微分) 値に基づいて 3 つの部分 (上から下へ) に分けられる実際の PID コントローラに与えられます。積分部分 (中央) は、積分器を制限するためのアンチwindアップメカニズムも含んでいます。操作変数においてハードな D 項をダンピングするために、ローパスフィルタが D 部分に追加されます。3 つの部分を合計した結果、設定に従って (PID-2 の場合、-100%~+100%) 制限される内部コントローラ操作変数が得られます。


この図では、操作変数の変化率を制限するための下流側フィルタを示していません (最大Y変化率 / s)。


 このメニューで、ゲイン K_p を設定しないでください。代わりに、逆数値、つまり、比例帯 X_p ($K_p=1/X_p$) を設定してください。



設定


- コントローラを設定するために、次のことを決定してください。
- (1) どのプロセスタイプに自分のプロセスを割り当てるか → **プロセスタイプ**
 - (2) 一方向または両方向のいずれで測定変数 (被制御変数) に影響を与えるか。1 極コントローラまたは 2 極コントローラ → **コントローラタイプ**
 - (3) 何を被制御変数にすべきか (センサ、測定値) → **制御変数**
 - (4) コントローラ出力でアクティブにしなければならない外乱変数があるか → **外乱変数**
 - (5) コントローラについて以下のパラメータを設定してください。
 - セットポイント → **セットポイント**
 - 中立帯 → **Xn**
 - 比例帯 → **Xp**
 - 積分動作時間 (I 値) → **Tn**
 - 微分動作時間 (D 値) → **Tv**
 - (6) ホールド (測定エラー、センサ交換、洗浄など) の場合にコントローラは何をすべきか
 - 投与を一時停止するかそれとも続行するか → **ホールド 症状/操作変数**
 - ホールド終了時に、制御ループを続行するかそれとも再開するか (I 値に影響を与えます) → **ホールド 症状/状況**
 - (7) アクチュエータをどのようにトリガすべきか
 - **単極+** : 測定値を増加できるアクチュエータの出力に、この設定を割り当ててください。
 - **単極-** : 測定値を減少できるアクチュエータの出力に、この設定を割り当ててください。
 - **両極** : 1 つの電流出力のみを介して操作変数を出力したい場合は、この設定を選択してください (範囲分割)。
 - (8) 出力を設定し、コントローラをオンにします。


メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1 ... 2		
機能	オプション	情報
制御	選択 ■ オフ ■ 自動 ■ 手動モード 初期設定 オフ	▶ 最初にコントローラを設定し、スイッチを初期設定のままにします (オフ)。 すべての設定を行ったら、コントローラを出力に割り当て、オンにできます。
▶ 手動モード		
y	-100~100 % 初期設定 0 %	▶ 手動モードで出力される操作変数を指定してください。
Y の実際の出力	読み取り専用	実際に出力される操作変数。
セットポイント		現在のセットポイント
x		現在の測定値
外乱変数		外乱変数の現在の測定値
外乱値		
名前	フリーテキスト	▶ 後で識別できるようにコントローラに名前を付けてください。

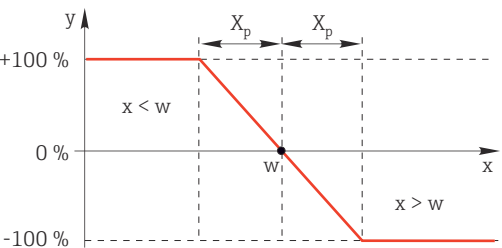
メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1 ... 2		
機能	オプション	情報
コントローラ起動可能	選択 ■ なし ■ バイナリ入力 ■ リミットスイッチ ■ フィールドバス変数 初期設定 なし	DIO モジュールとの接続では、バイナリ入力信号（例：誘導近接スイッチから）を選択して、コントローラを有効化するためのソースとして使用できます。
レベル設定	選択 ■ 標準 ■ 拡張 初期設定 標準	設定できるパラメータの数を変更します。→ パラメータ → 95 標準 ：これを選択した場合でも、他方のコントローラパラメータがアクティブになります。初期設定が使用されます。ほとんどの場合は、これで十分です。
プロセスタイプ	選択 ■ インライン ■ バッチ 初期設定 インライン	▶ どのプロセスタイプが特定のプロセスを最もよく表すかを判断してください。
バッチプロセス 測定液は閉鎖系内にあります。 制御システムのタスクは、測定値（被制御変数）が開始値から目標値に変化するように投与を行うことです。セットポイントに到達し、システムが安定したら、それ以上の投与は必要ありません。目標値を上回った場合、2 サイド制御システムがこれを補償できます。2 サイドバッチ制御システムの場合、セットポイントの周りのぶれを抑制するために中立帯が使用/設定されます。		
インラインプロセス インラインプロセスでは、制御システムは、プロセスで流れる測定液で動作します。 その場合、コントローラのタスクは、操作変数を使用して、結果として得られる測定変数がセットポイントと一致するように、測定液と投与剤の混合比を設定することです。測定液の流動特性および流量は常に変化するため、コントローラはこれらの変化に継続的に対応する必要があります。流量と測定液が一定のままである場合、プロセス整定後に、操作変数は固定値をとることもできます。制御プロセスはここで「終了」しないため、このタイプの制御は連続制御とも呼ばれます。		
 両方のプロセスタイプの混合、つまり、セミバッチプロセスが実行されることが多くなっています。流量とコンテナ容量の比率に応じて、この構成はバッチプロセスまたはインラインプロセスのいずれかのように動作します。		
コントローラタイプ	選択 ■ PID 1 極 ■ PID 2 極 初期設定 PID 2 極	接続したアクチュエータに応じて、1 方向のみ（例：加熱）または両方向（例：加熱と冷却）のプロセスに影響を与えます。
2 極コントローラは操作変数を -100~+100 % の範囲で出力できます。つまり、操作変数は 2 極性になります。コントローラがプロセス値を増加させるべきである場合、操作変数は正です。真の P コントローラの場合、これは、被制御変数 x の値がセットポイント w より小さいことを意味します。一方、プロセス値を減少させるべきである場合、操作変数は負です。 x の値はセットポイント w より大きくなっています。		
		
 61 関係 $y = (w-x)/X_p$		

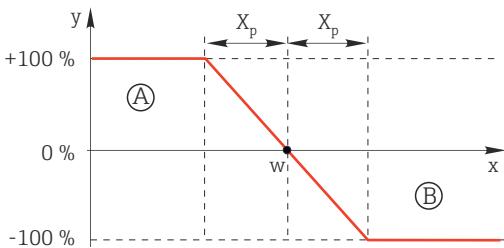メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1 ... 2		
機能	オプション	情報
効果的な指針 コントローラタイプ = PID 1 極	選択 - 直接 - 逆 初期設定 逆	コントローラはどの方向で測定値に影響を与えるべきか - 注入によって測定値は増加します (例: 加熱) → 逆 - 注入によって測定値は減少します (例: 冷却) → 直接
1 極コントローラは単極操作変数を出力します。つまり、1 方向のプロセスにのみ影響を与えることができます。 逆: コントローラがプロセス値を増加させるべきである場合、これを動作方向として設定してください。プロセス値が小さくなりすぎると、コントローラがアクティブになります (範囲 A)。 直接: この動作方向の場合、コントローラは「減少コントローラ」として機能します。プロセス値 (例: 温度) が大きくなりすぎると、コントローラがアクティブになります (範囲 B)。		
		
図 62 赤色: 2 つの 1 サイドコントローラの曲線間の重複を示しています。		
▶ 制御変数		
データソース	選択 - なし - センサ入力 - 電流入力 - フィールドバス信号 - バイナリ入力 - 演算機能 初期設定 なし	▶ 被制御変数のデータソースとなる入力または出力を指定してください。
測定値	選択 次に依存: データソース 初期設定 なし	▶ 被制御変数となる測定値を指定してください。 データソースによって異なる測定値を使用できます。→ 図 83
▶ セットポイント		被制御変数の目標値 ソースとしてフィールドバスを選択した場合、このメニューは表示されません (データソース = フィールドバス)。
セットポイント	補正および初期設定の範囲は次に依存: データソース	▶ 被制御変数の目標値を指定してください。
Tw レベル設定 = 拡張	0.0~999.9 s 初期設定 2.0 s	セットポイントダンピングフィルタの時定数
▶ 外乱変数		i オプション、アクティベーションコードが必要

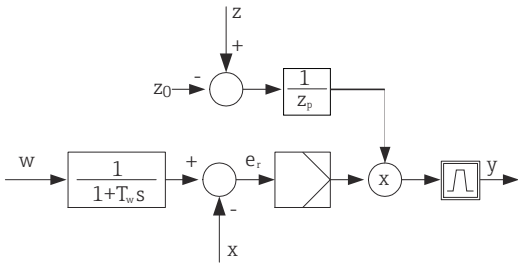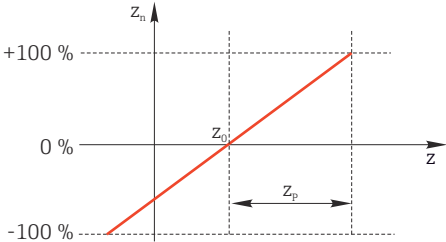メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1 ... 2		
機能	オプション	情報
「流体」（インライン）制御の場合、流量が一定しないことがあります。場合によっては、激しい変動が生じる可能性があります。流量を急速に半減させた安定制御システムの場合、コントローラからの注入量も直ちに半減させることが望ましいです。このような「流量に比例する」注入タイプを実現するためには、このタスクをコントローラの I コンポーネントに委ねるのではなく、コントローラ出力に（測定）流量を外乱変数 z として乗算入力する必要があります。  厳密に言えば、フィードフォワード制御はその影響が直接測定できないため、オープンループ制御システムに含まれます。これはつまり、フィードフローが前方にのみ向いていることを意味します。そのため、「フィードフォワード制御」という名称が付けられています。 また、これとは別に機器に用意されている加法フィードフォワード制御の場合、（標準化された）外乱変数がコントローラ操作変数に加えられます。これにより、可変のベースロード注入タイプの設定が可能になります。 乗法および加法フィードフォワード制御のいずれにも外乱変数の標準化が必要であり、パラメータ Z_0（ゼロ点）と Z_p（比例帯）：$z_n = (z - z_0)/z_p$ を使用してこれが行われます。  例 測定範囲が 0~200 m³/h の流量計 コントローラは現在、フィードフォワード制御なしで 100% 注入しています。 フィードフォワード制御は、$z = 200\text{m}^3/\text{h}$ 時に、コントローラが 100% で注入を継続するように設定する必要があります ($z_n = 1$)。 流量が低下すると注入の速度も減少し、流量 4 m³/h では注入が完全に停止しなければなりません ($z_n = 0$)。 → ゼロ点 $z_0 = 4\text{ m}^3/\text{h}$ と比例帯 $Z_p = 196\text{ m}^3/\text{h}$ を選択してください。		
機能	選択 ■ オフ ■ 乗算する ■ 追加 初期設定 オフ	乗法または加法フィードフォワード制御の選択
データソース	選択 ■ なし ■ センサ入力 ■ 電流入力 ■ フィールドバス信号 ■ バイナリ入力 ■ 演算機能 初期設定 なし	▶ 外乱変数のデータソースとなる入力を指定します。

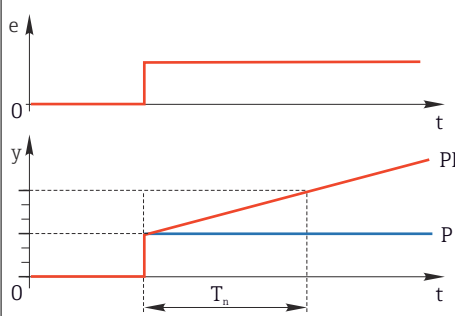メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1 ... 2		
機能	オプション	情報
測定値	選択 次に依存：データソース 初期設定 なし	▶ 外乱変数となる測定値を指定します。 データソースによって異なる測定値を使用できます。→ 83
Zp	調整範囲は測定値の選択に依存します。	比例帯 -->
Z0		ゼロ点
▶ パラメータ		
Liquiline PID コントローラは一連の構造形式で実装されます。つまり、以下のパラメータを備えます。 ■ 積分動作時間 T_n ■ 微分動作時間 T_v ■ 比例帯 X_p レベル設定 = 拡張：このレベル設定の場合、次のパラメータを設定することもできます。 ■ 時定数 T_{wu} ■ 時定数 α ■ 中立帯の幅 X_n ■ 中立帯のヒステリシス範囲の幅 X_{hyst} ■ コントローラの時刻		
T_n	0.0~9999.0 s 初期設定 0.0 s	積分動作時間はI値の効果を指定します。 $T_n > 0$ の場合、次が適用されます。 クロック < $T_{wu} < 0.5 (T_n + T_v)$
積分動作時間は、ステップ関数応答において、操作変数を変化させるのに要する時間です。I 効果の結果として、操作変数は P 値と同じ大きさになります。  e = 制御偏差、$e=w-x$ (セットポイント-被制御変数)		

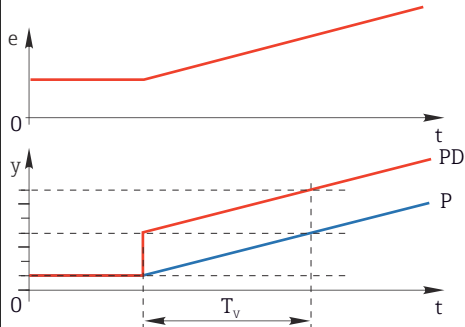メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1 ... 2		
機能	オプション	情報
Twu	0.1~999.9 s 初期設定 20.0 s	アンチwindアップフィードバックの時定数 この値が低いほど、積分器抑制が大きくなります。変更する際は細心の注意を払ってください。 クロック < Twu < 0.5 (Tn + Tv)
Tv	0.1~999.9 s 初期設定 0.0 s	微分動作時間は D 値の効果を指定します。
微分動作時間は、PD コントローラのランプ応答が操作変数の特定値に、P 値だけの結果として到達するよりも早い段階で到達するまでの時間です。 		
α	0.0~1.0 初期設定 0.3	D コントローラの追加ダンピングフィルタに影響を及ぼします。時定数は、 $\alpha \cdot T_v$ から計算されます。
プロセスバランス コントローラタイプ = PID 2 極	選択 ■ 対称 ■ 非対称 初期設定 対称	対称 制御ゲインは 1 つしかないため、これがプロセスの両側に適用されます。 非対称 プロセスの両側の制御ゲインは個別に設定できます。
Xp プロセスバランス = 対称	補正および初期設定の範囲は次に依存: データソース	比例帯、つまり、比例ゲイン K_p の逆数値 被制御変数 x のセットポイント w からの偏差が x_p を上回ると、直ちに操作変数 y が 100% に達します。
Xp 低 プロセスバランス = 非対象	補正および初期設定の範囲は次に依存: データソース	$x_p, y < 0$ の場合 (操作変数 < 0)
Xp 高 プロセスバランス = 非対象		$x_p, y > 0$ の場合 (操作変数 > 0)
Xn	補正および初期設定の範囲は次に依存: データソース	2 サイド制御ループを使用する場合に、セットポイントの周りの小さなぶれを防止する、セットポイントの上下の許容範囲。
XN 低 プロセスバランス = 非対象	補正および初期設定の範囲は次に依存: データソース	$x_n, x < w$ の場合 (被制御変数 < セットポイント)
XN 高 プロセスバランス = 非対象		$x_n, x > w$ の場合 (被制御変数 > セットポイント)

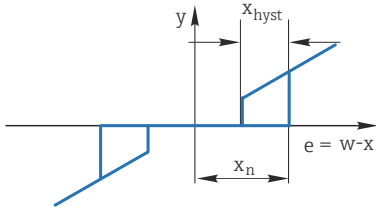メニュー/設定/追加機能/コントローラ 1 ... 2		
機能	オプション	情報
XHyst 	0.0~99.9 % 初期設定 0.0 %	中立帯のヒステリシス範囲の幅、 x_n の相対成分
クロック	0.333~100.000 s 初期設定 1.000 s	エキスパート設定 何をしようとしているか完全に理解できる場合にのみ、コントローラの時刻を変更してください。 クロック < Twu < 0.5 (Tn + Tv)
最大 Y 変化率 / s	0.00~1.00 初期設定 0.40	出力変数の変化を制限します。 値 0.5 の場合、1 秒以内に 50 % の最大操作変数の変化が許容されます。
▶ 除外症状		ホールド = 測定値が信頼できなくなる
操作変数	選択 ■ フリーズ ■ 固定値 初期設定 フリーズ	信頼できなくなった測定値に対してコントローラはどのように対応すべきかを指定します。 フリーズ 操作変数が現在値でフリーズされます。 固定値 操作変数が 0 に設定されます (投与なし)
状況	選択 ■ フリーズ ■ リセット 初期設定 フリーズ	内部コントローラステータス フリーズ 変更なし リセット ホールド後、制御システムは最初から起動し、整定時間が再度生じます。
除外としてホールド	選択 ■ 全て ■ なし 初期設定 全て	▶ ホールドにより、選択済みの例外動作を実行するか、またはこれを無視するかを選択します。
▶ 出力		次のメニューに移動します: 出力 → 68
▶ コントローラ割当ビュー		使用される入力および出力の概要が示されます。

10.6.4 洗浄プログラム

▲ 注意

洗浄システムは校正中またはメンテナンス中にオフにならない

測定物または洗浄剤による負傷の危険があります。

- ▶ 洗浄システムが接続されている場合は、洗浄システムをオフにした後でセンサを媒体から取り外してください。
- ▶ 洗浄機能をテストするために洗浄システムをオフにしない場合は、保護服、保護ゴーグル、および保護手袋を着用するか、その他の適切な措置を講じてください。

洗淨タイプ

以下の洗淨タイプから選択することができます。

- 標準洗淨
- ケモクリーン
- ケモクリーンプラス

 **洗淨状態:** 洗淨プログラムが動作中かそうでないかが示されます。これは情報提供のみを目的としています。

洗淨タイプの選択

1. **メニュー/設定/追加機能/洗淨:** 洗淨プログラムを選択します。
↳ 4つの異なる洗淨タイプを個別に入力に割り当てて設定することが可能です。
2. **洗淨タイプ:** 実行する洗淨タイプを洗淨プログラムごとに決定します。

標準洗淨

標準洗淨には、たとえば、イオン選択性センサ CAS40D で行われるような圧縮空気を
使用したセンサの洗淨が含まれます (CAS40D の洗淨ユニットの接続→ 36)。

メニュー/設定/追加機能/洗淨/洗淨 1 ... 4/標準洗淨		
機能	オプション	情報
洗淨時間	5～600 s 初期設定 10 秒	洗淨時間 洗淨期間および間隔はプロセスとセンサに依 存します。 ▶ 経験に基づいて変数を決定してください。

▶ 洗淨サイクルを設定します→ 100。

Chemoclean

使用例として、pH ガラス電極センサを洗淨するための CYR10 インジェクターユニット
があります。 (CYR10 接続→ 36)

メニュー/設定/追加機能/洗淨/洗淨 1 ... 4/ケモクリーン		
機能	オプション	情報
洗淨時間	0～900 s 初期設定 5 秒	洗淨時間
事前すぎ時間	0～900 s 初期設定 0 s	洗淨期間、事前すぎ時間と事後すぎ時間、 間隔はプロセスおよびセンサに応じて異なり ます。経験に基づいて変数を決定してくださ い。
事後すぎ時間		

Chemoclean Plus

使用例として、pH ガラス電極センサを洗浄するための CYR10 インジェクターユニットがあります。（CYR10 接続→ 36）

メニュー/設定/追加機能/洗浄/洗浄 1 ... 4/ケモクリーンプラス/ケモクリーンプラス 設定		
機能	オプション	情報
洗浄ステップ設定	時間プログラム作成用テーブル	順番に実施させる最大 30 のプログラムステップを定義します。各ステップに、それぞれのリレーまたは出力の継続時間 [秒] および状態 (0 = 「オフ」、1 = 「オン」) を入力します。出力の数と名前は、さらに下のメニューで設定します。 プログラミング例については、下記を参照してください。
フェイルセーフステップ設定	テーブル表示	▶ エラー発生時にリレーまたは出力が取るべき状態をこのテーブルで設定します。
リミットスイッチ	0~2	▶ デジタル入力信号の数を選択します（例：リトラクタブルホルダのリミット位置スイッチから）。
リミットスイッチ 1 ... 2	選択 ■ バイナリ入力 ■ フィールドバス信号	▶ 各リミット位置スイッチの信号源を設定します。
出力	0~4	▶ バルブやポンプなどのアクチュエータを作動させる出力の数を選択します。
出力ラベル 1 ... 4	フリーテキスト	各出力に意味のある名前を割り当てることができます（例：「ホルダ」、「洗浄剤 1」、「洗浄剤 2」など）。

プログラミング例：水および 2 つの洗浄剤を用いた定期的な洗浄

リミットスイッチ	継続時間 [秒]	ホルダ CPA87x	水	洗浄剤 1	洗浄剤 2
ES1 1	5	1	1	0	0
ES2 1	5	1	1	0	0
0	30	1	1	0	0
0	5	1	1	1	0
0	60	1	0	0	0
0	30	1	1	0	0
0	5	1	1	0	1
0	60	1	0	0	0
0	30	1	1	0	0
ES1 0	5	0	1	0	0
ES2 0	5	0	1	0	0
0	5	0	0	0	0

空気圧式リトラクタブルホルダ（例：CPA87x）は、二方弁を経由した圧縮空気により作動します。その結果、ホルダは「測定」位置（センサは測定物内）または「サービス」位置（センサは洗浄チャンバ内）のいずれかとなります。水または洗浄剤などの媒体はバルブまたはポンプを介して供給されます。これには、0（＝「オフ」または「閉」）および 1（＝「オン」または「開」）の 2 つの状態があります。

 制御バルブ、ポンプ、圧縮空気供給、媒体など「Chemoclean Plus」に必要なハードウェアはユーザー側で用意する必要があります。

洗浄サイクルの設定

メニュー/設定/追加機能/洗浄/洗浄 1 ... 4		
機能	オプション	情報
洗浄サイクル	選択 ■ オフ ■ 間隔 ■ 毎週プログラム 初期設定 毎週プログラム	▶ 設定された間隔で再始動する洗浄ルーチンまたはユーザー定義可能な週間プログラムを選択します。
洗浄周期 洗浄サイクル = 間隔	0-00:01～07-00:00 (D-hh:mm) 初期設定 1-00:00	洗浄周期は、1 分～7 日の間でできます。 例：値「1-00:00」を設定した場合、毎日、最初の洗浄サイクルを開始したのと同じ時刻に洗浄サイクルを開始します。
毎日のイベント時間 洗浄サイクル = 毎週プログラム	00:00～23:59 (HH:MM)	1. 最大 6 種類の時刻を設定できます (イベント時間 1 ... 6)。 ↳ この時刻を後程、それぞれの週日において選択できます。 2. この特定の日の洗浄ルーチンのために 6 種類ある時刻のどれを使用するか、それぞれの週日に対して個別に選択します。 これにより、プロセスに合わせて完璧に適應された週間プログラムを作成できます。
平日 洗浄サイクル = 毎週プログラム	選択 月曜日 ... 日曜日	

その他の設定および手動洗浄

メニュー/設定/追加機能/洗浄/洗浄 1 ... 4		
機能	オプション	情報
開始信号	選択 ■ なし ■ フィールドバス信号 ■ デジタルまたはアナログ入力の信号 初期設定 なし	周期的な洗浄に加えて、イベント制御式の洗浄を開始するための入力信号も使用できます。 ▶ こうした洗浄プロセスのトリガをここで選択します。 間隔および週間プログラムは通常通り実施されるため、重複を引き起こす可能性があります。最初に開始する洗浄プログラムが優先されます。
ホールド	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	▶ 洗浄プロセスの最中にホールドするかどうかを決定します。このホールドは、洗浄プロセスが割り当てられた入力に作用します。
▷ シングル開始	アクション	個別の洗浄プロセスを選択したパラメータで開始します。周期的な洗浄が有効になっている場合、プロセスを手動で開始できない場合があります。
▷ 停止 または フェイルセーフ停止	アクション	洗浄プロセスを終了（周期的または手動で）
▶ 出力		次のメニューに移動します：出力 → 68
▶ 洗浄プログラム割当ビュー		洗浄プロセスの概要が示されます。

10.6.5 演算機能

物理的に接続されているセンサまたはアナログ入力によって提供される「実際の」プロセス値に加えて、演算機能を使用して最大 8 つの「仮想的な」プロセス値を計算できます。

「仮想」プロセス値により以下が可能です。

- 電流出力またはフィールドバスを介して出力できる
- 被制御変数として使用できる
- リミットスイッチに測定変数として割当て
- 洗浄を開始する測定変数として使用
- ユーザー定義測定メニュー

差

2つのセンサの測定値を減算し、その結果を使用すると、不正な測定値の検出などを行うことができます。

差を計算するには、同じ工学単位を持つ2つの測定値を使用する必要があります。

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1~8/モード = 差		
機能	オプション	情報
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
Y1 測定値	オプションは、接続されているセンサに依存	センサと、被減数 (Y1) または減数 (Y2) として機能する測定変数を選択します。
Y2 測定値		
差		
▶ 演算機能割当ビュー	読み取り専用	ユーザー定義の測定画面でこの値を表示するか、電流出力を介してこの値を出力してください。
		設定された機能の概要

冗長性

この機能を使用して、冗長測定値を持つ2つまたは3つのセンサを監視できます。2つの最も近い測定値の算術平均が計算され、重複性の値として出力されます。

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1~8/モード = 冗長性		
機能	オプション	情報
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
Y1 測定値	オプションは、接続されているセンサに依存	同じ測定値を出力する、最大3つの各種センサタイプを選択できます。 温度重複性の例 入力1と2にpHセンサと溶存酸素センサがあります。pHセンサをY1として選択し、溶存酸素センサをY2として選択します。 測定値 ：いずれの場合も 温度 を選択します。
Y2 測定値		
Y3 (オプション) 測定値		

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1~8/モード = 冗長性		
機能	オプション	情報
偏差制御	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	重複性を監視できます。超過できない絶対限界値を指定する必要があります。
偏差リミット	選択されている測定値に依存	
冗長性	読み取り専用	ユーザー定義の測定画面でこの値を表示するか、電流出力を介してこの値を出力してください。
▶ 演算機能割当ビュー		設定された機能の概要

rH 値

rH 値を計算するには、pH センサと ORP センサを接続する必要があります。pH ガラス電極センサ、半導体電極センサ、ISE センサの pH 電極のいずれを使用するかは重要ではありません。

演算機能の代わりに、pH/ORP 複合センサを接続することも可能です。

▶ 単にメイン測定値を rH (設定/) に設定します。

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1~8/モード = rH 計算値		
機能	オプション	情報
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
pH ソース	接続されている pH センサ	pH センサ用の入力と ORP センサ用の入力を設定してください。pH または ORP mV を選択する必要があるため、測定値インタロゲーションは廃止されています。
ORP ソース	接続されている ORP センサ	
計算された pH 値	読み取り専用	ユーザー定義の測定画面でこの値を表示するか、電流出力を介してこの値を出力してください。
▶ 演算機能割当ビュー		設定された機能の概要

脱ガス導電率

空気中の二酸化炭素は、測定液の導電率の要因となることがあります。脱ガス導電率は、二酸化炭素に起因する導電率を除いた測定液の導電率です。

発電所を例にした、脱ガス導電率を使用するメリット

- 腐食生成物または汚染に起因する給水の導電率を、タービンの起動時にすぐに測定できます。システムは、空気が侵入した結果生じた最初の高い導電率値を除外します。
- 二酸化炭素が非腐食性に見なされた場合は、起動中の早い段階でタービンに生蒸気を送ることができます。
- 通常動作中に導電率値が上昇する場合、脱ガス導電率を計算することによって、冷却材または空気の侵入を即座に確認できます。

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1～8/モード = 脱ガス導電率		
機能	オプション	情報
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
カチオン導電率	接続されている導電率センサ	カチオン導電率 は、陽イオン交換器の下流側かつ「脱ガスモジュール」の上流側にあるセンサです。 脱ガス導電率 は、脱ガスモジュールの流出口にあるセンサです。 導電率しか選択できないため、測定値の選択は表示されません。
脱ガス導電率	接続されている導電率センサ	
二酸化炭素濃度	読み取り専用	ユーザー定義の測定画面でこの値を表示するか、電流出力を介してこの値を出力してください。
▶ 演算機能割当ビュー		設定された機能の概要

デュアル導電率

2つの導電率値を減算し、その結果を使用すると、イオン交換器の効率監視などを行うことができます。

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1～8/モード = デュアル導電率		
機能	オプション	情報
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
流入	オプションは、接続されているセンサに依存	被減数（ 流入 、例：イオン交換器の上流側センサ）または減数（ 放流 、例：イオン交換器の下流側センサ）として機能するセンサを選択します。
測定値		
放流		
測定値		
主測定フォーマット	選択 ■ Auto ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### 初期設定 Auto	小数点以下の桁数を指定してください。
導電率単位	選択 ■ Auto ■ µS/cm ■ mS/cm ■ S/cm ■ µS/m ■ mS/m ■ S/m 初期設定 Auto	
デュアル導電率	読み取り専用	ユーザー定義の測定画面でこの値を表示するか、電流出力を介してこの値を出力してください。
▶ 演算機能割当ビュー		設定された機能の概要

演算 pH 値

一定の条件下では、pH 値は、2 つの導電率センサの測定値から計算できます。適用分野には発電所、蒸気発生器、ボイラー給水などがあります。

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1~8/モード = 導電率からの pH 計算		
機能	オプション	情報
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
方法	選択 ■ NaOH ■ NH3 ■ LiOH 初期設定 NaOH	計算は、大規模発電所事業者技術協会 (Verband der Großkesselbetreiber (VGB)) のガイドライン VGB-R-450L に基づいて行われます。 NaOH $\text{pH} = 11 + \log \{(\kappa_v - 1/3 \kappa_h)/273\}$ NH3 $\text{pH} = 11 + \log \{(\kappa_v - 1/3 \kappa_h)/243\}$ LiOH $\text{pH} = 11 + \log \{(\kappa_v - 1/3 \kappa_h)/228\}$ κ_v ... 流入 ... 生導電率 κ_h ... 放流 ... 酸導電率
流入	オプションは、接続されているセンサに依存	流入 陽イオン交換器の上流にあるセンサ、つまり、「直流導電率」 放流 陽イオン交換器の下流にあるセンサ、つまり、「酸導電率」 測定値は常に「導電率」であるため、測定値の選択は表示されません。
測定値		
放流		
測定値		
計算された pH 値	読み取り専用	ユーザー定義の測定画面でこの値を表示するか、電流出力を介してこの値を出力してください。
▶ 演算機能割当ビュー		設定された機能の概要

陽イオン交換器量（オプション、アクティベーションコードが必要）

陽イオン交換器は、水/蒸気回路の無機汚染を監視するために使用されます。陽イオン交換器は、ボイラー用水に加えられる水酸化アンモニウムまたは苛性ソーダなどのアルカリ化物質の破壊的な影響を排除します。

陽イオン交換器の寿命は以下に応じて異なります。

- アルカリ化物質のタイプ
- アルカリ化物質の濃度
- 測定物の汚染量
- 陽イオン交換器の容量（樹脂の効率）

発電所の円滑な操作を保証するためには、交換カラムの負荷を継続的に監視することが重要です。ユーザー定義された残容量に達すると、変換器に診断メッセージが表示されるため、適時にイオン交換カラムを交換または再生することが可能です。

残容量の計算は、以下の要因に依存します。

- 流量
- 交換器の容量
- 交換器流入口における水の塩分濃度
- 樹脂の全容量
- 交換器の効率

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1~8/モード = 陽イオン交換器量		
機能	オプション	情報
導電率 IEX 出力	読み取り専用	
導電率 IEX 入力		
流量		
残量		
残りの稼働時間		
%OB までの時間 ¹⁾		
▶ 設定		
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
ポリュームの単位	選択 ■ l ■ gal 初期設定 l	
交換器量	0.0~99999 初期設定 0.0	陽イオン交換器の容量 単位は、次で選択したオプションに応じて異なります： ポリュームの単位
TVC 樹脂	0.0~ 99999 eq/l または eq/gal 初期設定 0.0 eq/l	TVC = 全容量 単位は、次と同じ： ポリュームの単位
樹脂効果	1.0~100.0 % 初期設定 100.0 %	樹脂の効率に関する情報については、使用する樹脂の製造者から提供されるデータを参照してください。
残量に設定	選択 ■ はい ■ いいえ 初期設定 いいえ	監視を開始する前に、交換器樹脂の残容量を指定します。 この値により、すでに使用された樹脂の再使用が考慮に入れます。 値を手動入力しなかった場合、現在の残容量を計算するための初期値として 100 % が使用されます。
残量 残量に設定 = はい に設定します。	0.0~100.0 % 初期設定 0.0 %	
警告リミット	1.0~100.0 % 初期設定 20.0 %	変換器が診断メッセージを表示する残容量を指定します。
導電率 IEX 入力	接続されている導電率センサ	交換器カラム流入口の上流側にある導電率センサを選択します。
導電率 IEX 出力	接続されている導電率センサ	交換器カラム流出口の下流側にある導電率センサを選択します。
IEX 出力での最大導電率	0.0~99999 µS/cm 初期設定 0.0 µS/cm	ここで、陽イオン交換器流出口の酸導電率の最大値を入力します。 この値を超過すると、変換器に診断メッセージが表示されます。

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1～8/モード = 陽イオン交換器量		
機能	オプション	情報
流量タイプ	選択 - 元値 - 固定値 初期設定 元値	元値 電流入力またはバイナリ入力を介して流量計の測定値を接続 固定値 固定流量の手動入力
流量	選択 - なし - 電流入力 - バイナリ入力 初期設定 なし	流量計の測定値を接続および設定した入力を指定します（メニュー/設定/入力）。
固定値 流量タイプ = 固定値 に設定します。	フリーテキスト	たとえば、外部の流量計で読み取った固定流量値を指定します。
最小流量	0.0～99999 l/h	
最大流量	初期設定 0.0 l/h	
▶ 演算機能割当ビュー		設定された機能の概要

1) %OB は変数であり、その値は設定に応じて異なります。設定値は表示されます（例：20%）。

Formula（オプション、アクティベーションコードが必要）

数式エディタにより、最大3つの測定値から新しい値を計算することが可能です。このために、さまざまな数学演算および論理（ブール）演算を使用できます。

 Liquiline ファームウェアは、数式エディタによって強力な計算ツールを提供します。数式の実行可能性、そして、それによる結果の実現可能性の責任はユーザーが負うものとします。

シンボル	操作	オペランドのタイプ	結果のタイプ	例
+	加算	数値	数値	A+2
-	減算	数値	数値	100-B
*	乗算	数値	数値	A*C
/	除算	数値	数値	B/100
^	電源	数値	数値	A^5
2	2 乗	数値	数値	A ²
3	3 乗	数値	数値	B ³
SIN	サイン	数値	数値	SIN(A)
COS	コサイン	数値	数値	COS(B)
EXP	指数関数 e ^x	数値	数値	EXP(A)
LN	自然対数	数値	数値	LN(B)
LOG	10 進法の対数	数値	数値	LOG(A)
MAX	2 つの値の最大	数値	数値	MAX(A,B)
MIN	2 つの値の最小	数値	数値	MIN(20,B)
MOD	余りが出る除算	数値	数値	MOD (10,3)
ABS	絶対値	数値	数値	ABS(C)
NUM	ブール → 数値変換	ブール	数値	NUM(A)
=	等しい	ブール	ブール	A=B

シンボル	操作	オペランドのタイプ	結果のタイプ	例
<>	～に等しくない	ブール	ブール	A<>B
>	～より大きい	数値	ブール	B>5.6
<	～より小さい	数値	ブール	A<C
OR	論理和	ブール	ブール	B OR C
AND	論理積	ブール	ブール	A AND B
XOR	排他的論理和	ブール	ブール	B XOR C
NOT	否定	ブール	ブール	NOT A

メニュー/設定/追加機能/演算機能/MF1～8/モード = Formula		
機能	オプション	情報
計算	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	この機能のオン/オフスイッチ
Source A ... C	選択 ソースの選択 初期設定 なし	測定値のソースとして、すべてのセンサ入力、バイナリおよびアナログ入力、演算機能、リミットスイッチ、タイムスイッチ、フィールドバス信号、コントローラ、計測レンジスイッチ用のデータセットを使用できます。
測定値	選択 ソースに依存	1. 測定値に対して最大3つのソース (A、B、C) を選択します。
A ... C	現在の測定値が表示されています。	2. それぞれのソースに対して計算する測定値を選択します。 ↳ 提供されるすべての信号が (選択したソースに応じて)、可能な測定値となります。 3. 数式を入力します。 4. 計算をオンにします。 ↳ 現在の測定値 A、B、C および数式を使用した計算結果が表示されます。
Formula	フリーテキスト	表 → 106  正確に表記するように注意してください (大文字)。数学的記号の前後の余白は無関係です。演算子の優先順位、つまり、乗算と除算が加算と減算に優先することに注意してください。必要に応じて、カッコを使用してください。
Result unit	フリーテキスト	必要に応じて、計算値の単位を入力できます。
Result format	選択 ■ # ■ #.# ■ #.## ■ #.### ■ #.#### 初期設定 #.##	小数点以下の桁数を選択します。
Result numeric	読み取り専用	現在の計算値
▶ 演算機能割り当てビュー		設定された機能の概要

例：体積流量監視に対応する 2 点塩素調整器

リレー出力により注入ポンプが作動します。次の 3 つの条件が満たされると、ポンプはオンになります。

- (1) 流れがあること
- (2) 体積流量が規定値を超過していること
- (3) 塩素の濃度が規定値を下回っていること

1. CCA250 ホルダの「INS」レベルリミットスイッチからのバイナリ入力信号を DIO モジュールに接続します。
2. 体積流量計のアナログ入力信号を AI モジュールに接続します。
3. 塩素センサを接続します。
4. **Formula** 演算機能を設定します：**Source A**= バイナリ入力 DIO、**Source B**= 電流入力 AI、**Source C**= 入力 消毒。
 ↳ 数式：

$$A \text{ AND } (B > 3) \text{ AND } (C < 0.9)$$
 (このとき、3 は体積流量の下限值、0.9 は塩素濃度の下限值)
5. **Formula** 演算機能を使用してリレー出力を設定し、注入ポンプに対応するリレーに接続します。

3 つの条件がすべて満たされると、ポンプはオンになります。条件の 1 つが満たされなくなると、ポンプは再びオフになります。

❏ 数式の結果を直接リレーに出力する代わりに、リミットスイッチを中間に接続することも可能です。それにより、スイッチオンおよびスイッチオン遅延を介して出力信号を減衰できます。

例：負荷ベースの制御

負荷（つまり、濃度および体積流量の産物）が、たとえば、沈殿剤を添加するために必要となります。

1. リン酸塩アナライザの入力信号を AI モジュールに接続します。
2. 体積流量計のアナログ入力信号を AI モジュールに接続します。
3. **Formula** 演算機能を設定します：**Source A**= リン酸塩入力信号および **Source B**= 体積流量入力信号。
 ↳ 数式：

$$A * B * x$$
 (このとき、x はアプリケーション固有の比例係数)
4. たとえば、電流出力または変調バイナリ出力のソースとして、この数式を選択します。
5. バルブまたはポンプを接続します。

10.6.6 計測レンジスイッチ

計測レンジスイッチ (MRS) 設定には、4 つのバイナリ入力状態のそれぞれのために以下のオプションがあります。

- 操作モード（導電率または濃度）
- 濃度テーブル
- 温度補償
- 電流出力ターンダウン
- リミットスイッチ範囲

MRS 設定がチャンネルに割り当てられ、オンになります。リンクされたセンサチャンネルの通常の設定の代わりに、バイナリ入力を介して選択された測定範囲設定が使用さ

れます。電流出力とリミットスイッチを MRS で制御するには、測定チャンネルではなく MRS 設定とリンクさせる必要があります。

電流出力とリミットスイッチは MRS 設定とリンクさせることが可能です。この MRS 設定により、測定値およびそれに関連するターンダウン（電流出力）、またはリミット値監視の範囲（リミットスイッチ）を取得できます。

MRS 設定に接続されたリミットスイッチは、必ず **範囲外チェック**モードを使用します。そのため、値が設定範囲を超過すると切り替わります。

電流出力またはリミットスイッチが MRS 設定に接続されている場合、ターンダウン、監視レンジ、リミットスイッチモードを手動で設定することはできません。そのため、これらのオプションはメニューで非表示となります（電流出力およびリミットスイッチ）。

プログラミング例：ビール製造における CIP 洗浄

	ビール	水	アルカリ	酸
バイナリ入力 1	0	0	1	1
バイナリ入力 1	0	1	0	1
	測定レンジ 00	測定レンジ 01	測定レンジ 10	測定レンジ 11
操作モード	導電率	導電率	濃度	濃度
濃度テーブル	-	-	NaOH 0..15%	ユーザテーブル 1
補償	ユーザテーブル 1	リニア	-	-
電流出力				
レンジ低値	1.00 mS/cm	0.1 mS/cm	0.50 %	0.50 %
レンジ高値	3.00 mS/cm	0.8 mS/cm	5.00 %	1.50 %
リミットスイッチ				
レンジ低値	2.3 mS/cm	0.5 mS/cm	2.00 %	1.30 %
レンジ高値	2.5 mS/cm	0.7 mS/cm	2.10 %	1.40 %

メニュー/設定/追加機能/測定レンジスイッチ		
機能	オプション	情報
► MRS 設定 1 ... 2		両方のアクティベーションコードを入力すると、計測レンジスイッチ用に 2 つの独立したパラメータ設定が使用できます。両設定ともサブメニューは同じです。
MRS	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	機能のオン、オフを切り替えます。
センサ	選択 ■ なし ■ 接続されている導電率センサ 初期設定 なし	この機能は導電率センサでのみ使用できます。
バイナリ入力 1 ... 2	選択 ■ なし ■ バイナリ入力 ■ フィールドバス信号 ■ リミットスイッチ 初期設定 なし	それぞれ入力 1 と 2 のために選択できるスイッチ信号のソース

メニュー/設定/追加機能/測定レンジスイッチ		
機能	オプション	情報
▶ 測定レンジ 00 ... 11		MRS を選択します (最大 4 つ可能)。それぞれのサブメニューは同じため、1 回しか表示されません。
操作モード	選択 ■ 導電率 ■ 濃度 ■ TDS ■ 抵抗 初期設定 導電率	選択は使用するセンサに依存： ■ 電磁式センサおよび 4 電極式センサ ■ 導電率 ■ 濃度 ■ TDS ■ 電極式センサ ■ 導電率 ■ 抵抗 ■ TDS
濃度テーブル 操作モード = 濃度	選択 ■ NaOH 0..15% ■ NaOH 25..50% ■ HCl 0..20% ■ HNO3 0..24% ■ HNO3 24..30% ■ H2SO4 0.5..27% ■ H2SO4 93..99% ■ H3PO4 0..40% ■ NaCl 0..26% ■ ユーザーテーブル 1 ... 4 初期設定 NaOH 0..15%	工場で保存された濃度テーブル： ■ NaOH : 0~15%、0~100 °C (32~212 °F) ■ NaOH : 25~50%、2~80 °C (36~176 °F) ■ HCl : 0~20%、0~65 °C (32~149 °F) ■ HNO3 : 0~25%、2~80 °C (36~176 °F) ■ H2SO4 : 0~28%、0~100 °C (32~212 °F) ■ H2SO4 : 40~80%、0~100 °C (32~212 °F) ■ H2SO4 : 93~100%、0~100 °C (32~212 °F) ■ H3PO4 : 0~40%、2~80 °C (36~176 °F) ■ NaCl : 0~26%、2~80 °C (36~176 °F)
補償 操作モード = 導電率	選択 ■ なし ■ リニア ■ NaCl (IEC 746-3) ■ 水 ISO7888 (20°C) ■ 水 ISO7888 (25°C) ■ UPW 塩化ナトリウム ■ UPW 塩酸 ■ ユーザーテーブル 1 ... 4 初期設定 リニア	温度依存性を補償するために様々な方法が利用できます。プロセスに応じて、どの補償タイプを使用するかを決定してください。あるいは、「 なし 」を選択して非補償導電率を測定することもできます。
▶ 電流出力		
レンジ低単位	次に依存：操作モード	単位は次の場合にのみ質問されます： 操作モード = 導電率 。他の単位は事前に設定されており、変更できません。 ■ 導電率 S/m, mS/cm, µS/cm, S/cm, µS/m, mS/m ■ 濃度 % ■ TDS ppm ■ 抵抗 Ωcm
レンジ低値		
レンジ高単位		
レンジ高値		
▶ リミットスイッチ		
レンジ低単位	次に依存：操作モード	単位は次の場合にのみ質問されます： 操作モード = 導電率 。他の単位は事前に設定されており、変更できません。 ■ 導電率 S/m, mS/cm, µS/cm, S/cm, µS/m, mS/m ■ 濃度 % ■ TDS ppm ■ 抵抗 Ωcm
レンジ低値		
レンジ高単位		
レンジ高値		

10.6.7 診断モジュール

ここで最大 8 つの個別の診断メッセージを設定できます。

診断モジュールには以下の特性があります。

- フィードソースはバイナリ出力（リレー、デジタル出力）のように設定できます。
- 診断メッセージを高レベルまたは低レベルで出力するか選択できます。
- どのエラーカテゴリ（Namur クラス）をメッセージに割り当てるか決定します。
- 診断メッセージテキストとして出力するカスタマイズテキストを設定できます。

また、リミットスイッチの工場出荷時の診断コードをオフにすることが可能です。これにより、以下が可能になります。

- 純粹に機能的基準でのリミットスイッチの使用（メッセージなし）
- アプリケーション固有のメッセージテキストの設定
- 直接デジタル信号で、またはリミットスイッチ出力を介して診断モジュールを制御（たとえば、スイッチオン/スイッチオフ遅延の使用が可能）。

メニュー/設定/追加機能/診断モジュール		
機能	オプション	情報
▶ 診断モジュール 1 (961) ... 8 (968)		
データソース	選択 ■ なし ■ フィールドバス信号 ■ バイナリ入力 ■ リミットスイッチ 初期設定 なし	診断メッセージのデータソースとなる入力を指定します。
測定値	選択 次に依存：データソース 初期設定 なし	診断メッセージをトリガする測定値を指定します。 データソースによって異なる測定値を使用できます。→ 83
有効低	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オン	オン ：出力値は逆出力値と等しくなります。
ショートテキスト	フリーテキスト	診断メッセージに名前を付けます。
▶ 診断モジュール割り当 ビュー		使用される診断モジュールの概要が示されます。

11 校正

- **Memosens** プロトコル付きセンサは工場で校正されています。
- 初回の設定中に校正が必要かどうかは、現在のプロセス条件を考慮してユーザ側で判断してください。
- 標準的なアプリケーションの多くでは、追加校正は不要です。
- プロセスに応じた適切な間隔でセンサ校正を行ってください。



取扱説明書「**Memosens**」、BA01245C

12 診断およびトラブルシューティング

12.1 一般トラブルシューティング

変換器は自身の機能を継続的に監視します。

診断メッセージが発生した場合、測定モードではディスプレイに診断メッセージと測定値が交互に表示されます。

エラーカテゴリ「F」の診断メッセージが発生した場合、ディスプレイの背景色は赤色に変わります。

12.1.1 トラブルシューティング

診断メッセージがディスプレイに、またはフィールドバスを介して表示された場合、測定値が適切でない場合、ユーザーが異常を認識した場合：

1. 診断メッセージの詳細について診断メニューを確認します。
↳ 問題を解決するには、その指示に従ってください。
2. それでも問題が解決しない場合：取扱説明書の「診断情報の概要」(→ 𐀀 116))で診断メッセージを検索してください。検索基準としてメッセージ番号を使用します。NAMUR エラーカテゴリを示す文字は無視してください。
↳ エラーリストの下に記載されたトラブルシューティングの指示に従ってください。
3. 異常な測定値、現場表示器の故障、または、その他の問題が発生している場合は、「メッセージがないプロセスエラー」(→ Memosens 取扱説明書、BA01245C) または「機器固有のエラー」(→ 𐀀 113) で、その問題を検索してください。
↳ 推奨の対策に従ってください。
4. ご自身でエラーを解決できない場合は、弊社サービス部門にお問い合わせください。その場合は、エラー番号をご連絡ください。

12.1.2 メッセージのないプロセスエラー

 取扱説明書「Memosens」、BA01245C

12.1.3 機器固有のエラー

問題	考えられる原因	テストおよび/または改善策
表示が暗い (オプションのディスプレイ付きのみ)	供給電圧がない	▶ 供給電圧が印加されているかどうかをチェックしてください。
	ディスプレイコネクタが間違っ て接続されている	▶ 確認する。ベースモジュールの RJ45 ソケットに接続しなければなりません。
	ベースモジュールが故障している	▶ ベースモジュールを交換してください。
ディスプレイに値が表示されるが、 ■ 表示が変化しない、または ■ 機器が作動しない。	モジュールが正しく配線されていない	▶ モジュールと配線をチェックしてください。
	操作システムの状態が許容できない	▶ 機器をオフにして、再度オンにします。
異常な測定値	入力の不良	▶ まずテストを行い、「プロセス固有エラー」セクションに従って測定します。 測定入力テスト： ▶ Memocheck シム CYP03D を入力に接続し、これを使用して入力の機能を確認します。

問題	考えられる原因	テストおよび/または改善策
電流出力、電流値が不正確	調整が間違っている	▶ 電流出力シミュレーションでチェックし、電流計を直接電流出力に接続してください。
	負荷が大きすぎる	
	電流内でグラウンドに分流/短絡している	
電流出力信号なし	ベースモジュールが故障している	▶ 電流出力シミュレーションでチェックし、電流計を直接電流出力に接続してください。

12.2 現場表示器の診断情報（オプション）

最新の診断イベントが、そのステータスカテゴリ、診断コード、ショートテキストとともに表示されます。ナビゲータをクリックすると、詳細情報や対処法に関するヒントを読み出すことができます。

12.3 ウェブブラウザ経由の診断情報

現場表示器に表示される情報と同じものが Web サーバー経由で提供されます。

12.4 フィールドバス経由の診断情報

診断イベント、ステータス信号、その他の情報が設定および各フィールドバスシステムの技術的能力に応じて伝送されます。

12.5 診断情報の適合

12.5.1 診断メッセージの分類

In **DIAG/診断リスト** メニューには、表示されている現在の診断メッセージに関する詳細情報が示されます。

診断メッセージは、NAMUR 規格 NE 107 に準拠しており、次の特徴があります。

- メッセージ番号
- エラーカテゴリ（メッセージ番号の先頭の文字）
 - **F** =（故障）故障が検出されました。
影響を受けるチャンネルの測定値の信頼性が失われました。故障の原因は計測機器にあります。接続されているすべての制御システムを手動モードに設定してください。
 - **C** =（機能チェック）、（エラーなし）
機器の保守作業が実施されています。作業が完了するまでお待ちください。
 - **S** =（仕様範囲外）、測定点が仕様範囲外で操作されています。
今のところは操作が可能です、摩耗の進行、動作寿命の短縮、測定精度低下の可能性あります。問題の原因は計測機器以外にあります。
 - **M** =（メンテナンス要求）、早急に措置を講じる必要があります。
機器はまだ正確に測定しています。必ずしも早急な措置が必要とは限りませんが、適切な保守作業により将来的な故障を予防できます。
- メッセージテキスト

 サービスセンターへのお問い合わせには、メッセージ番号のみをご連絡ください。エラーカテゴリへのエラーの割当ては個別に変更できるため、この情報はお伝えいただいてもサービスセンターで活用することはできません。

12.5.2 診断動作の適合

すべての診断メッセージは、工場で特定のエラーカテゴリに割り当てられています。アプリケーションによっては、設定を変更した方が適切な場合があるため、測定点のエラーカテゴリとエラー結果は個別に設定することができます。また、すべての診断メッセージは無効化することが可能です。

例

診断メッセージ 531 **ログブック満量**がディスプレイに表示されます。たとえば、ディスプレイにエラーが表示されないよう、このメッセージを変更できます。

1. **メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/診断設定/診断症状.**
2. 診断メッセージを選択し、ナビゲータボタンを押します。
3. 以下を決定します。
 - (a) メッセージを無効化するかどうか (**診断メッセージ = オフ**)
 - (b) エラーカテゴリ変更するかどうか (**ステータス信号**)
 - (c) エラー電流を出力するかどうか (**エラー電流 = オン**)
 - (d) 洗浄プログラムをトリガするかどうか (**洗浄プログラム**)
4. 例：メッセージを無効化します。
 - ↳ メッセージは表示されなくなります。In **DIAG** メニューで、メッセージは **過去のメッセージ**。

可能な設定

表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。

メニュー/設定/./追加セットアップ/診断設定/診断症状		
機能	オプション	情報
診断メッセージのリスト		▶ 変更するメッセージを選択してください。 その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。
診断コード	読み取り専用	
診断メッセージ	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 次に依存： 診断コード	ここで診断メッセージをオフまたは再びオンにできます。 オフは次のことを意味します。 ■ 測定モードでエラーメッセージが発生しない ■ 電流出力からエラー電流が出力されない
エラー電流	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 次に依存： 診断コード	診断メッセージの表示をオンにした場合に、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定してください。 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力がエラー電流に切り替えられます。 チャンネル固有のエラーが発生した場合は、問題の電流出力のみエラー電流に切り替えられます。
ステータス信号	選択 ■ メンテナンス (M) ■ 仕様範囲外 (S) ■ 機能チェック (C) ■ 故障 (F) 初期設定 次に依存： 診断コード	メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。 アプリケーションのステータス信号の割当てを変更するかどうかを決定してください。

メニュー/設定/.../追加セットアップ/診断設定/診断症状		
機能	オプション	情報
診断出力	選択 ■ なし ■ バイナリ出力 ■ アラームリレー ■ リレー 初期設定 なし	この機能を使用して、診断メッセージの割当先となる出力を選択できます。  機器バージョンに関係なく、必ずアラームリレーが1つ用意されます。他のリレーはオプションです。 出力にメッセージを割り当てる前に： 以下の出力タイプの1つを次のように設定します。 メニュー/設定/出力/ (アラームリレー または バイナリ出力 または リレー)/機能 = 診断 および 操作モード = 割当.
洗浄プログラム	選択 ■ なし ■ 洗浄 1 ... 4 初期設定 なし	診断メッセージが洗浄プログラムをトリガするかどうかを決定してください。 次のメニューから洗浄プログラムを定義できます。 メニュー/設定/追加機能/洗浄.
▶ 詳細情報	読み取り専用	ここで、診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示を確認できます。

12.6 診断情報の概要

12.6.1 機器固有の一般的な診断メッセージ

番号	メッセージ	初期設定			テストまたは改善策
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
202	自己診断中	F	オン	オフ	自己診断が完了するまでお待ちください。
216	ホールド起動中	C	オン	オフ	チャンネルの出力値およびステータスがホールド
241	ファームウェアエラー	F	オン	オン	内部機器エラー
242	ソフトウェアに互換性がありません	F	オン	オン	1. ソフトウェアを更新してください。 2. サービスセンターにお問い合わせください。
243	ファームウェアエラー	F	オン	オン	
					3. バックプレーンを交換してください (サービスセンター)。
261	電子モジュール	F	オン	オン	電子モジュールが故障している 1. モジュールを交換する。 2. サービスセンターにお問い合わせください。
262	モジュール接続	F	オン	オン	電子モジュールが通信していない 1. モジュールを点検し、必要に応じて交換してください。 2. サービスセンターにお問い合わせください。
263	互換性不一致が確認されました	F	オン	オン	電子モジュールのタイプが間違っている 1. モジュールを交換する。 2. サービスセンターにお問い合わせください。
284	ファームウェアアップデート	M	オン	オフ	更新が正常に完了

番号	メッセージ	初期設定			テストまたは改善策
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
285	アップデートエラー	F	オン	オン	ファームウェアの更新失敗 1. 再試行してください。 2. SD カードエラー → 別のカードを使用してください。 3. 不適切なファームウェア → 適切なファームウェアで再試行してください。 4. サービスセンターにお問い合わせください。
302	バッテリー容量低下	M	オン	オフ	リアルタイムクロックのバッテリー不足 電源が切れると日付と時刻のデータは失われます。 ▶ サービスセンターにお問い合わせください (バッテリー交換)。
304	モジュールデータ	F	オン	オン	少なくとも 1 つのモジュールの設定データが不正 1. システム情報を確認してください。 2. サービスセンターにお問い合わせください。
305	電力消費	F	オン	オン	総消費電力が高すぎる 1. 設置を確認する。 2. センサ/モジュールを取り外してください。
306	ソフトウェアエラー	F	オン	オン	内部ファームウェアエラー ▶ サービスセンターにお問い合わせください。
366	モジュール接続	F	オン	オン	アクチュエータモジュールと通信していない ▶ 1IF モジュールとの内部接続ケーブルを確認します。
370	内部電圧	F	オン	オン	内部電圧が有効な範囲外 1. 供給電圧を確認します。 2. 入力/出力に短絡がないことを確認してください。
373	電子回路温度高	M	オン	オフ	電子部温度が高温 ▶ 周囲温度およびエネルギー消費を確認してください。
374	センサチェック	F	オン	オフ	センサから測定信号が出力されない 1. センサの接続を確認してください。 2. センサを確認し、必要に応じて交換してください。
401	工場リセット	F	オン	オン	工場出荷時設定にリセットされる
403	機器検証	M	オフ	オフ	機器ベリフィケーション有効、お待ちください
405	サービス IP 起動中	C	オフ	オフ	サービススイッチがオン 機器を 192.168.1.212 にアドレス指定できます。 ▶ サービススイッチをオフにして、保存された IP 設定に変更します。
406	パラメータ起動中	C	オフ	オフ	▶ 設定が完了するまでお待ちください。
407	診断起動中	C	オフ	オフ	▶ メンテナンスが完了するまでお待ちください。
412	バックアップ書込中	F	オン	オフ	▶ 書き込みが完了するまでお待ちください。
413	バックアップ読込中	F	オン	オフ	▶ お待ちください。

番号	メッセージ	初期設定			テストまたは改善策
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
436	SD カード (80%)	M	オン	オフ	SD カード使用量が 80% - SD カードを空のカードに交換してください。 - SD カードのデータを消去してください。 - ログブックのプロパティをリングバッファに設定してください (設定/一般設定/ログブック)。
437	SD カード (100%)	M	オン	オフ	SD カード使用量が 100% これ以上、カードに書き込むことはできません。 - SD カードを空のカードに交換してください。 - SD カードのデータを消去してください。 - ログブックのプロパティをリングバッファに設定してください (設定/一般設定/ログブック)。
438	SD カードが外されました	M	オン	オフ	SD カードが挿入されていない - SD カードを確認してください。 - SD カードを交換してください。 - ログ記録を無効にしてください。
455	演算機能	F	オン	オン	演算機能：エラー状態 - 演算機能を確認します。 - 割り当てられている入力変数を確認します。
460	電流出力過少	S	オン	オフ	原因 - センサが浸漬していない - アセンブリ内部に空洞がある - センサの汚染 - センサに正しく流れていない - センサの設置状況を確認します。 - センサを洗浄してください。 - 電流出力の割当てを変更してください。
461	電流出力上限リミット超過	S	オン	オフ	
502	文字カタログなし	F	オン	オン	▶ サービスセンターにお問い合わせください。
503	言語変更	M	オン	オフ	言語変更の失敗 ▶ サービスセンターにお問い合わせください。
529	診断起動中	C	オフ	オフ	▶ メンテナンスが完了するまでお待ちください。
530	ログブック容量 80%	M	オン	オフ	- 機器内のログブックを SD カードに保存してから、ログブックを削除してください。 - メモリをリングバッファに設定してください。 - ログブックをオフにしてください。
531	ログブック満量	M	オン	オフ	
532	ライセンスエラー	M	オン	オフ	▶ サービスセンターにお問い合わせください。
540	パラメータ保存 失敗	M	オン	オフ	設定保存の失敗 ▶ 再試行してください。
541	パラメータ読み込み OK	M	オン	オフ	正常に設定を読み込み完了
542	パラメータ読み込み失敗	M	オン	オフ	設定読み込みの失敗 ▶ 再試行してください。

番号	メッセージ	初期設定			テストまたは改善策
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
543	パラメータ読み込み中止	M	オン	オフ	設定の読み込み中止
544	パラメータリセット OK	M	オン	オフ	工場設定へのリセット成功
545	パラメータリセット不良	M	オン	オフ	工場初期設定への変更に失敗
906	陽イオン交換器故障	F	オン	オフ	導電率または流量の値が無効 1. 演算機能メニューで有効な測定値を確認します。 2. センサを確認します。 3. 最小流量を確認します。
907	警告：陽イオン交換器	S	オン	オフ	導電率または流量のリミット値を超過 考えられる原因： ■ 樹脂の劣化 ■ 配管の詰まり ▶ アプリケーションを確認します。
908	IEX 機能が低下しています	M	オン	オフ	交換樹脂の能力が間もなく低下する ▶ 樹脂の再生または交換を計画します。
909	IEX 機能消費	F	オン	オフ	交換樹脂の能力が低下 ▶ 樹脂を再生または交換してください。
910	リミットスイッチ	S	オン	オフ	リミットスイッチが作動中
937	制御変数	S	オン	オフ	コントローラ入力警告 コントローラ変数のステータスが OK ではない ▶ アプリケーションを確認します。
938	コントローラセットポイント	S	オン	オフ	コントローラ入力警告 セットポイントのステータスが OK ではない ▶ アプリケーションを確認します。
939	制御障害	S	オン	オフ	コントローラ入力警告 外乱変数のステータスが OK ではない ▶ アプリケーションを確認します。
951 - 958	CH 1 ホールド起動中 ..	C	オン	オフ	チャンネルの出力値およびステータスがホールド。 ▶ ホールドが再び非作動になるまでお待ちください。
961 - 968	診断モジュール 1 (961) ... 診断モジュール 8 (968)	S	オフ	オフ	診断モジュールが有効
969	Modbus 監視	S	オフ	オフ	機器が、指定された時間内にマスタから Modbus テレグラムを受信しなかった。受信した Modbus プロセス値のステータスが無効に設定されている。
970	電流入力超過	S	オン	オン	電流入力過負荷 過負荷によって電流入力が 23 mA からオフに切り替わり、定格負荷が存在すると自動的に再アクティブ化される。
971	電流入力 低	S	オン	オン	電流入力が低すぎる 4 ~ 20 mA で、入力電流が下限エラー電流を下回っている。 ▶ 入力に短絡がないことを確認してください。
972	電流入力 > 20mA	S	オン	オン	電流出力範囲を超過

番号	メッセージ	初期設定			テストまたは改善策
		S ¹⁾	D ²⁾	F ³⁾	
973	電流 < 4mA	S	オン	オン	電流出力範囲未満
974	診断受諾	C	オフ	オフ	測定メニューに表示されたメッセージに対してユーザーが確認応答を実施する。
975	デバイス再起動	C	オフ	オフ	機器リセット
976	PFM/PWM 値が高い	S	オン	オフ	パルス周波数変調：出力信号が超過/下回っている。測定値が特定の範囲外。 ■ センサが浸漬していない ■ アセンブリ内部に空洞がある ■ センサに正しく流れていない ■ センサの汚染 1. センサの洗浄 2. 妥当性を確認してください。 3. PFM 設定を調整してください。
977	PFM/PWM 値が低い	S	オン	オフ	
978	ケモクリーン フェイルセーフ	S	オン	オン	設定された時間内にフィードバック信号が検出されなかった。 1. アプリケーションを確認します。 2. 配線を確認する。 3. 時間を長くしてください。
990	偏差リミット	F	オン	オン	冗長性：パーセント偏差のリミット値を超過
991	二酸化炭素濃度レンジ	F	オン	オン	CO ₂ 濃度（脱気導電率）が測定範囲外
992	pH 計算レンジ	F	オン	オン	pH 計算が測定範囲外
993	rH 計算範囲	F	オン	オン	rH 計算が測定範囲外
994	導電率差	F	オン	オン	デュアル導電率が測定範囲外

- 1) ステータス信号
 2) 診断メッセージ
 3) エラー電流

12.6.2 センサ固有の診断メッセージ

 取扱説明書「Memosens」、BA01245C

12.7 未解決の診断メッセージ

診断メニューには、機器ステータスに関するすべての情報が表示されます。

さらに、各種サービス機能が用意されています。

メニューを開くと必ず以下のメッセージが表示されます。

- **最重要メッセージ**
 最高の危機レベルで記録された診断メッセージ
- **過去のメッセージ**
 その原因がすでに存在しない診断メッセージ

診断メニューのその他すべての機能については、次章の説明を参照してください。

12.8 診断リスト

現在の診断メッセージはすべてここに一覧表示されます。

各メッセージにはタイムスタンプが付加されています。また、**メニュー/設定/一般設定/追加セットアップ/診断設定/診断症状**に保存した設定およびメッセージの説明も表示されます。

12.9 イベントログブック

12.9.1 使用可能なログブック

ログブックのタイプ

- 物理的に使用可能なログブック（総合ログブック以外はすべて）
- 全ログブックのデータベース表示（= 総合ログブック）

ログブック	表示場所	最大入力項目	無効化 ¹⁾	ログブックの削除	入力の削除	エクスポート
総合ログブック	すべてのイベント	20000	あり	いいえ	あり	いいえ
校正ログブック	校正イベント	75	(可)	いいえ	あり	あり
設定ログブック	設定イベント	250	(可)	いいえ	あり	あり
診断ログブック	診断イベント	250	(可)	いいえ	あり	あり
バージョンログブック	すべてのイベント	50	いいえ	いいえ	いいえ	あり
ハードウェアバージョンログブック	すべてのイベント	125	いいえ	いいえ	いいえ	あり
センサ用データログブック（オプション）	データログブック	150 000	あり	あり	あり	あり
デバッグログブック	デバックイベント (特別なアクティベーションコードを入力した場合のみアクセス可能)	1000	あり	いいえ	あり	あり

1) カッコ内の情報は総合ログブックに応じて異なることを意味します。

12.9.2 ログブック メニュー


DIAG/ログブック		
機能	オプション	情報
▶ すべてのイベント		すべてのログブック入力の時系列リスト（イベントタイプの情報を含む）。
▶ リスト表示	イベントの表示	特定のイベントを選択すると、詳細情報が表示されます。
▶ 日付へ	ユーザー入力 ■ 日付へ ■ 時間	この機能を使用すると、直接リスト内の特定の時刻に移動できます。これにより、すべての情報をスクロールする必要がなくなります。ただし、全体リストは常に表示されます。
▶ 校正イベント		校正イベントの時系列リスト
▶ リスト表示	イベントの表示	特定のイベントを選択すると、詳細情報が表示されます。
▶ 日付へ	ユーザー入力 ■ 日付へ ■ 時間	この機能を使用すると、直接リスト内の特定の時刻に移動できます。これにより、すべての情報をスクロールする必要がなくなります。ただし、全体リストは常に表示されます。
▷ 全ての登録を削除	アクション	ここで、校正ログブックのすべての入力を削除できます。

DIAG/ログブック		
機能	オプション	情報
▶ 設定イベント		設定イベントの時系列リスト
▶ リスト表示	イベントの表示	特定のイベントを選択すると、詳細情報が表示されます。
▶ 日付へ	ユーザー入力 ■ 日付へ ■ 時間	この機能を使用すると、直接リスト内の特定の時刻に移動できます。これにより、すべての情報をスクロールする必要がなくなります。ただし、全体リストは常に表示されます。
▷ 全ての登録を削除	アクション	これを使用して、操作ログブックのすべての入力を削除できます。
▶ 診断イベント		診断イベントの時系列リスト
▶ リスト表示	イベントの表示	特定のイベントを選択すると、詳細情報が表示されます。
▶ 日付へ	ユーザー入力 ■ 日付へ ■ 時間	この機能を使用すると、直接リスト内の特定の時刻に移動できます。これにより、すべての情報をスクロールする必要がなくなります。ただし、全体リストは常に表示されます。
▷ 全ての登録を削除	アクション	これを使用して、診断ログブックのすべての入力を削除できます。

データログブックに記録されているデータをディスプレイにグラフ形式で表示できます（**プロット表示**）。

個々の要件に応じて表示を調整することが可能です。

- グラフ表示中にナビゲータボタンを押す：ズーム機能やグラフの x/y 移動などの追加オプションを使用できます。
- カーソルの設定：このオプションを選択すると、ナビゲータでグラフを移動したり、グラフの各点からテキストのログブック入力（データスタンプ/測定値）を表示したりできます。
- 2つのログブックの同時表示：**2番目のプロット選択**および**プロット表示**
 - 小さい×マークは現在選択されているグラフを示し、ズームの変更、カーソルの使用などが可能です。
 - コンテキストメニュー（ナビゲータボタンを押す）で、他方のグラフを選択できます。これにより、今度はそちらのグラフでズーム機能や移動、カーソルを使用できるようになります。
 - コンテキストメニューを使用して、両方のグラフを同時に選択することもできます。この場合、両方のグラフでズーム機能などを同時に使用できます。

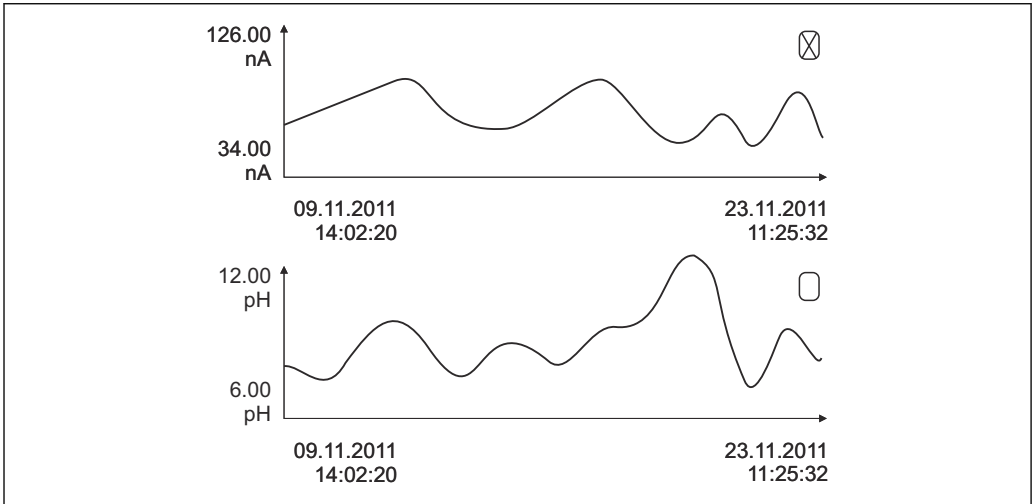

A0016688

図 63 2つのグラフの同時表示、ここでは上のグラフを「選択」

DIAG/ログブック		
機能	オプション	情報
▶ データログブック		センサ用データログブック入力の時系列リスト
データログブック 1 ... 8 <ログブック名>		このサブメニューは、設定およびアクティブ化したデータログブックごとに用意されています。
データソース	読み取り専用	入力または演算機能が表示されます。
測定値	読み取り専用	記録中の測定値が表示されます。
ログブック残時間	読み取り専用	ログブックが満杯になるまでの日数、時間および分を表示します。 ▶ メモリタイプの選択に関する情報に注意してください: 一般設定/ログブック メニュー
▶ リスト表示	イベントの表示	特定のイベントを選択すると、詳細情報が表示されます。
▶ 日付へ	ユーザー入力 ■ 日付へ ■ 時間	この機能を使用すると、直接リスト内の特定の時刻に移動できます。これにより、すべての情報をスクロールする必要がなくなります。ただし、全体リストは常に表示されます。
▶ プロット表示	ログブック入力のグラフ表示	入力は、次の設定に応じて表示されます: 一般設定/ログブック
2 番目のプロット選択	別のデータログブックの選択	現在のログブックと同時に 2 番目のログブックを表示できます。
▷ 全ての登録を削除	アクション	これを使用して、データログブックのすべての入力を削除できます。
▶ ログブック保存		
ファイルフォーマット	選択 ■ CSV ■ FDM	▶ 指定したファイル形式でログブックを保存します。 保存した CSV ファイルはエクセルなどで開き、パソコンでさらに編集することができます。 1) FDM ファイルを FieldCare にインポートすると、改ざん防止をしてアーカイブ保存することが可能です。
▷ 全てのデータログブック ▷ データログブック 1 ... 8 ▷ 全てのイベントログブック ▷ 校正ログブック ▷ 診断ログブック ▷ 設定ログブック ▷ ハードウェアバージョンログブック ▷ ログブックバージョン	アクション、オプションを選択すると直ちにこの動作が開始します。	この機能を使用して、ログブックを SD カードに保存します。 ▶ 指定したファイル形式でログブックを保存します。保存した CSV ファイルはエクセルなどで開き、パソコンでさらに編集することができます。FDM ファイルを Fieldcare にインポートすると、改ざん防止をしてアーカイブ保存することが可能です。
 ファイル名は、 ログブック識別 (メニュー/設定/一般設定/ログブック) 、ログブックの略語、およびタイムスタンプで構成されます。		

- 1) CSV ファイルでは、国際的な数の形式およびセパレーター文字が使用されます。そのため、適切なフォーマット設定の外部データとしてエクセルにインポートする必要があります。エクセルの国設定を米国にしてインストールした場合に限り、ファイルをダブルクリックで開いたときにデータが正しく表示されます。

12.10 シミュレーション

テスト目的として、以下のような入出力値をシミュレーションできます。

- 電流出力の電流値
- 入力 of 測定値
- リレー接点の開閉

 現在の値のみがシミュレーションされます。シミュレーション機能を介して、流量または降水の積算値を計算することはできません。

DIAG/シミュレーション		
機能	オプション	情報
▶ 電流出力 x:y		電流出力のシミュレーション このメニューは電流出力ごとに表示されます。
シミュレーション	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	電流出力の値をシミュレーションすると、ディスプレイのメイン画面の電流値の前にシミュレーションアイコンが表示されます。
電流	2.4~23.0 mA 初期設定 4 mA	▶ 必要なシミュレーション値を設定します。
▶ アラームリレー ▶ Relay x:y		リレー状態のシミュレーション このメニューはリレーごとに表示されます。
シミュレーション	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	リレー状態をシミュレーションすると、ディスプレイのメイン画面のリレー表示部の前にシミュレーションアイコンが表示されます。
状況	選択 ■ 低 ■ 高 初期設定 低	▶ 必要なシミュレーション値を設定します。 シミュレーションをオンにすると、リレーはその設定に応じて切り替わります。測定値ディスプレイに、シミュレーションするリレー状態が オン (=低) または オフ (=高) と表示されます。
▶ 測定入力		測定値のシミュレーション (センサの場合のみ) このメニューは測定入力ごとに表示されます。
チャンネル: パラメータ		
シミュレーション	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	測定値をシミュレーションすると、ディスプレイのメイン画面の測定値の前にシミュレーションアイコンが表示されます。
主測定値	センサに依存	▶ 必要なシミュレーション値を設定します。
シミュレーション 温度	選択 ■ オフ ■ オン 初期設定 オフ	温度測定値をシミュレーションすると、ディスプレイのメイン画面の温度の前にシミュレーションアイコンが表示されます。
温度	-50.0~+250.0 °C (-58.0~482.0 °F) 初期設定 20.0 °C (68.0 °F)	▶ 必要なシミュレーション値を設定します。

12.11 機器テスト

DIAG/システムテスト		
機能	オプション	情報
▶ 電源	読み取り専用 ■ デジタル電源 1 : 1.2V ■ デジタル電源 2 : 3.3V ■ アナログ電源 : 12.5V ■ センサ電源 : 24V ■ 温度	機器電源の詳細リスト  故障が発生していても、実際値がこれと異なる場合があります。
▶ Heartbeat		Heartbeat は出力とそのステータスに影響を与えません。測定に影響を与えることなく、いつでも検証を開始できます。
▶ ベリフィケーション実行		検証を開始します。 1. 結果を保存するには、OK を押します。 ↳ 結果が表示されます（下記を参照） 2. 機器のカードリーダーに書込可能な SD カードを挿入してください。 SD カードへ転送します。 ↳ 結果が PFD ファイル形式で SD カードに書き込まれます。書込みが正常に完了したかどうかが表示レイに表示されます。 3. エクスポートが失敗した場合 : SD カードを確認し、必要に応じて別の SD カードを使用します。ベースモジュールの SD 部分を確認します。
▷ 検証結果		結果の表示 ■ Plant Operator カスタマイズテキスト、最大 32 文字 ■ 位置 カスタマイズテキスト、最大 32 文字 ■ 検証レポート 自動タイムスタンプ ■ 検証 ID 自動カウンタ ■ 全ての結果 合格または不合格
▷ SD カードへ転送		検証レポートを PDF ファイルとしてエクスポートします。 ■ 各種機器テストの詳細なレポート ■ 入力および出力情報 ■ 機器情報 ■ センサ情報 印刷および署名するためのレポートの準備が完了します。たとえば、これを直ちに操作ログに記録することが可能です。

12.12 機器のリセット

DIAG/リセット		
機能	オプション	情報
▷ デバイス再起動	選択 ■ OK ■ ESC	すべての設定を変更せずに再始動します。
▷ 工場デフォルト設定	選択 ■ OK ■ ESC	工場出荷設定で再始動します。保存していない設定は失われます。

12.13 機器情報

12.13.1 システム情報

DIAG/システム情報		
機能	オプション	情報
デバイスタグ	読み取り専用	個別のデバイスタグ → 一般設定
オーダーコード	読み取り専用	このコードで同じハードウェアを注文することが可能です。 このコードはハードウェア変更に伴って変更されます。製造者から入手した新しいコードをここに入力します ¹⁾ 。
 機器バージョンを確認するには、次のアドレスの検索画面にオーダーコードを入力してください： www.endress.com/order-ident		
出荷時の延長オーダーコード	読み取り専用	製品のハードウェア構成に従った、出荷時の機器の完全なオーダーコード。
現在の拡張オーダーコード	読み取り専用	ハードウェア変更を反映した現在のコード。このコードはお客様自身で入力する必要があります。
シリアル番号	読み取り専用	シリアル番号を使用して、インターネット上で機器データや関連資料にアクセスできます： www.endress.com/device-viewer
ソフトウェア バージョン	読み取り専用	現在のバージョン
► HART HART オプションを使用する場合のみ	読み取り専用 ■ バスアドレス ■ ユニークアドレス ■ 製造者 I D ■ デバイスタイプ ■ デバイスリビジョン ■ ソフトウェア リビジョン	HART 固有の情報 一意のアドレスはシリアル番号にリンクしており、Multidrop 環境で機器にアクセスするために使用されます。 機器およびソフトウェアのバージョン番号は、変更が行われると直ちに増分されます。
► Modbus Modbus オプションを使用する場合のみ	読み取り専用 ■ 可能 ■ バスアドレス ■ 終端 ■ Modbus TCP ポート 502	Modbus 固有の情報
► PROFIBUS PROFIBUS オプションを使用する場合のみ	読み取り専用 ■ 終端 ■ バスアドレス ■ 識別番号 ■ ボーレート ■ DPV0 state ■ DPV0 fault ■ DPV0 master addr ■ DPV0 WDT [ms]	モジュールステータスおよび他の PROFIBUS 固有の情報

DIAG/システム情報		
機能	オプション	情報
▶ イーサネット Ethernet、EtherNet/IP、Modbus TCP、Modbus RS485、PROFIBUS DP、またはPROFINET オプションを使用する場合のみ	読み取り専用 ■ 可能 ■ ウェブサーバ ■ リンク設定 ■ DHCP ■ IP アドレス ■ ネットマスク ■ ゲートウェイ ■ サービススイッチ ■ MAC アドレス ■ イーサネット IP ポート 44818 ■ Modbus TCP ポート 502 ■ ウェブサーバ TCP ポート 80	イーサネット固有の情報 表示は使用するフィールドバスプロトコルに応じて異なります。
▶ PROFINET PROFINET オプションを使用する場合のみ		
ステーション名	読み取り専用	
▶ SD カード	読み取り専用 ■ トータル ■ 空きメモリ	
▶ システムモジュール		
バックプレーン	読み取り専用 ■ 説明 ■ シリアル番号 ■ オーダーコード ■ ハードウェアバージョン ■ ソフトウェアバージョン	使用可能な電子モジュールごとにこの情報が表示されます。サービス作業を実施する場合などは、シリアル番号とオーダーコードを指定してください。
ベース		
表示モジュール		
拡張モジュール 1 ... 8		
▶ センサ	読み取り専用 ■ 説明 ■ シリアル番号 ■ オーダーコード ■ ハードウェアバージョン ■ ソフトウェアバージョン	使用可能なセンサごとにこの情報が表示されます。サービス作業を実施する場合などは、シリアル番号とオーダーコードを指定してください。
▶ システム情報保存		
▷ SD カードへ保存	ファイル名は自動指定 (タイムスタンプ付き)	この情報は、SD カードの「sysinfo」サブフォルダに保存されます。CSV ファイルはエクセルなどに読み込み、編集することができます。サービス作業を実施する場合に、このファイルを使用できます。

DIAG/システム情報		
機能	オプション	情報
▶ Heartbeat operation		Heartbeat 機能は、適切な機器バージョンまたはオプションのアクセスコードによってのみ使用可能となります。
▶ デバイス	読み取り専用 ■ Total operating time ■ Counters since reset ■ Availability ■ Operating time ■ Time in failure ■ Number of failures ■ MTBF ■ MTTR ■ ▷ Reset counters	Availability ステータス信号 F のエラーが発生していない時間の割合 (Operating time - Time in failure)*100% /Operating time Time in failure ステータス信号 F のエラーが発生していない時間の合計 MTBF 平均故障間隔 (Operating time - Time in failure)/Number of failures MTTR 平均修理時間 Time in failure/Number of failures

1) ハードウェア変更に関するすべての情報がユーザーから製造業者に提供されていることが前提です。

12.13.2 センサ情報

▶ チャンネルリストから必要なチャンネルを選択してください。

次のカテゴリの情報が表示されます。

- **極端な値**
最高/最低温度など、過去にセンサがさらされた過酷な条件³⁾
- **稼働時間**
規定された条件下でのセンサの稼働時間
- **校正情報**
前回の校正の校正データ
- **センサ仕様**
主測定値および温度の測定範囲限界
- **一般情報**
センサ識別情報

表示される詳細データは、接続されているセンサに応じて異なります。

3) すべてのセンサタイプで使用できるわけではありません。

12.14 ファームウェアの履歴

日付	バージョン	ファームウェア変更	関連資料
2019年12月	01.07.00	拡張 ■ 新しい BASE2 モジュールのサポート ■ PROFINET ■ 新しいセンサ Memosens Wave CAS80E ■ 時間を基にした条件に応じたバイナリプロセス値のタイムスイッチ 改善点 ■ 式演算機能の最大文字長を 255 文字に拡張 ■ Heartbeat 機器ステータスをフィールドバス経由でも取得 ■ Heartbeat 検証:「有効でない」ステータスの再定義 ■ pH センサの 1 点校正を CM42 のプロセスおよびログブックに適合 ■ Δ 時間のフォーマットを秒まで拡張	BA01225C/07/EN/13.19 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/08.20
2019年1月	01.06.08	改善点 ■ Heartbeat 検証は出力に影響を与えません ■ 統合された Web サーバーでの Heartbeat ステータスのグラフィック表示 ■ リミット値により隔膜式溶存酸素センサの電解液の減少を監視 ■ リミット値により 4 電極式導電率センサの CIP サイクルを監視	BA01225C/07/EN/11.19 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/06.19
2018年5月	01.06.06	改善点 ■ マルチ選択エディタに新しいソフトキー ALL および NONE を搭載 ■ CAS51D 硝酸の手動ファクタ ■ pH、導電率、酸素、殺菌用の修正された校正タイマーと校正有効性 ■ pH 用のオフセットと 1 点校正の明確な区別 ■ Heartbeat 検証レポートの Web サーバーからのダウンロードも可能 ■ 診断コード 013 の説明を変更	BA01225C/07/EN/10.18 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/05.17
2017年6月	01.06.04	拡張 ■ Heartbeat モニタリングおよび検証 ■ 新しい演算機能 Formula ■ 新しいセンサ: CUS50D および二酸化塩素 ■ EtherNet/IP を介した校正 ■ Heartbeat 用の PDF ジェネレータ ■ サンプル校正 CAS51D 改善点 ■ 導電率濃度テーブルの変更 ■ 塩素パラメータ名の変更 → 消毒 ■ 最後にアクティブだった測定画面を再起動後に復元 ■ キャップおよび電解液の交換を校正ログブックに記録 (酸素、殺菌) ■ 硝酸の手動ファクタ	BA01225C/07/EN/05.17 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/05.17
2016年12月	01.06.03	拡張 ■ Modbus または EtherNet/IP 経由のセンサ校正: 導電率、溶存酸素、塩素、濁度 ■ 4 ファクタ調整、SAC ■ フラッシュメーター、硝酸および SAC ■ 新しい汚泥モデル CUS51D 改善点 ■ 現場表示器は Modbus または EtherNet/IP を介してロック可能 ■ 出力状態もデータログブックに記録することが可能 ■ Endress+Hauser pH 標準液の名称を 9.18 から 9.22 に変更 ■ フィードバックを介して CUS51D ファクタの読み取りが可能	BA01225C/07/EN/04.16 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/04.16

日付	バージョン	ファームウェア変更	関連資料
2016年3月	01.06.00	拡張 ■ Heartbeat 検証 ■ ユーザー設定が可能な診断モジュール ■ 4 ファクタ調整、SAC ■ オフセット校正 CUS71D ■ 新しい演算機能、陽イオン交換器 ■ Modbus 用の設定可能なバイト順 改善点 ■ センサ校正有効性チェック（パッチプロセスに適用） ■ pH オフセットをセンサまたは変換器に保存可能（以前は変換器にのみ可能） ■ CUS71D 画面（ゲイン表示、トレンド情報） ■ メニューテキストの変更	BA01225C/07/EN/04.16 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/03.16
2015年3月	01.05.02	拡張 ■ 導電率： ■ 新しいセンサ：CLS82D ■ 測定メニューで濃度を常に表示 ■ 濃度テーブルの拡張 ■ 溶存酸素： ■ 新しいセンサ：COS81D ■ SAC、硝酸、濁度： ■ 校正設定の調整 ■ 調整可能なフラッシュレート（エキスパート機能） 改善点 ■ メニュー修正（機能、名称）	BA01225C/07/EN/03.15 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/02.15
2013年12月	01.05.00	拡張 ■ Chemoclean Plus ■ 洗浄用のカレンダー機能 ■ 導電率： ■ 電極式導電率測定にも対応可能な計測レンジスイッチ ■ 電流入力を介した外部温度信号 ■ 溶存酸素： ■ 電流入力を介した外部圧力信号または温度信号 ■ 接続された導電率センサを塩分計算に使用可能 ■ SAC、硝酸、濁度： ■ フィールドバスを介して校正設定が可能 ■ ホールド機能用のチャンネル固有の診断コード ■ EtherNet/IP 対応 改善点 ■ 複数のユーザーを管理するための Web サーバー ログイン ■ フィールドバスを介してコントローラ用のセットポイントおよび PID パラメータの設定が可能	BA01225C/07/EN/02.13 BA00486C/07/EN/02.13 BA01245C/07/EN/01.13
2013年7月	01.04.00	オリジナルファームウェア	BA01225C/07/EN/01.13 BA01227C/07/EN/01.13 BA00450C/07/EN/17.13 BA00451C/07/EN/16.13 BA00486C/07/EN/02.13

LZ4 Library

Copyright (c) 2011-2016, Yann Collet

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

13 メンテナンス

プロセスおよびプロセス制御への影響

- ▶ 適切なタイミングで、あらゆる必要な措置を講じることにより、測定点全体の操作の安全性と信頼性を確保してください。

測定点のメンテナンスには以下の作業が含まれます。

- 校正
- コントローラ、ホルダ、センサの洗浄
- ケーブルおよび接続部の点検

⚠ 警告

プロセス圧力、温度、汚染、電圧

重傷または死亡事故につながる恐れがあります。

- ▶ メンテナンス作業中にセンサを取り外す必要がある場合は、圧力、温度、汚染に起因する危険を防止してください。
- ▶ 機器を開ける前に電源を切ってください。
- ▶ 別の回路からスイッチ接点に電源が供給されている可能性があります。端子で作業を始める前に、この回路の電源を切ってください。

📌 注記

静電放電 (ESD)

電子部品が損傷する恐れがあります。

- ▶ ESDを防止するため、事前に PE で放電するか、またはリストストラップを装着して常時接地するなどの個人保護対策を講じてください。
- ▶ ご自身の安全のため、純正スペアパーツ以外は使用しないでください。純正パーツを使用した場合は、メンテナンス作業後も、機能、精度、信頼性が保証されます。

13.1 洗浄

13.1.1 外部ディスプレイ（設置された状態）

- ▶ハウジングのフロント部分の清掃には、市販されている洗浄剤のみを使用してください。

ハウジングのフロント部分は DIN 42 115 に準拠して、以下に対する耐性があります。

- エタノール（短時間）
- 希釈酸（最大 2% HCl）
- 希塩基（最大 3% NaOH）
- 石けん系の家庭用洗剤

📌 注記

使用できない洗浄剤

ハウジング表面またはハウジングシールの損傷

- ▶ 濃縮された鉱酸または塩基は、絶対に清掃のために使用しないでください。
- ▶ 絶対にアセトン、ベンジルアルコール、メタノール、塩化メチレン、キシレン、または濃縮グリセリン洗浄剤などの有機洗浄剤を使用しないでください。
- ▶ 絶対に高压スチームを使用して洗浄しないでください。

13.1.2 デジタルセンサ

▲ 注意

洗浄システムは校正中またはメンテナンス中にオフにならない

測定物または洗浄剤による負傷の危険があります。

- ▶ 洗浄システムが接続されている場合は、洗浄システムをオフにした後でセンサを媒体から取り外してください。
- ▶ 洗浄機能をテストするために洗浄システムをオフにしない場合は、保護服、保護ゴーグル、および保護手袋を着用するか、その他の適切な措置を講じてください。

測定点の可用性を確保しながらセンサを交換

エラーが発生した場合、あるいは保守計画に基づきセンサの交換が必要な場合は、新しいセンサ、またはラボで事前校正されたセンサを使用してください。

- 最適な外部条件下のラボでセンサを校正することにより、測定品質の向上が保証されます。
- 事前に校正していないセンサを使用する場合は、現場で校正を実施する必要があります。

1. メンテナンスの必要なセンサを取り外します。
2. 新しいセンサを取り付けます。
 - ↳ センサデータは自動的に変換器に転送されます。リリースコードは必要ありません。
 - 測定が再開します。
3. 使用済みのセンサをラボに返却します。
 - ↳ ラボでは、測定点の可用性を確保し、センサを再利用可能な状態に準備することが可能です。

センサを再利用するための準備


1. センサを洗浄してください。
 - ↳ その場合は、センサ取扱説明書に指定されている洗浄剤を使用してください。
2. ひびやその他の損傷がないかセンサを点検します。
3. 損傷が認められない場合は、センサを再生成します。必要に応じて、センサを再生成溶液に浸漬させます（センサ取扱説明書を参照）。
4. センサを再利用するために、再校正を実施してください。

13.1.3 ホルダ

ホルダの保守およびトラブルシューティングについては、ホルダ取扱説明書を参照してください。ホルダ取扱説明書には、ホルダの取付けおよび取外し、センサおよびシールの交換、材質の耐性、スペアパーツやアクセサリに関する情報が記載されています。

14 修理

14.1 スペアパーツ

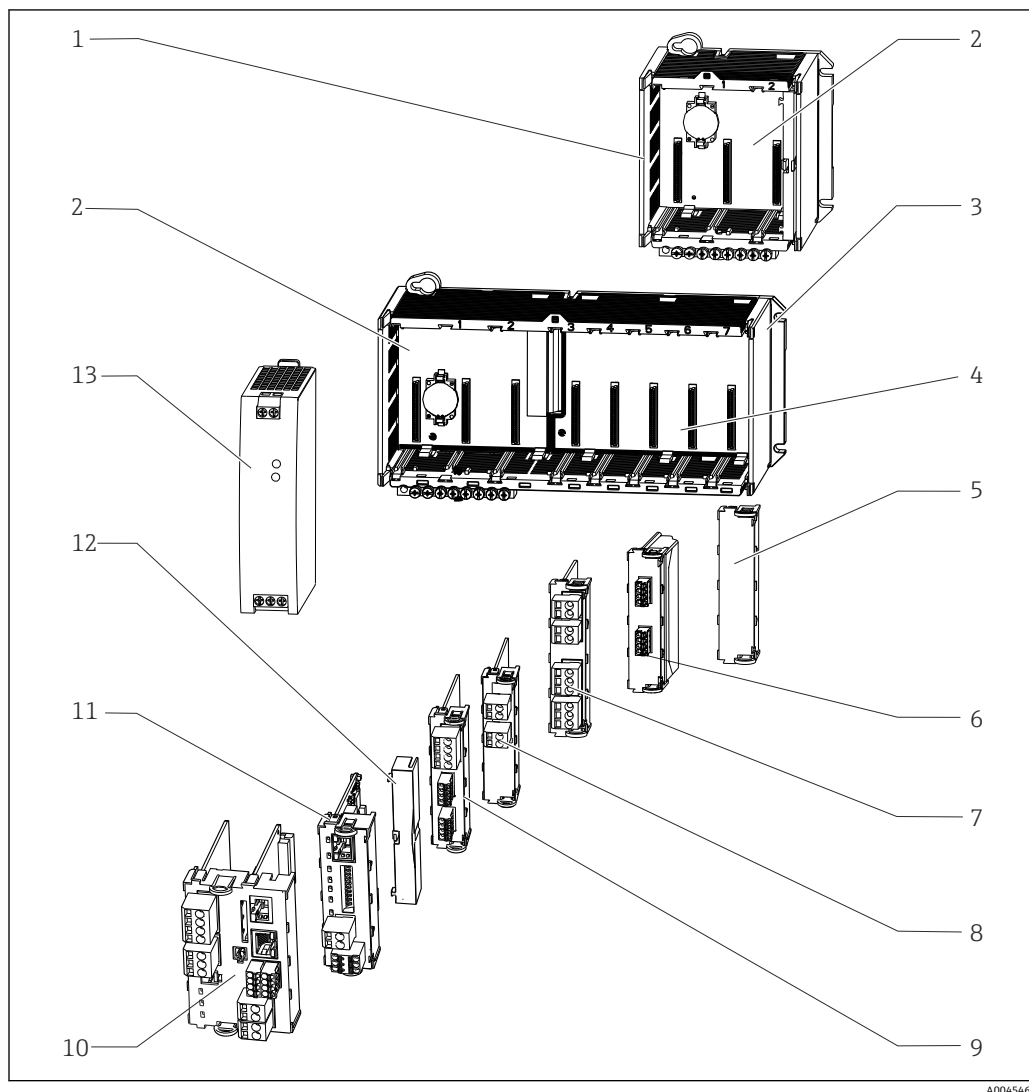

A0045465

図 64 スペアパーツ：スペアパーツの名称およびそのオーダー番号は次の表に記載されています。

注記

不注意なメンテナンスまたは修理作業によるケーブルの損傷

- ▶ 不具合のあるケーブルを交換する場合、特にケーブルダクトから引き抜く場合は注意してください。
- ▶ 可能であれば、中継端子箱を使用してください。これは、キャビネット内の固定接続として機能します。



2DS Ex-i 通信モジュールを搭載した変換器の場合、モジュールの交換は、製造者が許可した担当者のみが行うことができます。

項目	キット	オーダー番号
1	キット CM442R 制御キャビネット設置ハウジング、一式	71222273
2	キット CM44x/CM44xR：電子モジュールバックプレーン ■ バックプレーン一式 ■ Endress+Hauser のサービス員のみが交換作業を実施できます	71101457
3	キット CM444R、CM448R 制御キャビネット設置ハウジング、一式	71222276
4	キット CM44x/CM44xR：電子モジュール拡張バックプレーン ■ 拡張バックプレーン一式 ■ Endress+Hauser のサービス員のみが交換作業を実施できます	71141366
5, 12	キット CM44R 衝撃保護カバーのセット	71222282
6	キット CM44xR：センサ通信モジュール 2DS Ex-i Endress+Hauser のサービス員のみが交換作業を実施できます	71477718
7, 8, 9, 11	キット CM44x/ CM44xR：拡張モジュール AOR (2×リレー+2×電流出力) ■ 拡張モジュール AOR、一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71111053
	キット CM44x/CM44xR：端子セット、拡張モジュール AOR	71107453
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 2R (2×リレー) ■ 拡張モジュール 2R 一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71125375
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 4R (4×リレー) ■ 拡張モジュール 4R 一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71125376
	キット CM44x/CM44xR：端子セット、拡張モジュール 2R、4R	71155581
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 2AO (2 x 0/4~20 mA) ■ 拡張モジュール 2AO 一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71135632
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 4AO (4 x 0/4~20 mA) ■ 拡張モジュール 4AO 一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71135633
	キット CM44x/CM44xR：端子セット、拡張モジュール 2AO、4AO	71155582
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール DIO (各 2 x デジタル入力/ デジタル出力) ■ 拡張モジュール DIO、一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71135638
	キット CM44x/CM44xR：端子セット、拡張モジュール DIO	71219784
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 2DS (2 x デジタルセンサ) ■ 拡張モジュール 2DS 一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71135631
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 2AI (2 x アナログ入力 0/4~20 mA) ■ 拡張モジュール 2AI 一式 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71135639
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 485 ■ 拡張モジュール 485 一式 ■ アクティベーションコードを使用して PROFIBUS DP または Modbus RS 485 に拡張可能 ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71135634
	キット CM44x/CM44xR：拡張モジュール 2AI の端子セット、485	71155583
10	キット CM44xR：ベースモジュール BASE2-E ■ ベースモジュール、一式 ■ エンドカバー ■ 電源ユニット接続用の接続ケーブル ■ スペアパーツキット CM44x の説明書	71431302
	キット CM44x：端子セット、ベースモジュール	71107452

項目	キット	オーダー番号
13	キット CM444R/8R : DIN レール電源ユニット ■ DIN レール電源ユニット AC 110~230 V ■ DIN レール電源ユニット DC 24 V	71222277 71222279
図なし	銘板の交換 ■ オリジナル版を再印刷、または ■ 改造またはアップグレード版を新たに印刷	XPC0009

14.2 返却

機器の修理または工場校正が必要な場合、あるいは、誤った機器が注文または納入された場合は、本機器を返却する必要があります。Endress+Hauser は ISO 認定企業として法規制に基づき、測定物と接触した返却製品に対して所定の手順を実行する義務を負います。

迅速、安全、適切な機器返却を保証するため：

- ▶ 機器返却の手順および条件については、弊社ウェブサイト www.endress.com/support/return-material をご覧ください。

14.3 廃棄

機器には電子部品が含まれます。製品は電子部品廃棄物として処分する必要があります。

- ▶ 廃棄にあたっては地域の法規・法令に従ってください。

 バッテリーは必ずバッテリー廃棄に関する各地域の法規に従って処分してください。

15 アクセサリ

以下には、本書の発行時点で入手可能な主要なアクセサリが記載されています。

- ▶ ここに記載されていないアクセサリについては、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

15.1 測定用ケーブル

Memosens データケーブル CYK10

- Memosens テクノロジ搭載のデジタルセンサ用
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cyk10

 技術仕様書 TI00118C

Memosens データケーブル CYK11

- Memosens プロトコル搭載デジタルセンサ用の延長ケーブル
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cyk11

 技術仕様書 TI00118C

15.2 センサ

15.2.1 ガラス電極 :

Orbisint CPS11D

- プロセスモニタおよび制御用 pH センサ
- オプション : SIL 変換器接続用の SIL バージョン
- 汚れが付着しにくい PTFE 液絡膜
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps11d

 技術仕様書 TI00028C

Memosens CPS31D

- セラミック液絡膜を使用したリファレンスシステム搭載のゲル充填型 pH 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps31d

 技術仕様書 TI00030C

Ceraliquid CPS41D

- セラミックジャンクションを使用した KCl 電解液補給型 pH 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps41d

 技術仕様書 TI00079C

Ceragel CPS71D

- イオントラップ付きリファレンスシステム搭載の pH 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps71d

 技術仕様書 TI00245C

Memosens CPS171D

- Memosens デジタル技術を搭載したバイオフィーマメント対応 pH 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps171d

 技術仕様書 TI01254C

Orbipore CPS91D

- 汚れ負荷が大きい測定物用のオープンダイアフラム付き pH 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps91d



技術仕様書 TI00375C

Orbipac CPF81D

- 設置または浸漬操作のコンパクトな pH センサ
- 工業用水および廃水処理向け
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpf81d



技術仕様書 TI00191C

15.2.2 エナメル pH 電極

Ceramax CPS341D

- pH 高感度エナメル付き pH 電極
- 測定精度、圧力、温度、無菌性、耐久性に関する極めて高い要求に対応
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps341d



技術仕様書 TI00468C

15.2.3 ORP センサ

Orbisint CPS12D

- プロセスモニタおよび制御用 ORP センサ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps12d



技術仕様書 TI00367C

Ceraliquid CPS42D

- セラミックジャンクションを使用した KCl 電解液補給型 ORP 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps42d



技術仕様書 TI00373C

Ceragel CPS72D

- イオントラップ付きリファレンスシステム搭載の ORP 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps72d



技術仕様書 TI00374C

Orbipac CPF82D

- プロセス水または排水内の設置または浸漬操作のコンパクトな ORP センサ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cpf82d



技術仕様書 TI00191C

Orbipore CPS92D

- 汚れ負荷が大きい測定物用のオープンダイアフラム付き ORP 電極
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps92d



技術仕様書 TI00435C

15.2.4 pH ISFET センサ

Tophit CPS441D

- 導電率の低い測定物用の滅菌可能な ISFET センサ
- KCl 電解液補給型
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps441d

 技術仕様書 TI00352C

Tophit CPS471D

- 食品、製菓、プロセスエンジニアリング向けの滅菌およびオートクレーブ対応 ISFET センサ
- 水処理およびバイオテクノロジー
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps471d

 技術仕様書 TI00283C

Tophit CPS491D

- 汚れ負荷が大きい測定物用のオープンダイアフラム付き ISFET センサ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps491d

 技術仕様書 TI00377C

15.2.5 pH および ORP 複合センサ

Memosens CPS16D

- プロセスモニタおよび制御用 pH/ORP 複合センサ
- 汚れが付着しにくい PTFE 液絡膜
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps16D

 技術仕様書 TI00503C

Memosens CPS76D

- プロセスモニタおよび制御用 pH/ORP 複合センサ
- サニタリおよび滅菌アプリケーション
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps76d

 技術仕様書 TI00506C

Memosens CPS96D

- 化学プロセスに対応する pH/ORP 複合センサ
- イオントラップ付き耐汚染リファレンス
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cps96d

 技術仕様書 TI00507C

15.2.6 電磁式導電率センサ

Indumax CLS50D

- 耐久性の高い電磁式導電率センサ
- 標準および危険場所アプリケーションに対応
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cls50d

 技術仕様書 TI00182C

Indumax H CLS54D

- 電磁式導電率センサ
- 食品/飲料/医薬/バイオテクノロジー用のサニタリ仕様、認定取得済み
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cls54d

 技術仕様書 TI00508C

15.2.7 電極式導電率センサ**Condumax CLS15D**

- 電極式導電率センサ
- 純水、超純水、危険場所アプリケーション用
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/CLS15d

 技術仕様書 TI00109C

Condumax CLS16D

- サニタリ仕様、電極式導電率センサ
- 純水、超純水、防爆アプリケーション用
- EHEDG および 3A 認証
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/CLS16d

 技術仕様書 TI00227C

Condumax CLS21D

- 2 電極センサ、プラグインヘッドバージョンバージョン
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/CLS21d

 技術仕様書 TI00085C

Memosens CLS82D

- 4 電極式センサ
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cls82d

 技術仕様書 TI01188C

15.2.8 溶存酸素センサ**Oxymax COS22D**

- 滅菌可能な溶存酸素用センサ
- Memosens テクノロジー搭載、またはアナログセンサ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cos22d

 技術仕様書 TI00446C

Oxymax COS51D

- 隔膜式溶存酸素センサ
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cos51d

 技術仕様書 TI00413C

Oxymax COS61D

- 飲料水および工業用水測定のための光学式溶存酸素センサ
- 測定原理：光学（蛍光）式
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cos61d

 技術仕様書 TI00387C

Memosens COS81D

- 滅菌可能な光学式溶存酸素センサ
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cos81d

 技術仕様書 TI01201C

15.2.9 殺菌センサ**CCS142D**

- 遊離残留塩素用の隔膜式センサ
- 測定範囲 0.01~20 mg/l
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/ccs142d

 技術仕様書 TI00419C

15.2.10 イオン選択性センサ**ISE マックス CAS40D**

- イオン選択性センサ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cas40d

 技術仕様書 TI00491C

15.2.11 濁度センサ**Turbimax CUS51D**

- 廃水中の濁度および固形物の比濁度分析測定用
- 4 ビーム散乱光方式
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cus51d

 技術仕様書 TI00461C

Turbimax CUS52D

- 飲用水、プロセス水、ユーティリティの濁度測定用 Memosens センサ、サニタリ仕様
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cus52d

 技術仕様書 TI01136C

15.2.12 SAC および硝酸センサ**Viomax CAS51D**

- 飲料水および廃水中の SAC および硝酸測定
- Memosens テクノロジー搭載
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cas51d

 技術仕様書 TI00459C

15.2.13 界面測定

Turbimax CUS71D

- 界面測定用の浸漬型センサ
- 超音波式界面センサ
- 製品ページの製品コンフィグレータ : www.endress.com/cus71d

 技術仕様書 TI00490C

15.3 追加機能

15.3.1 ハードウェア拡張モジュール

キット、拡張モジュール AOR

- 2 x リレー、2 x 0/4~20 mA アナログ出力
- オーダー番号 71111053

キット、拡張モジュール 2R

- 2 x リレー
- オーダー番号 71125375

キット、拡張モジュール 4R

- 4 x リレー
- オーダー番号 71125376

キット、拡張モジュール 2AO

- 2 x 0/4~20 mA アナログ出力
- オーダー番号 71135632

キット、拡張モジュール 4AO

- 4 x アナログ出力 0/4~20 mA
- オーダー番号 71135633

キット、拡張モジュール 2DS

- 2 x デジタルセンサ、Memosens
- オーダー番号 71135631

キット、拡張モジュール 2AI

- 2 x 0/4~20 mA アナログ入力
- オーダー番号 71135639

キット、拡張モジュール DIO

- 2 x デジタル入力
- 2 x デジタル出力
- デジタル出力用の補助電源
- オーダー番号 71135638

キット、拡張モジュール 485

- PROFIBUS DP または Modbus RS485 に拡張可能アクティベーションコードを別途注文していただく必要があります。
- オーダー番号 71135634

アップグレードキット、拡張モジュール 485、PROFIBUS DP 付き

- 拡張モジュール 485
- PROFIBUS DP (+ Ethernet 設定)
- オーダー番号 71140888

アップグレードキット、拡張モジュール 485、Modbus RS485 付き

- 拡張モジュール 485
- Modbus RS485 (+ Ethernet 設定)
- オーダー番号 71140889

15.3.2 ファームウェアおよびアクティベーションコード

SD カード、Liquiline ファームウェア付き

- 工業用フラッシュドライブ、1 GB
- オーダー番号 71127100



アクティベーションコードをご注文の場合は、機器のシリアル番号を指定してください。

デジタル HART 通信用のアクティベーションコード

オーダー番号 71128428

PROFIBUS DP 用アクティベーションコード

オーダー番号 71135635

Modbus RS485 用アクティベーションコード

オーダー番号 71135636

PROFINET + Web サーバー用アクティベーションコード、BASE2 用

オーダー番号 71449901

Ethernet/IP + Web サーバー用アクティベーションコード、BASE2 用

オーダー番号 71449914

Modbus TCP + Web サーバー用アクティベーションコード、BASE2 用

オーダー番号 71449915

BASE2 用 Web サーバーのアクティベーションコード

オーダー番号 71449918

キット CM442R : 2 番目のデジタルセンサ入力用のアクティベーションコード

オーダー番号 71114663

キット CM444R/CM448R : BASE2-E の 2 x 0/4~20 mA 用のアップグレードコード

要問い合わせ

フィードフォワード制御用アクティベーションコード

- フィールドバス通信用の電流入力が必要
- オーダー番号 71211288

計測レンジスイッチ用アクティベーションコード

- デジタル入力またはフィールドバス通信が必要
- オーダー番号 71211289

ChemocleanPlus 用アクティベーションコード

- リレーまたはデジタル出力、またはフィールドバス通信およびオプションのデジタル入力が必要
- オーダー番号 71239104

Heartbeat 検証およびモニタリング用アクティベーションコード

オーダー番号 71367524

イオン交換器稼働時間用アクティベーションコード

- 演算機能
- オーダー番号 71367531

演算機能用アクティベーションコード

- 計算式エディタ
- オーダー番号 71367541

15.4 ソフトウェア

Memobase Plus CYZ71D

- ラボ校正をサポートする PC ソフトウェア
- センサ管理の可視化とドキュメンテーション
- センサ校正のデータベース保存
- 製品ページの製品コンフィギュレータ : www.endress.com/cyz71d

 技術仕様書 TI00502C

Field Data Manager ソフトウェア MS20

- データ集中管理用の PC ソフトウェア
- 一連の測定およびログブックイベントの可視化
- 確実なデータ保存のための SQL データベース

FieldCare SFE500

- フィールド機器の設定および管理用のユニバーサルツール
- Endress+Hauser 製フィールド機器操作の認定取得済み DTM (デバイスタイプマネージャ) のライブラリセットが付属
- 製品構成に応じてご注文下さい
- www.endress.com/sfe500

15.5 その他のアクセサリ

15.5.1 外部ディスプレイ⁴⁾

グラフィック表示部

- 制御キャビネットドアまたはパネルへの設置用
- オーダー番号 71185295

サービスディスプレイ

- ポータブル、設定用
- オーダー番号 71185296

15.5.2 SD カード

- 工業用フラッシュドライブ、1 GB
- オーダー番号 71110815

15.5.3 通信関連のアクセサリ

Commubox FXA195

USB ポートを介した FieldCare との本質安全 HART 通信

 技術仕様書 TI00404F

Commubox FXA291

コンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを使用して計測機器の CDI インタフェースと接続

 技術仕様書 TI00405C

Wireless HART アダプタ SWA70

- 無線の機器接続
- 統合が簡単、データ保護と伝送の安全性を提供、他の無線ネットワークと並行して使用可能、複雑なケーブル敷設が最小限

 技術仕様書 (TI00061S) を参照

4) 外部ディスプレイは製品構成のオプションとして選択するか、または後ほどアクセサリとして注文することが可能です。

15.5.4 システムコンポーネント

RIA14、RIA16

- 4～20 mA 回路に組み込むための現場表示ユニット
- RIA14 は防炎金属製ハウジング付き



技術仕様書 (TI00143R および TI00144R) を参照

RIA15

- プロセス表示ユニット、4～20 mA 回路に組み込むためのデジタル表示ユニット
- パネルへの取付け
- オプションの HART 通信付き



技術仕様書 (TI01043K) を参照

16 技術データ

16.1 入力

測定変数	→ 接続するセンサのドキュメントを参照
測定範囲	→ 接続するセンサのドキュメントを参照

入力タイプ	■ Memosens プロトコルを使用したセンサ用デジタルセンサ入力 ■ アナログ電流入力（オプション） ■ デジタル入力（オプション） ■ Memosens プロトコルを搭載した、防爆認定取得済み（オプション）の本質安全センサのデジタルセンサ入力 認定を取得した以下のセンサ、ケーブル、機器のみを、センサ通信モジュール 2DS Ex-i の本質安全デジタルセンサ入力に接続できます。 ■ Memosens ケーブル xYK10、xYK20 センサ通信モジュール 2DS Ex-i、CM44x(R) 関連機器と Memosens ケーブル xYK10 および xYK20 の接続は、システムとして認定されています。 ■ デジタル Memosens センサおよびその他の Memosens 機器 ■ センサおよび機器は、センサ通信モジュール 2DS Ex-i が搭載された CM44x(R) の指定された電気パラメータに適合しなければなりません。 ■ xLS50D 以外のセンサと機器は、電磁誘導インターフェイスを介して Memosens ケーブル xYK10 または xYK20 と接続する必要があります。 ■ デジタルセンサシミュレータ xYP03D センサシミュレータ / Memocheck シミュレーションテスト（タイプ xYP03D）には、次のバッテリーを使用してください：Duracell MN1500 または Energizer EN91。 以下の認定を取得した機器を、センサ通信モジュール 2DS Ex-i に接続できます。
-------	---

ATEX	
xYK10 および xYK20 ¹⁾	BVS 04 ATEX E121X
xYP03D ¹⁾	BVS 12 ATEX E008
xLS50D ¹⁾	BVS 12 ATEX E048X

1) x = C または O または OC

IECEX	
xYK10 および xYK20 ¹⁾	IECEX BVS 11.0052X
xYP03D ¹⁾	IECEX BVS 12.0007
xLS50D ¹⁾	IECEX BVS 14.0004X

1) x = C または O または OC

入力信号	バージョンによって異なります。 ■ 最大 8 x デジタルセンサ信号 ■ 2 x 0/4～20 mA（オプション）、パッシブ、互いにセンサ入力から電氣的に絶縁 ■ 0～30 V
------	---

ケーブル仕様

ケーブルタイプ

Memosens データケーブル CYK10 またはセンサ固定ケーブル。それぞれ端子台接続、または M12 丸ピンコネクタ（オプション）



適切な認定を取得した Memosens データケーブル CYK10 のみを、センサ通信モジュール 2DS Ex-i の本質安全デジタルセンサ入力に接続できます。

ケーブル長

最大 100 m (330 ft)

16.2 デジタル入力、パッシブ

電気仕様

- 電動式（パッシブ）
- 絶縁型

範囲

- 高：11～30 V DC
- 低：0～5 V DC

公称入力電流

最大 8 mA

PFM 機能

最小パルス幅：500 μs (1 kHz)

テスト電圧

500 V

ケーブル仕様

最大 2.5 mm² (14 AWG)

16.3 電流入力、パッシブ

範囲

> 0～20 mA

信号特性

リニア

内部抵抗

非線形

テスト電圧

500 V

16.4 出力

出力信号

バージョンによって異なります。

- 2 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電氣的に絶縁
- 4 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電氣的に絶縁
- 6 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電氣的に絶縁
- 8 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電氣的に絶縁
- オプションの HART 通信（電流出力 1:1 経由のみ）

HART	
信号符号化	FSK ± 0.5 mA (電流信号を介した)
データ伝送速度	1200 baud
電氣的絶縁	あり
負荷 (通信レジスタ)	250 Ω

PROFIBUS DP/RS485	
信号符号化	EIA/TIA-485、PROFIBUS DP 対応、IEC 61158 に準拠
データ伝送速度	9.6 kBd、19.2 kBd、45.45 kBd、93.75 kBd、187.5 kBd、500 kBd、1.5 MBd、6 MBd、12 MBd
電氣的絶縁	あり
コネクタ	ばね端子 (最大 1.5 mm)、内部ブリッジ (T 機能)、M12 (オプション)
バス・ターミネーション	LED 表示を備える内部スライドスイッチ

Modbus RS485	
信号符号化	EIA/TIA-485
データ伝送速度	2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200 baud
電氣的絶縁	あり
コネクタ	ばね端子 (最大 1.5 mm)、内部ブリッジ (T 機能)、M12 (オプション)
バス・ターミネーション	LED 表示を備える内部スライドスイッチ

Ethernet および Modbus TCP	
信号符号化	IEEE 802.3 (Ethernet)
データ伝送速度	10/100 MBd
電氣的絶縁	あり
接続	RJ45
IP アドレス	DHCP (初期設定) またはメニューで設定

Ethernet/IP	
信号符号化	IEEE 802.3 (Ethernet)
データ伝送速度	10/100 MBd
電氣的絶縁	あり
接続	RJ45
IP アドレス	DHCP (初期設定) またはメニューで設定

PROFINET	
信号符号化	IEEE 802.3 (Ethernet)
データ伝送速度	100 MBd
電氣的絶縁	あり
接続	RJ45
ステーション名	DCP プロトコルを介した設定ツール使用 (例: Siemens PRONETA)
IP アドレス	DCP プロトコルを介した設定ツール使用 (例: Siemens PRONETA)

アラーム時の信号

調整可能、NAMUR 規格推奨 NE 43 に準拠

- 測定範囲 0~20 mA の場合 (この測定範囲では HART は使用不可):
エラー電流 0~23 mA
- 測定範囲 4~20 mA の場合:
エラー電流 2.4~23 mA
- 両測定範囲に対するエラー電流の工場出荷時の設定:
21.5 mA

負荷

最大 500 Ω

リニアライゼーション/伝送動作

リニア

16.5 デジタル出力、パッシブ

電気仕様

- パッシブ
- オープンコレクタ、最大 30 V、15 mA
- 最大電圧降下: 3 V

外部電源

補助電源およびデジタル入力を使用した場合:
 推奨最大補助電圧 = $3\text{ V} + V_{IHmin}$
 (V_{IHmin} = 必要最小入力電圧 (高レベル入力電圧))

PFM 機能

最小パルス幅: 500 μs (1 kHz)

補助電圧

電気仕様

- 絶縁型
- 未調整、DC 24 V
- 最大 50 mA (各 DIO モジュール)

テスト電圧

500 V

ケーブル仕様

最大 2.5 mm² (14 AWG)

16.6 電流出力、アクティブ

範囲	0～23 mA HART 通信の場合 2.4～23 mA
----	---------------------------------

信号特性	リニア
------	-----

電気仕様	出力電圧 最大 24 V テスト電圧 500 V
------	---

ケーブル仕様	ケーブルタイプ 推奨：シールドケーブル ケーブル仕様 最大 2.5 mm ² (14 AWG)
--------	---

16.7 リレー出力

電気仕様	リレータイプ ■ 単一ピン切替接点 1 個（アラームリレー） ■ 単一ピン切替接点 2 または 4 個（オプションで拡張モジュール追加） 最大負荷 ■ アラームリレー：0.5 A ■ その他すべてのリレー：2.0 A
------	--

開閉容量

ベーシックモジュール（アラームリレー）

切替電圧	負荷（最大）	切替サイクル（最小）
AC 230 V、 $\cos\Phi = 0.8 \sim 1$	0.1 A	700,000
	0.5 A	450,000
AC 115 V、 $\cos\Phi = 0.8 \sim 1$	0.1 A	1,000,000
	0.5 A	650,000
DC 24 V、L/R = 0～1 ms	0.1 A	500,000
	0.5 A	350,000

拡張モジュール

切替電圧	負荷 (最大)	切替サイクル (最小)
AC 230 V、 $\cos\Phi = 0.8 \sim 1$	0.1 A	700,000
	0.5 A	450,000
	2 A	120,000
AC 115 V、 $\cos\Phi = 0.8 \sim 1$	0.1 A	1,000,000
	0.5 A	650,000
	2 A	170,000
DC 24 V、 $L/R = 0 \sim 1 \text{ ms}$	0.1 A	500,000
	0.5 A	350,000
	2 A	150,000

ケーブル仕様

最大 2.5 mm² (14 AWG)

16.8 プロトコル固有のデータ

HART

製造者 ID	11 _h
デバイスタイプ	155D _h
機器リビジョン	001 _h
HART バージョン	7.2
機器説明ファイル (DD/DTM)	www.endress.com/hart Device Integration Manager DIM
機器変数	16 x ユーザー設定可能な機器変数、16 x 事前設定された機器変数、ダイナミック変数 PV/SV/TV/QV
サポートされている機能	PDM DD、AMS DD、DTM、Field Xpert DD

PROFIBUS DP

製造者 ID	11 _h
デバイスタイプ	155D _h
プロファイルバージョン	3.02
GSD ファイル	www.endress.com/profibus Device Integration Manager DIM
出力値	16 x AI ブロック、8 x DI ブロック
入力パラメータ	4 x AO ブロック、8 x DO ブロック
サポートされている機能	■ 1 x MSCY0 接続 (循環通信、スレーブにマスタークラス 1) ■ 1 x MSAC1 接続 (非循環通信、スレーブにマスタークラス 1) ■ 2 x MSAC2 接続 (非循環通信、スレーブにマスタークラス 2) ■ 機器ロック: ハードウェアまたはソフトウェアを使用して機器をロックすることが可能 ■ DIL スイッチまたはソフトウェアを使用したアドレス指定 ■ GSD、PDM DD、DTM

Modbus RS485	プロトコル	RTU/ASCII
	機能コード	03, 04, 06, 08, 16, 23
	機能コード対応信号送信	06, 16, 23
	出力データ	16 x 測定値 (値、単位、ステータス)、8 x デジタル値 (値、ステータス)
	入力データ	4 x 設定値 (値、単位、ステータス)、8 x デジタル値 (値、ステータス)、診断情報
	サポートされている機能	スイッチまたはソフトウェアを使用したアドレス設定が可能

Modbus TCP	TCP ポート	502
	TCP 接続	3
	プロトコル	TCP
	機能コード	03, 04, 06, 08, 16, 23
	機能コード対応信号送信	06, 16, 23
	出力データ	16 x 測定値 (値、単位、ステータス)、8 x デジタル値 (値、ステータス)
	入力データ	4 x 設定値 (値、単位、ステータス)、8 x デジタル値 (値、ステータス)、診断情報
	サポートされている機能	DHCP またはソフトウェアを使用したアドレス設定が可能

EtherNet/IP	ログ	Ethernet/IP	
	ODVA 認証	あり	
	機器プロファイル	汎用機器 (製品タイプ : 0x2B)	
	製造者 ID	0x049E _h	
	機器タイプ ID	0x109C _h	
	極性	Auto-MIDI-X	
	接続	CIP	12
		I/O	6
		明示的メッセージ	6
		マルチキャスト	3 コンシューマ
	最小 RPI	100 ms (初期設定)	
	最大 RPI	10000 ms	
	システム統合	Ethernet/IP	EDS
		ロックウェル	アドオンプロファイル レベル 3、FactoryTalk SE3 用フェイスプレート
	IO データ	入力 (T → O)	優先順位の最も高い機器ステータスおよび診断メッセージ 測定値 : ■ 16 AI (アナログ入力) + ステータス + 単位 ■ 8 DI (離散入力) + ステータス
		出力 (O → T)	作動値 : ■ 4 AO (アナログ出力) + ステータス + 単位 ■ 8 DO (離散出力) + ステータス

PROFINET

プロトコル	「分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーション層プロトコル」 PNIO バージョン 2.34
通信タイプ	100 MBit/s
Conformance Class B	Conformance Class B
Netload Class	Netload Class II
Baud rate (ボーレート)	自動 100 Mbps (全二重検出)
サイクル時間	32 ms から
機器プロファイル	アプリケーションインターフェイス識別子 0xF600 一般的機器
PROFINET インターフェイス	1 x ポート、Realtime Class 1 (RT_CLASS_1)
製造者 ID	0x11 _h
機器タイプ ID	0x859C D _h
DD ファイル (GSD)	情報およびファイルは以下から入手できます。 ■ www.endress.com 機器の製品ページから: ドキュメント/ソフトウェア → デバイスドライバー ■ www.profibus.com ウェブサイトの製品/製品ファインダから
Polarity (極性)	自動極性 (クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用)
サポートされる接続	■ 1 x AR (IO コントローラ AR) ■ 1 x AR (IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可) ■ 1 x 入力 CR (Communication Relation、通信関係) ■ 1 x 出力 CR (Communication Relation、通信関係) ■ 1 x アラーム CR (Communication Relation、通信関係)
機器の設定オプション	■ ウェブブラウザ ■ 製造者固有のソフトウェア (FieldCare、DeviceCare) ■ 機器マスターファイル (GSD)、測定機器の内蔵 Web サーバーを介して読み取り可能
機器名の設定	DCP プロトコル
サポートされる機能	■ 識別表示とメンテナンス 以下による容易な機器識別: ■ プロセス制御システム ■ 銘板 ■ 測定値のステータス プロセス変数は測定値ステータスと通信 ■ 容易な機器識別と割り当てのため、現場表示器を介した点滅機能 (FLASH_ONCE) ■ 操作ツールを使用した機器操作 (例: FieldCare、DeviceCare)
システム統合	システム統合の詳細については、取扱説明書を参照してください ■ サイクリックデータ伝送 ■ 概要およびモジュールの説明 ■ ステータス符号化 ■ スタートアップ設定 ■ 初期設定

Web サーバー

Web サーバーでは、ユーザー定義の IP アドレスを使用して、標準的な WiFi/WLAN/LAN/GSM または 3G ルータを介して、機器設定、測定値、診断メッセージ、ログブック、およびサービスデータにフルアクセスすることができます。

TCP ポート	80
サポートされている機能	■ リモート操作される機器設定 (1 セッション) ■ 機器設定の保存/復元 (SD カード経由) ■ ログブックエクスポート (ファイル形式: CSV、FDM) ■ DTM または Internet Explorer を介して Web サーバーにアクセス ■ ログイン ■ Web サーバーをオフにすることが可能

16.9 電源

電源電圧

CM442 R

バージョンによって異なります。

- AC 100 ~ 230 V、50/60 Hz
電源電圧の最大許容変動: 公称電圧の $\pm 15\%$
- AC/DC 24 V、50/60 Hz
電源電圧の最大許容変動: 公称電圧の $+20/-15\%$

CM444 R および CM448 R

バージョンに応じて、外部の DIN レール電源ユニット経由:

- AC 100 ~ 230 V、50/60 Hz
電源電圧の最大許容変動: 公称電圧の $\pm 15\%$ ⁵⁾
- DC 24 V
電源電圧の最大許容変動: 公称電圧の $+20/-15\%$ ⁵⁾

消費電力

CM442 R

供給電圧に応じて

- AC 100~230 V および AC 24 V :
最大 55 VA
- DC 24 V :
最大 22 W

CM444 R および CM448 R

供給電圧に応じて

- AC 100~230 V
最大 150 VA ⁵⁾
- DC 24 V :
最大 59 W ⁵⁾

ヒューズ

ヒューズは交換不可

過電圧保護

EN 61326 準拠の雷過電圧保護を内蔵
保護等級 1 および 3

ディスプレイケーブル (オプション) のケーブル仕様

納入されるディスプレイケーブルの長さ:
3 m (10 ft)

許容されるディスプレイケーブルの最大長:
5 m (16.5 ft)

5) *製造者が供給する電源ユニットの使用時にのみ適用される仕様です。

16.10 性能特性

応答時間	電流出力 t_{90} = 最大 500 ms、0 から 20 mA への増加時 電流入力 t_{90} = 最大 330 ms、0 から 20 mA への増加時 デジタル入力および出力 t_{90} = 最大 330 ms、低から高への増加時
基準温度	25 °C (77 °F)
センサ入力の測定誤差	→ 接続するセンサのドキュメントを参照
電流入力および出力の測定誤差	典型的な測定誤差： < 20 μ A (電流値 < 4 mA 時) < 50 μ A (電流値 4~20 mA 時) 各 25 °C (77 °F) 時 温度に応じた追加測定誤差： < 1.5 μ A/K
デジタル入力/出力の周波数許容誤差	$\leq 1\%$
電流入力および出力の分解能	< 5 μ A
繰返し性	→ 接続するセンサのドキュメントを参照

16.11 環境

周囲温度	CM442R ■ 0~60 °C (32~140 °F) ■ 0~50 °C (0~120 °F)、以下の機器の場合： ■ CM442(R)-BM ■ CM442(R)-IE
------	--

CM444R

- 通常は 0～55 °C (32～130 °F)、リストの 2 番目の点より下のパッケージは除外
- 0～50 °C (32～120 °F)、以下の構成の場合：
 - CM444R-**M40A7FI*+...
 - CM444R-**M40A7FK*+...
 - CM444R-**M4AA5F4*+...
 - CM444R-**M4AA5FF*+...
 - CM444R-**M4AA5FH*+...
 - CM444R-**M4AA5FI*+...
 - CM444R-**M4AA5FK*+...
 - CM444R-**M4AA5FM*+...
 - CM444R-**M4BA5F4*+...
 - CM444R-**M4BA5FF*+...
 - CM444R-**M4BA5FH*+...
 - CM444R-**M4BA5FI*+...
 - CM444R-**M4BA5FK*+...
 - CM444R-**M4BA5FM*+...
 - CM444R-**M4DA5F4*+...
 - CM444R-**M4DA5FF*+...
 - CM444R-**M4DA5FH*+...
 - CM444R-**M4DA5FI*+...
 - CM444R-**M4DA5FK*+...
 - CM444R-**M4DA5FM*+...
 - CM444(R)-BM
 - CM444(R)-IE

CM448R

- 通常は 0～55 °C (32～130 °F)、リストの 2 番目の点より下のパッケージは除外
- 0～50 °C (32～120 °F)、以下の構成の場合：
 - CM448R-***6AA*+...
 - CM448R-***8A4*+...
 - CM448R-***8A5*+...
 - CM448R-**28A3*+...
 - CM448R-**38A3*+...
 - CM448R-**48A3*+...
 - CM448R-**58A3*+...
 - CM448R-**68A3*+...
 - CM448R-**26A5*+...
 - CM448R-**36A5*+...
 - CM448R-**46A5*+...
 - CM448R-**56A5*+...
 - CM448R-**66A5*+...
 - CM448R-**22A7*+...
 - CM448R-**32A7*+...
 - CM448R-**42A7*+...
 - CM448R-**52A7*+...
 - CM448R-**62A7*+...
 - CM448R-**A6A5*+...
 - CM448R-**A6A7*+...
 - CM448R-**B6A5*+...
 - CM448R-**B6A7*+...
 - CM448R-**C6A5*+...
 - CM448R-**C6A7*+...
 - CM448R-**D6A5*+...
 - CM448R-**D6A7*+...
 - CM448(R)-BM
 - CM448(R)-IE

外部ディスプレイ (オプション)

-20～60 °C (0～140 °F)

保管温度	-25～85 °C (-13～185 °F)		
湿度	DIN レール機器 5～85 %、結露なし 外部ディスプレイ（設置状態で） 5～95 %、結露なし		
保護等級	DIN レール機器 IP20 衝撃保護 外部ディスプレイ IP66 フロントパネル、ハウジングドアのシールを含めて正しく設置されている場合		
気候クラス	IEC 60654-1: B2 準拠		
耐振動性	環境試験 DIN EN 60068-2 に基づく振動試験、2008 年 10 月 DIN EN 60654-3 に基づく振動試験、1998 年 8 月 壁面取付 周波数範囲 10～150 Hz（正弦波） 振幅 10～12.9 Hz : 0.75 mm 12.9～150 Hz : 0.5 g ¹⁾ 試験時間 空間軸ごとに 10 周波数サイクル、3 つの空間軸（1 oct./分） 1) g ... 重力加速度（1 g ≈ 9.81 m/s ² ）		
電磁適合性	干渉波の放出および干渉波の適合性は EN 61326-1 : 2013、産業用クラス A に準拠		
電気安全性	IEC 61010-1、Class I 低電圧：過電圧カテゴリー II 環境 < 2000 m (< 6562 ft)、基準海面上		
汚染度	DIN レール設置型 汚染度 2 ディスプレイ（オプション） 汚染度 2		

16.12 構造

寸法 → 17


質量	バージョンによって異なる：	
	CM442R（完全に組立て済み）	約 0.45 kg（1 lbs）
	CM444R および CM448R（完全に組立て済み）	約 0.95 kg（2.1 lbs）
	各モジュール	約 0.06 kg（0.13 lbs）
	外部ディスプレイ（ケーブルを除く）	約 0.56 kg（1.2 lbs）
	サービスディスプレイカバー	0.46 kg（1 lbs）
	外部電源ユニット（CM444R、CM448R）	0.27～0.42 kg（0.60～0.92 lbs）、電源ユニットのタイプに応じて

材質	DIN レールハウジング	PC-FR
	ディスプレイカバー	PC-FR
	ディスプレイシール	EPDM
	ソフトキー	EPDM
	モジュールハウジング 2DS Ex-i	PC-PBT
	モジュールカバー	PBT GF30 ガラスエポキシ（FR）
	端子台	ニッケルめっき真ちゅう
	接地端子	ステンレス 1.4301（SUS 304 相当）
	ネジ	ステンレス 1.4301（SUS 304 相当）
	取付プレート（オプションのディスプレイ）	ステンレス 1.4301（SUS 304 相当）
	固定ネジ（オプションのディスプレイ）	スチール、亜鉛めっき
	サービスディスプレイカバー（アクセサリ）	EPDM

17 危険環境 Class I Div. 2 における取付設置と操作

特定の危険環境用の無火花機器は以下に準拠

- Class I Div. 2
- ガス蒸気グループ A、B、C、D
- 温度クラス T4A :
 - CM442R : 0°C (32°F) $< T_a < 60^{\circ}\text{C}$ (140°F)
 - CM444/8R : 0°C (32°F) $< T_a < 55^{\circ}\text{C}$ (131°F) または 50°C (110°F)、特定バージョンの場合 (→ 155)
- 制御図 : 401204
- 屋内および屋外での使用に適合、NEMA 4X、IP66/67 に準拠

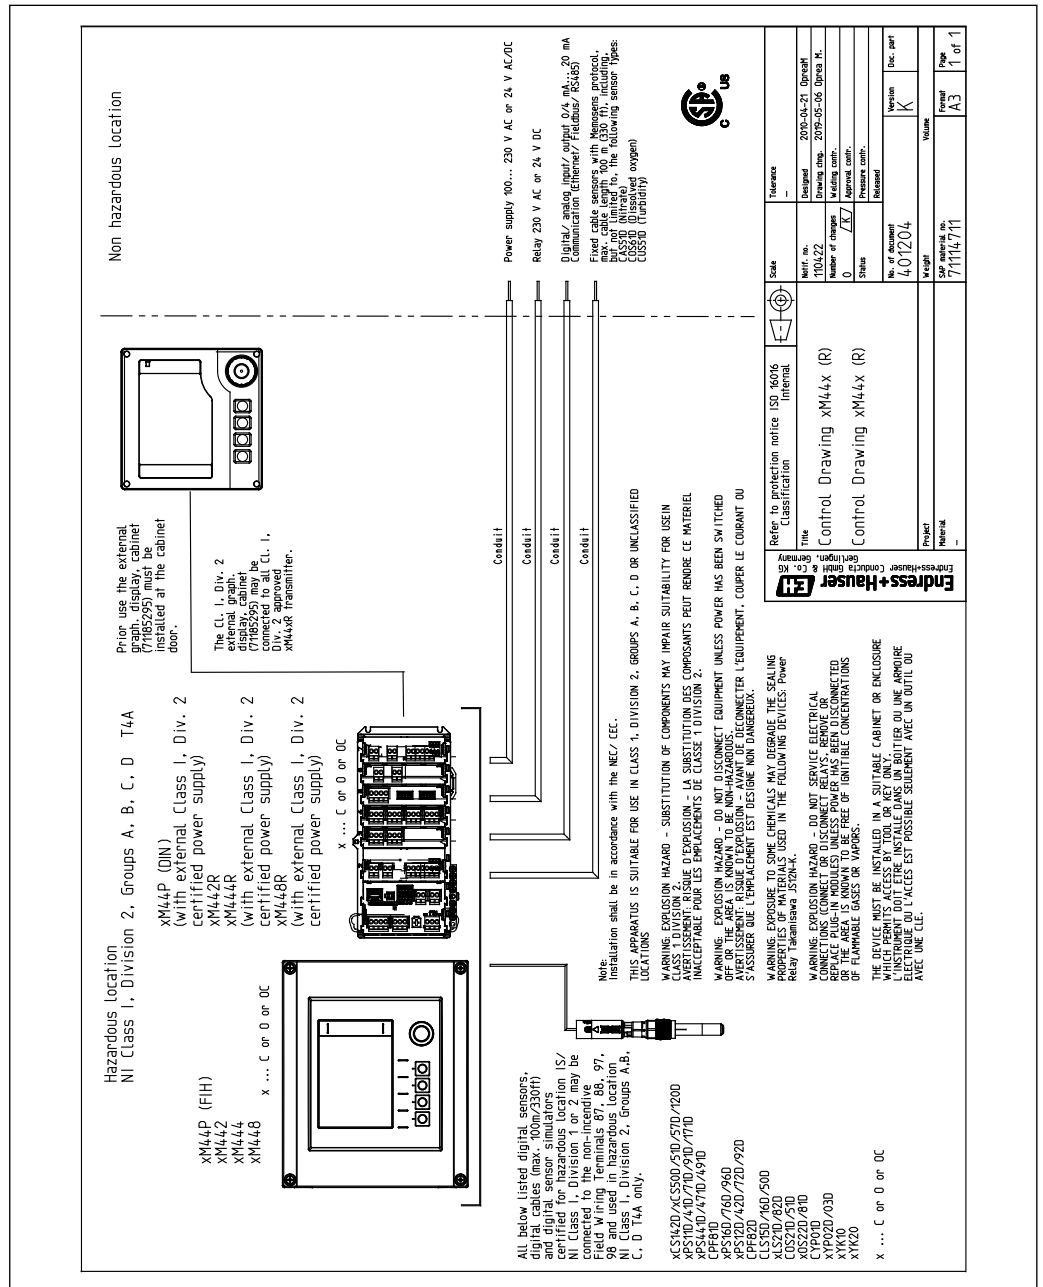

索引

記号
診断リスト 120
接続
 Web サーバー 41
陽イオン交換器量 104

C
Chemoclean 36, 98
Chemoclean Plus 99

E
EtherNet/IP 44, 63, 77, 152

F
Formula 106

H
HART 43, 75, 151
HART バスアドレス 61
Heartbeat 42
Heartbeat diagnostics 52
Heartbeat 検証 125

M
Modbus 44, 61, 76
Modbus 485
 接続 37
Modbus RS485 152
Modbus TCP 152

P
PROFIBUS
 接続 37
PROFIBUS DP 44, 61, 151
 PROFIBUS 変数 76
 機器変数 76
PROFINET 44, 153
 PROFINET 変数 76
 機器変数 76

R
rH 値 102

W
Web サーバー 62, 154

ア
アクセサリ
 センサ 137
 その他 144
 ソフトウェア 144
 通信関連 144
 ハードウェア拡張モジュール 142
 ファームウェアおよびアクティベーションコー
 ド 143
 測定用ケーブル 137
 追加機能 142

アクティベーションコード 66
アラームリレー 71
安全上の注意事項 7
安全性
 製品 9
 操作上 8
 労働安全 8

イ
イベントログブック 121

エ
演算 pH 値 104
演算機能 100
 Formula 106
 rH 値 102
 演算 pH 値 104
 差 101
 冗長性 101
 脱ガス導電率 102
 デュアル導電率 103
 陽イオン交換器量 104

オ
汚染度 157

カ
確認
 接続 40
 設置 24
 設置と機能 49
過電圧保護 154
関連資料 6

キ
機器固有のエラー 113
機器固有の診断メッセージ 116
機器情報 126
機器ステータス 53
機器説明 10
機器テスト 125
機器のリセット 125
機器変数 76
気候クラス 157
技術者 7
技術データ
 環境 155
 構造 157
 出力 147
 性能特性 155
 デジタル出力、パッシブ 149
 デジタル入力、パッシブ 147
 電流出力、アクティブ 150
 電流入力、パッシブ 147
 入力 146
 プロトコル固有のデータ 151
 リレー出力 150

起動	49
機能接地	31
機能チェック	49
基本設定	51, 54

ケ

警告	5
計測レンジスイッチ	108
ケーブル仕様	147, 154
ケーブル端子	27

コ

校正	112
コントローラ	72, 90
コントローラ構造	90

サ

サービスインターフェイス	43
材質	158
最先端技術	9
作業員の要件	7

シ

時間	55
時間スイッチ	87
システム統合	
Web サーバー	41
サービスインターフェイス	43
フィールドバス	43
システム情報	126
湿度	157
質量	158
シミュレーション	124
周囲温度	155
修理	134
出力	
EtherNet/IP	77
HART	75
Modbus	76
PROFIBUS DP	76
PROFINET	76
出力信号	147
デジタル出力、パッシブ	149
電流出力	68
電流出力、アクティブ	150
バイナリ	77
リレー	71
リレー出力	150
使用	
指定外	7
用途	7
消費電力	154
診断動作の適合	115
診断メッセージ	
ウェブブラウザ	114
機器固有	116
現場表示器	114
センサ固有	120
適合	114
フィールドバス	114

分類	114
未解決	120
リレーを介した出力	73
診断モジュール	111
シンボル	5

ス

スペアパーツ	134
スロットとポートの割当て	12
寸法	157

セ

製品識別表示	14
製品の安全性	9
セキュリティ	
IT	9
接続	
Web サーバー	43
オプションモジュール	33
確認	40
機器	26
機能接地	31
センサ	30
電源電圧	154
フィールドバス (PROFIBUS、Modbus 485)	37
設置	
確認	24
設置環境	8
設置条件	17
設置の確認	49
設定	49
EtherNet/IP	63
HART バスアドレス	61
Modbus	61
PROFIBUS DP	61
PROFINET	63
Web サーバー	62
アクション	48
一般	54
拡張	60
基本	51
診断	60
操作言語	49
ハードウェア	38
バイナリ出力	81
バイナリ入力	80
表示動作	49
フリーテキスト	48
ユーザ定義スクリーン	50
数値	47
選択リスト	47
表	48
設定転送	66
設定保存	65
設定読み込み	65
船級	16
センサ	
接続	30
センサ固有の診断メッセージ	120

センサ情報	128
洗浄機能	74
洗浄サイクル	100
洗浄タイプ	98
洗浄プログラム	
Chemoclean	98
Chemoclean Plus	99
手動洗浄	100
標準洗浄	98
洗浄ユニット	36
ソ	
操作	
一般設定	54
設定	47
表示	52
操作言語	49
操作上の安全性	8
操作変数	72
測定範囲	146
測定変数	146
測定モード	52
測定モードでのソフトキー	52
タ	
耐振動性	157
脱ガス導電率	102
端子図	13
ツ	
追加機能	
演算機能	100
計測レンジスイッチ	108
コントローラ	90
時間スイッチ	87
洗浄プログラム	97
リミットスイッチ	83
追加セットアップ	60
テ	
ディスプレイケーブル	20
データマネージメント	65
適合宣言	15
デュアル導電率	103
電気安全性	157
電源	154
過電圧保護	154
機器の接続	26
ケーブル仕様	154
消費電力	154
センサ接続	30
電源電圧	154
ヒューズ	154
フィールドバス (PROFIBUS、Modbus 485) の接続	37
モジュール (オプション) の接続	33
電源電圧	154
電磁適合性	157
電流出力	68
電流入力	68

ト	
トラブルシューティング	113
一般トラブルシューティング	113
診断情報	114
ニ	
入力	
測定変数	146
デジタル入力、パッシブ	147
電流入力	68
電流入力、パッシブ	147
バイナリ	77
入力信号	146
入力タイプ	146
認定	
船級	16
ノ	
納入範囲	15
納品内容確認	14
ハ	
ハードウェア設定	38
廃棄	136
バス終端処理	38
パスワードの変更	67
ヒ	
日付	55
ヒューズ	154
表示	52
表示動作	49
標準洗浄	98
フ	
ファームウェアアップデート	65
ファームウェアの履歴	129
フィードフォワード制御による塩素調節	78
フィールドバス	
終端処理	38
プロトコル固有のデータ	151
ヘ	
返却	136
ホ	
ホールド設定	56
保管温度	157
保護等級	157
保護等級の保証	39
メ	
銘板	14
メッセージのないプロセスエラー	113
メンテナンス	132
ユ	
ユーザ定義スクリーン	50

ヨ	
用途	7
ラ	
ラプラス表現	90
リ	
リミットスイッチ	71, 83
リモート操作	25
リレー	71
ロ	
労働安全	8
ログブック	56, 121
ワ	
割当ビュー	54



www.addresses.endress.com
