Resumo das instruções de operação Gammapilot FMG50 HART

Tecnologia de medição radiométrica





Este resumo das instruções de operação não substitui as instruções de operação relativas ao equipamento.

Informações detalhadas são fornecidas nas instruções de operação e em outras documentações.

Disponível para todas as versões de equipamento através:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Aplicativo de operações da Endress +Hauser



Documentação associada 1



A0023555

2 Sobre este documento

2.1 Símbolos usados

2.1.1 Símbolos de segurança

▲ CUIDADO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.

⚠ PERIGO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se esta situação não for evitada, poderão ocorrer ferimentos sérios ou fatais.

AVISO

Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

▲ ATENÇÃO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.

2.1.2 Símbolos para determinados tipos de informações e gráficos



Adverte contra substâncias radioativas ou radiação ionizante



Permitido

Procedimentos, processos ou ações que são permitidos



Proibido

Procedimentos, processos ou ações que são proibidos



Dica

Indica informação adicional



Consulte a documentação



Aviso ou etapa individual a ser observada

1., 2., 3.

Série de etapas



Resultado de uma etapa

1, 2, 3, ...

Números de itens

A, B, C, ...

Visualizações

(

Inspeção visual

2.2 Documentação

Os seguintes tipos de documentação estão disponíveis na área de downloads do site da Endress+Hauser (www.endress.com/downloads):



- Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:
- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Insira o número de série informado na etiqueta de identificação.
- Aplicativo de operações da Endress+Hauser: Insira o número de série que está na etiqueta de identificação ou leia o código de matriz na etiqueta de identificação.

2.2.1 Informações técnicas (TI)

Auxílio de planejamento

O documento contém todos os dados técnicos do equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.

2.2.2 Instruções de operação (BA)

Seu quia de referência

Essas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.

2.2.3 Instruções de segurança (XA)

Dependendo da aprovação, as seguintes Instruções de segurança (XA) são fornecidas juntamente com o equipamento. Elas são parte integrante das instruções de operação.



A etiqueta de identificação indica as Instruções de segurança (XA) que são relevantes ao equipamento.

2.2.4 Manual de Segurança Funcional (FY)

Dependendo da aprovação SIL, o Manual de Segurança Funcional (FY) é uma parte integrante das Instruções de operação e são aplicáveis juntamente com as Instruções de operação, Informações técnicas e Instruções de segurança ATEX.



As diferentes especificações que se aplicam à função de proteção estão descritas no Manual de Segurança Funcional (FY).

2.3 Marcas comerciais registradas

HART®

Marca registrada do grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

Apple[®]

Apple, o logotipo da Apple, iPhone e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., nos EUA e outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android®

Android, Google Play e o logo da Google Play são marcas registradas da Google Inc.

Bluetooth®

A marca *Bluetooth*® e seus logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas por parte da Endress + Hauser está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são aqueles dos respectivos proprietários.

3 Instruções de segurança básicas

3.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica
- Sejam autorizados pelo dono/operador da planta
- Sejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais
- Antes do início do trabalho, a equipe especialista deve ler e entender as instruções nas instruções de operação e na documentação adicional assim como nos certificados (dependendo da aplicação)
- A conformidade com as instruções é uma condição básica

O pessoal de operação deve preencher as sequintes especificações:

- Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo dono-operador das instalações
- Seguir as instruções presentes nestas Instruções de operação

3.2 Uso indicado

O Gammapilot FMG50 é um transmissor compacto para medição de concentração e densidade, nível pontual e nível sem contato. O detector tem comprimento máximo de 3 m (9.84 ft). O Gammapilot FMG50 é certificado de acordo com a IEC 61508 para operação relacionada à segurança até SIL 2/3.

3.3 Área classificada

Se o sistema de medição for usado em áreas classificadas, as normas e regulamentações nacionais correspondentes devem ser observadas. O equipamento é acompanhado por uma "Documentação Ex", que é parte integrante destas Instruções de operação. As especificações de instalação, os valores de conexão e as instruções de segurança listados nesta documentação suplementar devem ser estritamente observados.

- O pessoal técnico deve ser qualificado e treinado para a área classificada.
- Esteja em conformidade com os requisitos metrológicos e relacionados à segurança para o ponto de medição.

AATENÇÃO

 Observe as instruções de segurança associadas ao equipamento. Essas instruções dependem do certificado solicitado


3.4 Proteção contra radiação

O Gammapilot FMG50 é usado junto com uma fonte radioativa, contida em um contêiner. O Gammapilot FMG50 não emite radiação radioativa. Observe as seguintes instruções ao manusear fontes radioativas:

3.4.1 Diretrizes básicas de proteção contra radiação

AATENÇÃO

► Ao trabalhar com fontes radioativas, evite qualquer exposição desnecessária à radiação. Toda exposição inevitável à radiação deve ser minimizada. Três conceitos básicos se aplicam para se alcançar isto:

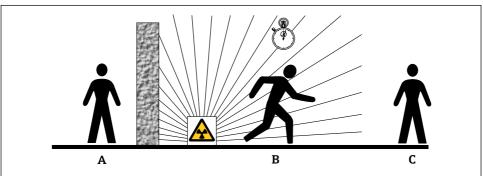

A0016373

- A Blindagem
- B Hora
- C Distância

▲ CUIDADO

► Ao trabalhar com contêineres, todas as instruções para instalação e uso descritas nos seguintes documentos devem ser observadas:



Documentação do contêiner

■ FQG60:

TI00445F

• FQG61, FQG62:

TI00435F

■ FOG63:

TI00446F

- **■** FOG66:
 - TI01171F
 - BA01327F

Blindagem

Assegure a melhor blindagem possível entre a fonte radioativa e você e as demais pessoas. A blindagem efetiva é fornecida pelos contêineres (FQG60, FQG61/FQG62,FQG63, FQG66) e todos os materiais de alta densidade (chumbo, ferro, concreto etc.).

Tempo

Permaneça o menor tempo possível na área exposta à radiação.

Distância

Mantenha a maior distância possível da fonte radioativa. A intensidade da radiação diminui proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte radioativa.

3.5 Segurança do local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- ▶ Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.
- ▶ Desligue a fonte de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.

3.6 Segurança da operação

Risco de ferimentos!

- ▶ Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- ▶ O operador é responsável por garantir a operação do equipamento livre de problema.

3.7 Segurança do produto

Este medidor foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender as especificações de segurança mais avançadas, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação. Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais.

O fabricante confirma sucesso do teste do equipamento afixando nele a identificação CE, a identificação UKCA, a identificação C-Tick e a identificação EAC.

3.8 Instruções de segurança complementares

A CUIDADO

Equipamentos com versão NaI(TI) contêm mais de 0,1% de iodeto de sódio e estão registrados na ficha de dados de segurança CAS n° 7681-82-5.

 O iodeto de sódio geralmente não é acessível e está totalmente encapsulado. Garanta a total conformidade com as instruções de segurança na ficha de dados de segurança CAS nº 7681-82-5 se o encapsulamento do iodeto de sódio dentro do equipamento estiver danificado.

4 Recebimento e identificação do produto

4.1 Recebimento

Verifique o seguinte durante o recebimento:

- Os códigos de pedidos na nota de entrega e na etiqueta do produto são idênticos?
- As mercadorias estão em perfeito estado?
- Os dados na etiqueta de identificação correspondem às especificações do pedido na nota de entrega?
- Se exigido (consulte etiqueta de identificação), as instruções de segurança (XA) são fornecidas?
- Se uma dessas condições não for atendida, entre em contato com seu escritório de vendas Endress+Hauser.

4.1.1 Identificação do produto

As sequintes opções estão disponíveis para identificação do equipamento:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Código do pedido estendido com detalhamento dos recursos do equipamento na nota de remessa
- ► Insira o Número de série a partir das etiquetas de identificação em*W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer)
 - Todas as informações do medidor e o respectivo escopo da documentação técnica são exibidos.
- ► Insira o número de série na etiqueta de identificação no *Aplicativo de Operações da Endress* +*Hauser* ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação.
 - Todas as informações do medidor e o respectivo escopo da documentação técnica são exibidos.

4.1.2 Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Alemanha

Local de fabricação: consulte a etiqueta de identificação.

4.2 Transporte, armazenamento e descarte

4.2.1 Condições de armazenamento

Embale o equipamento de tal forma que fique protegido contra impactos para armazenamento e transporte. A embalagem original oferece a melhor proteção para isso. A temperatura de armazenamento permitida é de:

Cristal de iodeto

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

Cintilador PVT (padrão)

-40 para +60 °C (-40 para +140 °F)

Cintilador PVT (versão de alta temperatura)

-20 para +80 °C (−4 para +176 °F)



Como há uma bateria contida no equipamento, recomenda-se armazenar o equipamento em temperatura ambiente em um local que não receba luz direta do sol

4.2.2 Transportando para o ponto de medição

A CUIDADO

Risco de ferimentos

 Siga as instruções de segurança e as condições de transporte para os equipamentos que pesem acima de 18 kg (39.69 lb).

4.2.3 Descarte



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), nossos produtos são identificados com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Esses produtos não podem ser descartados como lixo comum e podem ser devolvidos à Endress+Hauser para que seja descartado de acordo com as condições estipulados em nossos Termos e condições gerais ou como acordado individualmente.

Descarte da bateria

- O usuário final é obrigado por lei a devolver as baterias usadas.
- O usuário final pode devolver as baterias antigas ou conjuntos eletrônicos contendo essas baterias para a Endress+Hauser gratuitamente.



De acordo com a lei alemã que regula o uso de baterias (BattG §28 Para 1 Number 3), esse símbolo é usado para identificar conjuntos elétricos que não devem ser descartados como lixo comum.

5 Instalação

AATENÇÃO

▶ Os quatro parafusos que conectam o tubo do detector ao terminal não podem ser abertos.



0038007

5.1 Requisitos de instalação

5.1.1 Informações gerais

- O ângulo de emissão do contêiner deve estar exatamente alinhado à faixa de medição do Gammapilot FMG50. Observe as marcações da faixa de medição do equipamento.
- O contêiner e o Gammapilot FMG50 devem ser instalados o mais próximo possível do recipiente. Qualquer acesso à barra deve ser bloqueado para certificar que não seja possível entrar nesta área.
- O Gammapilot FMG50 deve ser protegido contra a luz direta do sol ou calor do processo, a fim de aumentar sua vida útil.
 - Recurso 620, opção PA: "Capa de proteção contra intempéries 316 L"
 - Recurso 620. opcão PV: "Proteção térmica 1200-3000 mm, PVT"
 - Recurso 620, opção PW: "Proteção térmica Nal, 200-800 mm, PVT"
- Terminais podem ser opcionalmente solicitados junto ao equipamento
- O equipamento de montagem deve estar instalado tal forma que possa suportar o peso do Gammapilot FMG50 em todas as condições de operação previstas (por exemplo, vibrações).
- Mais informações sobre o uso relacionadas à segurança do Gammapilot FMG50 podem ser encontradas no Manual de segurança funcional.

Além das dimensões e pesos, os requisitos de instalação para medição de nível e medição de nível pontual são descritos na seção sequinte.


Requisitos de instalação para

- Medição de densidade
- Medição de interface
- Medição de perfil de densidade (DPS density profile measurement)
- Medição da concentração
- Medição de concentração com meio irradiado
- Medicões de vazão

estão descritas nas Instruções de Operação.

5.1.2 Dimensões, pesos

Gammapilot FMG50

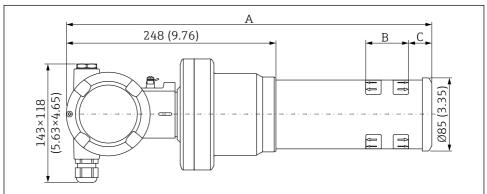

Δ0037984

■ Versão NaI (Tl) 2":

- Comprimento total A: 430 mm (16.93 in)
- Peso total: 11.60 kg (25.57 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 51 mm (2 in)
- Distância C: 24 mm (0.94 in)

■ Versão NaI (Tl) 4":

- Comprimento total A: 480 mm (18.90 in)
- Peso total: 12.19 kg (26.87 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 102 mm (4 in)
- Distância C: 24 mm (0.94 in)

■ Versão NaI (Tl) 8":

- Comprimento total A: 590 mm (23.23 in)
- Peso total: 13.00 kg (28.63 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 204 mm (8 in)
- Distância C: 30 mm (1.18 in)

■ PVT versão 200:

- Comprimento total A: 590 mm (23.23 in)
- Peso total: 12.10 kg (26.68 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 200 mm (8 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)

■ PVT versão 400:

- Comprimento total A: 790 mm (31.10 in)
- Peso total: 13.26 kg (29.23 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 400 mm (16 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)

PVT versão 800:

- Comprimento total A: 1190 mm (46.85 in)
- Peso total: 15.54 kg (34.26 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 800 mm (32 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)

PVT versão 1200:

- Comprimento total A: 1590 mm (62.60 in)
- Peso total: 17.94 kg (39.55 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 1200 mm (47 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)

PVT versão 1600:

- Comprimento total A: 1990 mm (78.35 in)
- Peso total: 20.14 kg (44.40 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 1600 mm (63 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)

■ PVT versão 2000:

- Comprimento total A: 2390 mm (94.09 in)
- Peso total: 22.44 kg (49.47 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 2 000 mm (79 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)

■ PVT versão 2400:

- Comprimento total A: 2 790 mm (109.84 in)
- Peso total: 24.74 kg (54.54 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 2 400 mm (94 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)

PVT versão 3000:


- Comprimento total A: 3 390 mm (133.46 in)
- Peso total: 28.14 kg (62.04 lb)
- Comprimento da faixa de medição B: 3 000 mm (118 in)
- Distância C: 41 mm (1.61 in)
- Os dados de peso referem-se às versões do invólucro de aço inoxidável. As versões de invólucro de alumínio são 2.5 kg (5.51 lb) mais leves.
- O peso adicional para peças pequenas é: 1 kg (2.20 lb)
- Se estiver usando um colimador, preste atenção à documentação SD02822F.

5.1.3 Requisitos de instalação para medições de nível

Condições

- O Gammapilot FMG50 é montado verticalmente para medições de nível.
- Para facilitar a instalação e o comissionamento, o Gammapilot FMG50 pode ser configurado e solicitado com um suporte adicional (peça o recurso 620, opção Q4: "Suporte de retenção").

Exemplos

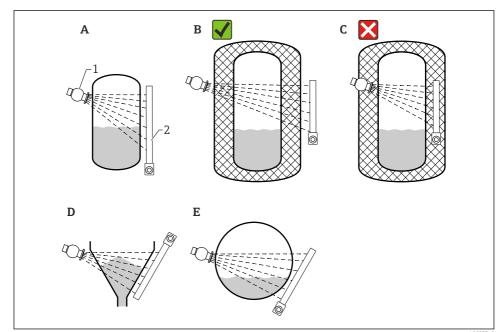


- A0037715
- A Cilindro vertical; o Gammapilot FMG50 é montado verticalmente com a cabeça do detector apontando para baixo ou para cima, a radiação gama é alinhada à faixa de medição.
- B Correto: Gammapilot FMG50 montado fora do isolamento do tanque
- C Incorreto: Gammapilot FMG50 montado dentro do isolamento do tanque
- D Saída cônica do tanque
- E Cilindro horizontal
- 1 Contêiner
- 2 Gammapilot FMG50

5.1.4 Requisitos de instalação para medições de nível pontual

Condições

Para detecção do nível pontual, o Gammapilot FMG50 geralmente é montado horizontalmente na altura do limite do nível desejado.

Disposição do sistema de medição

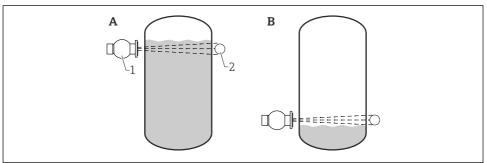

A0018075

- A Detecção do nível pontual máximo
- B Detecção do nível pontual mínimo
- 1 Contêiner
- 2 Gammapilot FMG50

6 Conexão elétrica

6.1 Requisitos de conexão


▲ ATENÇÃO

Observe o seguinte antes da conexão:

- ► Se o equipamento for usado em áreas classificadas, certifique-se de que ele esteja em conformidade com as normas nacionais e as especificações das Instruções de Segurança (XAs). O prensa-cabo especificado deve ser utilizado.
- ► A fonte de alimentação deve corresponder às especificações na etiqueta de identificação.
- ▶ Deslique a fonte de alimentação antes de realizar a conexão do equipamento.
- Conecte a linha de adequação de potencial ao terminal de terra externo do transmissor antes da conexão do equipamento.
- ▶ Conecte o aterramento de proteção ao terminal de terra de proteção.
- Os cabos devem ser adequadamente isolados, com a devida consideração à fonte de alimentação e à categoria de sobretensão.
- ▶ Os cabos de conexão devem oferecer estabilidade de temperatura adequada, com a devida consideração à temperatura ambiente.

6.1.1 4 para 20 mA Conexão HART

Conexão do equipamento com a comunicação HART, fonte de alimentação e display 4 para 20 mA

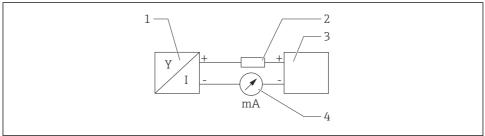

A0028908

- 1 Diagrama do bloco da conexão HART
- 1 Equipamento com comunicação HART
- 2 Resistor HART
- 3 Fonte de alimentação
- 4 Multímetro ou amperímetro
- Fonte de alimentação
 - Não Ex: fonte de alimentação: 16 para 35 VCC
 - Ex-i: fonte de alimentação: 16 para 30 VCC
- O resistor de comunicação HART de 250 Ω na linha de sinal é sempre necessário no caso de uma fonte de alimentação de baixa impedância.

A queda de tensão a ser levada em conta é:

Máx. 6 V para resistor de comunicação de 250 Ω

6.1.2 Seção transversal calculada

Aterramento de proteção ou aterramento da blindagem do cabo: seção transversal calculada $> 1~\text{mm}^2$ (17 AWG)

Seção transversal calculada de 0,5 mm² (AWG20) a 2,5 mm² (AWG13)

6.2 Conexão do equipamento

▲ ATENÇÃO


- Consulte a documentação separada sobre aplicações em áreas classificadas para mais instruções de segurança
- Para compatibilidade eletromagnética ideal, a linha de adequação de potencial deve ser o mais curta possível e ter, no mínimo, 2,5 mm² (14 AWG) em seção transversal.
- Os cabos de conexão devem ser passados longe do invólucro pela parte de baixo para evitar que a umidade entre no compartimento de conexão. Caso contrário, um laço de gotejamento deve ser providenciado ou uma tampa de proteção contra tempo deve ser utilizada.
- Siga as instruções de instalação que acompanham, se uma entrada G1/2 for utilizada.
- Rosca do invólucro

A rosca dos componentes eletrônicos e compartimento de conexão é revestida com verniz lubrificante.

X Evite lubrificação adicional.

6.2.1 Conexão direta

1.




A0038024

1 Terminal de terra para conexão da linha de equalização de potencial

Conecte a linha de equalização de potencial ao terminal de terra.

2.



A0038877


1 Equipamento de conexão

Solte a trava da tampa do compartimento de conexão.

3. Desaparafuse a tampa.

16

4.




A0038156

- 1 Entrada para cabo
- 2 Conector modelo

Guie os cabos nos prensa-cabos ou entradas de cabos.



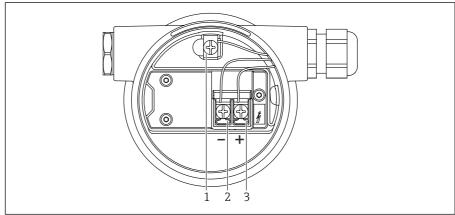

A003889

- \blacksquare 2 Os terminais de conexão e os terminais de terra no compartimento de conexão
- 1 Terminal de terra interno (para aterrar a blindagem do cabo)
- 2 Terminal negativo
- 3 Terminal positivo


Conecte o cabo.

- 6. Aperte os prensa-cabos ou as entradas para cabos de forma que eles fiquem estanques.
- 7. Parafuse a tampa firmemente de volta ao compartimento de conexão.
- 8. Aperte a trava da tampa.

6.2.2 Conexão com conector fieldbus

No caso de versões de dispositivos com um conector fieldbus, o invólucro não precisa ser aberto para estabelecer a conexão.

Atribuição do pino para o conector M12-A



A0011175

Pino:Sinal+

1

Pino: Não usado

2

Pino:Sinal-


3

Pino: Aterramento

4

Material: CuZn, contatos folheados a ouro da tomada plug-in e conector

6.2.3 Conexão com um conector Harting Han7D

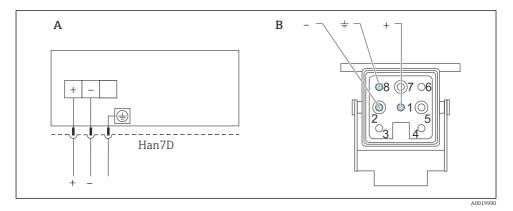

- A Conexão elétrica para equipamentos com conector Harting Han7D
- B Visualização da conexão no equipamento


Material: CuZn, contatos folheados a ouro da tomada plug-in e conector

6.3 Conectando uma unidade de operação



Para descrições das unidades operacionais individuais, consulte as Instruções de Operação.

Uma ampla gama de unidades de operação está disponível para operar o equipamento através de protocolo HART . A conexão dessas unidades está ilustrada no diagrama abaixo.

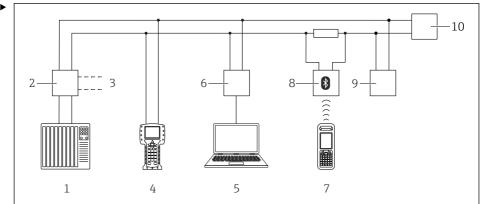

Δ0039185

■ 3 Opções para operação remota através do protocolo HART

- 1 PLC (Controlador lógico programável)
- 2 Unidade da fonte de alimentação do transmissor, por exemplo RN221N (com resistor de comunicação)
- 3 Conexão para Commubox FXA191, FXA195 e Field Communicator 375, 475
- 4 Comunicador de campo 475
- 5 Computador com ferramenta de operações (por exemplo, DeviceCare/FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA191 (RS232) ou FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350/SFX370
- 8 Modem VIATOR Bluetooth com cabo de conexão
- 9 RIA15
- 10 Equipamento (FMG50)

Conecte uma ou mais unidades de operação ao equipamento.

7 Comissionamento

7.1 Verificação pós-instalação e pós-conexão

Execute a verificação de pós-instalação e a verificação pós-conexão para o FMG50 antes do comissionamento do ponto de medição.

Você pode redefinir o equipamento para os ajustes de fábrica em caso de erro.

7.1.1 Restabelecendo a configuração padrão (reset)

A CUIDADO

- ▶ Um reset pode impactar negativamente a medição. Como regra geral, uma configuração básica deve ser executada novamente após uma redefinição. Todos os dados de calibração são excluídos após um reset. Uma nova calibração completa é necessária para colocar a medição novamente em operação.
- 1. Conecte o equipamento ao FieldCare ou ao DeviceCare.
- 2. Abra o equipamento no FieldCare ou no DeviceCare.
 - É exibido o painel (página inicial) do equipamento: Clique em "Sistema -> Gerenciamento de equipamento"



3. Faça o reset do equipamento no parâmetro "Reset do equipamento"

Os seguintes tipos de reset podem ser selecionados:

• Redefinir equipamento

A reset simples é executado aqui. O software do equipamento executa todos os diagnósticos que também seriam executados por um reset mais complexo, ligando/desligando o equipamento.

Reset para o padrão de fábrica

É sempre aconselhável proceder o reset dos parâmetros do cliente se quiser usar o equipamento com um histórico desconhecido, ou se o modo de operação for alterado. Quando um reset é executado, todos os parâmetros do cliente são restabelecidos para os valores padrão de fábrica

Opcional: reset para as configurações do cliente


Se o equipamento foi solicitado com uma configuração personalizada, um reset restaura essas configurações do cliente configuradas na fábrica.

Um reset também pode ser executado no local através das teclas de operação (consulte a seção "Comissionamento através de operação no local").

7.2 Comissionamento usando o assistente

Um assistente é disponibilizado em FieldCare ou DeviceCare ¹⁾ que orienta o usuário através do processo de comissionamento inicial.

- 1. Conecte o equipamento ao FieldCare ou ao DeviceCare.
- 2. Abra o equipamento no FieldCare ou no DeviceCare.
 - ► É exibido o painel (página inicial) do equipamento:

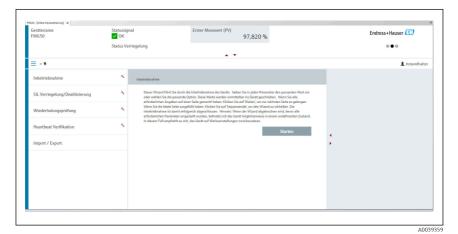

■ 4 Captura de tela: Assistente de comissionamento

- 3. Clique em "Comissionamento" para iniciar o assistente.
- 4. Insira o valor apropriado em cada parâmetro ou selecione a opção apropriada. Esses valores são gravados diretamente no equipamento.
- 5. Clique em "Próximo" para ir até a próxima página.
- Quando todas as páginas forem preenchidas, clique em "Concluir" para fechar o Assistente.
- Se cancelar o Assistente antes de inserir todos os parâmetros necessários, o equipamento pode ficar em um estado indefinido. Nessas situações, recomendamos redefinir o equipamento com as configurações padrões de fábrica.

7.3 Operação

7.3.1 Operação através do FieldCare/DeviceCare

FieldCare/DeviceCare é uma ferramenta de gerenciamento de ativos da Endress+Hauser com base em tecnologia FDT. Com o FieldCare/DeviceCare, é possível configurar todos os equipamentos Endress+Hauser, bem como todos os equipamentos de outros fabricantes que

FieldCare e DeviceCare estão disponíveis para download em www.software-products.endress.com. Para realizar o download do software, é necessário registrar-se no portal do software da Endress+Hauser

apoiem o padrão FDT. Especificações de hardware e software podem ser encontrados na internet:

www.de.endress.com -> Pesquisa: FieldCare -> FieldCare -> Dados técnicos

O FieldCare suporta as sequintes funções:

- Configuração dos transmissores em modo online
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (upload/download)
- Documentação do ponto de medição

Opções de conexão:

- HART através de Commubox FXA195 e porta USB em um computador
- Commubox FXA291 através da interface de operação

7.3.2 Operação através do aplicativo SmartBlue

Especificações

Especificações de equipamento

O comissionamento através do SmartBlue só é possível se o equipamento tiver um módulo Bluetooth.

Especificações do sistema SmartBlue


SmartBlue está disponível para download a partir do Google Play Store para dispositivos Android e da iTunes Store para dispositivos iOS.

- Equipamentos com iOS: iPhone 4S ou superior a iOS9.0; iPad2 ou superior a iOS9.0; iPod Touch 5º geração ou superior a iOS9.0
- Equipamentos com Android:
 A partir de Android 4.4 KitKat e Bluetooth® 4.0

Senha inicial

O número de série do equipamento é usado como a senha inicial ao estabelecer a conexão pela primeira vez. O número de série pode ser encontrado na etiqueta de identificação.

Aplicativo SmartBlue

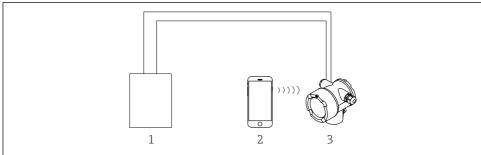

A0038833

- 5 Operação através de SmartBlue (aplicativo)
- 1 Unidade da fonte de alimentação do transmissor
- 2 Smartphone / tablet com SmartBlue (aplicativo)
- 3 Transmissor com módulo Bluetooth
- 1. Escaneie o código QR ou digite "SmartBlue" no campo de pesquisa da App Store.



A0039186

- E 6 Link para download
- 2. Iniciar o SmartBlue.
- 3. Selecione o equipamento na lista exibida.
- 4. Digite os dados de login:
 - Nome do usuário: admin Senha: número de série do equipamento ou número ID do display Bluetooth Um símbolo Bluetooth piscante indica que uma conexão Bluetooth está disponível.
- 5. Toque nos ícones para mais informações.

Para comissionamento, consulte a seção "Assistente de comissionamento"

- Mude a senha depois de logar pela primeira vez!
- O Bluetooth não está disponível em todos os mercados.


 Preste atenção às aprovações de rádio listadas no documento SD02402F ou entre em contato com a organização de vendas da Endress+Hauser.

7.3.3 Operação através do display local



A operação através de teclas estará ativa apenas se um display não estiver instalado

O equipamento também pode ser operado no local usando as teclas. Se a operação estiver bloqueada através das minisseletoras no local, a entrada de parâmetros através da comunicação não será possível.

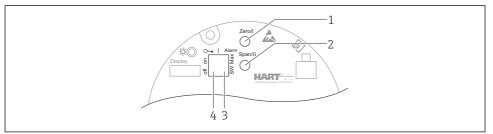

A0039285

- 1 Tecla de operação para calibração vazio (função I)
- 2 Tecla de operação para calibração cheio (função II)
- 3 Minisseletora para corrente de alarme (Definida pelo SW / alarme mín.)
- 4 Minisseletora para bloqueio e desbloqueio do medidor
- Calibração vazio: Pressione e segure a tecla de operação para calibração vazio (I) > 3 s
- Calibração cheio: Pressione e segure a tecla de operação para calibração cheio (II) > 3 s
- **Calibração de fundo:** Pressione e segure simultaneamente a tecla de operação para calibração vazio (I) e a tecla de operação para calibração cheio (II) > 3 s
- Reset para os padrões de fábrica: Pressione e segure simultaneamente a tecla de operação para calibração vazio (I) e calibração cheio (II) > 12 s. O LED começa a piscar. Quando para de piscar, o equipamento é redefinido com as configurações padrão de fábrica.

Nível básico de calibração

Tempo de calibração por calibração: 5 min!

- 1. Redefinir
 - Pressione as teclas > 12 s
- 2. Inicie a calibração de fundo
 - Pressione as teclas > 3 s
 O LED verde acende por um segundo e começa a piscar em um intervalo de 2 s
- 3. Inicie a calibração vazio
 - Pressione a tecla "Zero / 1"> 3 s
 O LED verde acende por um segundo e começa a piscar em um intervalo de 2 s
 Aguarde 5 min até que o LED vermelho pare de piscar

- 4. Inicie a calibração cheio
 - Pressione a tecla "Span / 2" > 3 s

 O LED verde acende por um segundo e começa a piscar em um intervalo de 2 s

 Aguarde 5 min até que o LED vermelho pare de piscar

Im reset exclui todas as calibrações!

LEDs de status e de energia


Um LED verde que sinaliza o status e o feedback de ativação do botão é fornecido na unidade eletrônica.

Comportamento do LED

- O LED pisca brevemente uma vez quando o equipamento é iniciado
- Quando uma tecla é pressionada, o LED pisca para confirmar a ativação da tecla
- Quando um reset é executado, o LED pisca enquanto as duas teclas são pressionadas e o reset ainda não está ativo (contagem regressiva). O LED para de piscar quando o reset está ativo.
- O LED pisca quando a calibração está sendo executada por meio de operação no local

7.3.4 Operação através de interface de operação

DeviceCare/FieldCare através da interface de operação (CDI)

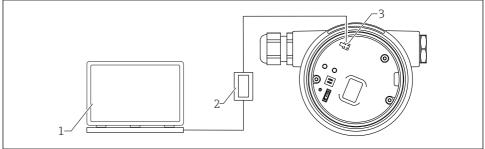

A003883

- 7 DeviceCare/FieldCare através da interface de operação (CDI)
- 1 Computador com ferramenta de operação DeviceCare/FieldCare
- 2 Commubox FXA291
- 3 Interface de serviço (CDI) do equipamento (= Endress+Hauser Interface de Dados Comuns)

7.3.5 Operação através de WirelessHART

Adaptador WirelessHART SWA70 com o Commubox FXA195 e o programa de operação "FieldCare/DeviceCare"

7.3.6 Características gerais do menu de operação

As características gerais completas do menu de operação estão disponíveis na documentação "Descrição dos parâmetros de equipamento".



GP01141F





www.addresses.endress.com