

Kurzanleitung

Raman-Spektroskopiesonde Rxn-46



Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung. Sie ist kein Ersatz für die gerätespezifische Betriebsanleitung.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	5
1.1	Haftungsausschluss.....	5
1.2	Warnungen	5
1.3	Symbole	6
1.4	Konformität mit US-amerikanischen Exportvorschriften.....	6
2	Grundlegende Sicherheitshinweise	7
2.1	Anforderungen an das Personal	7
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.3	Sicherheit am Arbeitsplatz	7
2.4	Betriebssicherheit.....	8
2.5	Lasersicherheit.....	8
2.6	Wartungssicherheit.....	9
2.7	Wichtige Sicherheitsvorkehrungen.....	9
2.8	Produktsicherheit	9
3	Produktbeschreibung.....	12
3.1	Rxn-46-Sonde.....	12
3.2	Hardware und Zubehör.....	12
4	Warenannahme und Produktidentifizierung	14
4.1	Warenannahme	14
4.2	Produktidentifizierung	14
4.3	Lieferumfang	15
5	Sonden- und LWL-Anschluss	16
5.1	Elektrooptisches Faserkabel.....	16
5.2	Faserkabelbaugruppe	16
5.3	Handhabung des LWL-Kabels.....	17
6	Montage	19
6.1	Kompatibilität der Analysatoren	19
6.2	Anschluss an das Ambr [®] -Analysemodul	19
6.3	Anschluss an Biostat STR [®] Einweg-Bioreaktoren.....	20
6.4	Anschluss an den Biostat STR [®] Single-Use-Port.....	20
7	Inbetriebnahme.....	21
7.1	Annahme der Sonde.....	21
7.2	Sondenkalibrierung und -verifizierung	21



8	Betrieb	22
8.1	Rxn-46-Sonde.....	22
8.2	Integration in die Ambr®-Software.....	22
8.3	Kompatibilität mit Biostat STR®	22
9	Diagnose und Störungsbehebung.....	23

1 Hinweise zum Dokument





1.1 Haftungsausschluss

Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung; sie ersetzt in keinem Fall die im Lieferumfang enthaltene Betriebsanleitung.

1.2 Warnungen

Struktur des Hinweises	Bedeutung
<p> WARNUNG</p> <p>Ursache (/Folgen) Folgen einer Missachtung (wenn zutreffend) ▶ Abhilfemaßnahme</p>	<p>Dieses Symbol macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wird die gefährliche Situation nicht vermieden, kann dies zu Tod oder schweren Verletzungen führen.</p>
<p> VORSICHT</p> <p>Ursache (/Folgen) Folgen einer Missachtung (wenn zutreffend) ▶ Abhilfemaßnahme</p>	<p>Dieses Symbol macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Wird die gefährliche Situation nicht vermieden, kann dies zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen.</p>
<p>HINWEIS</p> <p>Ursache/Situation Folgen einer Missachtung (wenn zutreffend) ▶ Maßnahme/Hinweis</p>	<p>Dieses Symbol macht auf Situationen aufmerksam, die zu Sachschäden führen können.</p>

1.3 Symbole

Symbol	Beschreibung
	Das Symbol für Laserstrahlung macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass bei der Verwendung des Systems die Gefahr besteht, schädlicher sichtbarer Laserstrahlung ausgesetzt zu werden.
	Das Symbol für Hochspannung macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass ein ausreichend hohes elektrisches Potenzial vorliegt, um Körperverletzungen oder Sachschäden zu verursachen. In manchen Industrien bezieht sich der Begriff Hochspannung auf Spannungen oberhalb eines bestimmten Schwellwerts. Betriebsmittel und Leiter, die hohe Spannungen führen, erfordern besondere Sicherheitsanforderungen und Vorgehensweisen.
	Das WEEE-Symbol gibt an, dass das Produkt nicht im Restmüll entsorgt werden darf, sondern zum Recycling an eine separate Sammelstelle zu senden ist.
	Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt die Normen für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erfüllt, die für alle Produkte gelten, die im Europäischen Wirtschaftsraum verkauft werden.

1.4 Konformität mit US-amerikanischen Exportvorschriften

Die Richtlinie von Endress+Hauser schreibt die strikte Erfüllung der US-amerikanischen Gesetze zur Exportkontrolle vor, wie sie auf der Website des [Bureau of Industry and Security](#) des U.S. Department of Commerce detailliert aufgeführt werden.

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Messeinrichtung dürfen nur durch speziell dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen.
- Das Fachpersonal muss vom Anlagenbetreiber für die genannten Tätigkeiten autorisiert sein.
- Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung befolgen.
- Der Anlagenbetreiber muss einen Beauftragten für Lasersicherheit benennen, der sicherstellt, dass die Mitarbeiter zu Betriebsabläufen und Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Lasern der Klasse 3B geschult sind.
- Störungen an der Messstelle dürfen nur von entsprechend autorisiertem und dafür ausgebildetem Personal behoben werden. Reparaturen, die nicht in diesem Dokument beschrieben sind, dürfen nur direkt beim Hersteller oder durch die Serviceorganisation durchgeführt werden.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Raman-Spektroskopiesonde Rxn-46 wurde für die Labor- und Prozessanalyse von Flüssigkeiten konzipiert.

Zu den empfohlenen Anwendungen mit Zellkulturen gehören: Glukose, Laktat, Aminosäuren, Zelldichte, Titer und mehr.

Eine andere als die beschriebene Verwendung gefährdet die Sicherheit von Personen und der gesamten Messeinrichtung und setzt die Gewährleistung außer Kraft.

2.3 Sicherheit am Arbeitsplatz

Der Benutzer ist für die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen verantwortlich:

- Montageanleitungen
- Lokale Normen und Vorschriften bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit

Das Produkt ist gemäß den gültigen internationalen Normen für den Industriebereich auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft.

Die angegebene elektromagnetische Verträglichkeit gilt nur für ein Produkt, das ordnungsgemäß an den Analysator angeschlossen wurde.

2.4 Betriebssicherheit

Vor der Inbetriebnahme der Messstelle:

1. Alle Anschlüsse auf ihre Richtigkeit prüfen.
2. Sicherstellen, dass die elektrooptischen Kabel unbeschädigt sind.
3. Sicherstellen, dass der Füllstand des Mediums ausreicht, um die Sonde oder die Optik einzutauchen (wenn zutreffend).
4. Beschädigte Produkte nicht in Betrieb nehmen und vor versehentlicher Inbetriebnahme schützen.
5. Beschädigte Produkte als defekt kennzeichnen.

Im Betrieb:

1. Können Störungen nicht behoben werden, müssen die Produkte außer Betrieb gesetzt und vor versehentlicher Inbetriebnahme geschützt werden.
2. Bei der Arbeit mit Geräten, die Laser enthalten, immer alle lokalen Protokolle zur Lasersicherheit einhalten; diese können vorschreiben, dass Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu verwenden und der Zugang zum Gerät auf autorisierte Benutzer zu beschränken ist.

2.5 Lasersicherheit

Die Raman Rxn-Analysatoren verwenden Laser der Klasse 3B, wie sie in folgenden Normen definiert sind:

- [American National Standards Institute](#) (ANSI) Z136.1, American National Standard for Safe Use of Lasers
- [International Electrotechnical Commission](#) (IEC) 60825-1, Safety of Laser Products – Part 1

WARNUNG

Laserstrahlung


- ▶ Strahlenexposition vermeiden
- ▶ Laserprodukt der Klasse 3B

VORSICHT

Laserstrahlen können zur Entzündung bestimmter Substanzen, wie z. B. flüchtiger organischer Verbindungen, führen.

Die beiden Möglichkeiten für eine Entzündung sind ein direktes Erhitzen der Probe bis zu einem Punkt, an dem sie sich entzündet, und das Erhitzen einer Verunreinigung (z. B. Stäube) bis zu einem kritischen Punkt, der zur Entzündung der Probe führt.

Die Laserkonfiguration stellt weitere Risiken für die Sicherheit dar, da die Strahlung nahezu unsichtbar ist. Der Benutzer muss sich stets der ursprünglichen Richtung und der möglichen Streuwege des Lasers bewusst sein. Bei Anregungswellenlängen von 532 nm und 785 nm wird die Verwendung von OD3-Laserschutzbrillen oder höher dringend empfohlen. Bei einer Anregungswellenlänge von 993 nm wird OD4 oder höher empfohlen.

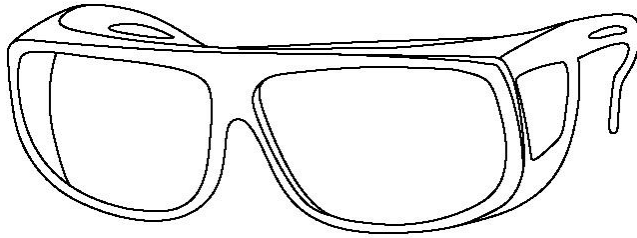

A0048421

Abbildung 1. Laserschutzbrille

Nähere Informationen zu geeigneten Vorsichtsmaßnahmen und dem Einrichten passender Kontrollen für den Umgang mit Lasern und ihren Gefahren sind in der aktuellsten Version der ANSI Z136.1 oder der IEC 60825-14 zu finden.

2.6 Wartungssicherheit

Wenn eine Prozesssonde zur Wartung von der Prozessschnittstelle entfernt werden muss, immer die Sicherheitshinweise des Unternehmens einhalten. Beim Warten des Geräts stets die geeignete Schutzausrüstung tragen.

2.7 Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Die Rxn-46-Sonde nicht zu anderen Zwecken, sondern nur bestimmungsgemäß einsetzen.
- Nicht direkt in den Laserstrahl blicken.
- Den Laser nicht auf verspiegelte oder glänzende Oberflächen oder eine Oberfläche, die diffuse Reflexionen verursachen kann, richten. Der reflektierte Strahl ist genauso schädlich wie der direkte Strahl.
- Angeschlossene und nicht verwendete Sonden immer mit Kappen oder anderweitigem Schutz blockieren.
- Immer eine Strahlensperre verwenden, um eine unbeabsichtigte Streuung der Laserstrahlung zu vermeiden.

2.8 Produktsicherheit

Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, alle aktuellen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, wurde geprüft und ab Werk in einem sicheren Betriebszustand ausgeliefert. Die einschlägigen Vorschriften und internationalen Normen sind berücksichtigt. An den Analysator angeschlossene Geräte müssen ebenfalls die gültigen Sicherheitsstandards für Analysatoren erfüllen.

Die Raman-Spektroskopiesysteme von Endress+Hauser umfassen folgende Sicherheitsvorrichtungen, um die United States Government Requirements [21 Code of Federal Regulations \(CFR\) Chapter 1, Subchapter J](#), wie vom [Center for Devices and Radiological Health \(CDRH\)](#) verwaltet, und die IEC 60825-1, wie von der [International Electrotechnical Commission](#) verwaltet, zu erfüllen.

2.8.1 CDRH- und IEC-Konformität

Die Raman-Analysatoren von Endress+Hauser wurden von Endress+Hauser zertifiziert, um die CDRH-Anforderungen sowie die Sicherheitsnormen der IEC 60825-1 für den internationalen Einsatz zu erfüllen.

Die Raman-Analysatoren von Endress+Hauser wurden beim CDRH registriert. Sämtliche nicht autorisierten Änderungen an einem bestehenden Raman Rxn-Analysator oder dessen Zubehör können zu einer gefährlichen Strahlenexposition führen. Zudem können derartige Änderungen dazu führen, dass das System nicht länger mit den bundesrechtlichen Anforderungen konform ist, für die es von Endress+Hauser zertifiziert wurde.

2.8.2 Lasersicherheitsverriegelung

Die montierte Rxn-46-Sonde ist Bestandteil des Verriegelungskreises. Bei dem Verriegelungskreis handelt es sich um eine elektrische Niederspannungsschleife. Wenn es zu einem Bruch des Faserkabels kommt, schaltet sich der Laser innerhalb von Millisekunden nach dem Bruch aus.

HINWEIS

Werden Kabel nicht ordnungsgemäß verlegt, kann es zu einer dauerhaften Beschädigung kommen.

- ▶ Sonden und Kabel vorsichtig behandeln und sicherstellen, dass sie nicht geknickt werden.
- ▶ Faserkabel mit einem Mindestbiegeradius gemäß Dokument *Raman-LWL-Kabel Technische Information (TI01641C)* montieren.

Der Verriegelungsstecker des Faserkabels muss an der Verriegelungsbuchse auf dem Raman Rxn-Analysator angeschlossen werden und wird automatisch verbunden, wenn der Prozessanschluss des LWL-Kabels an der Rxn-46-Sonde angeschlossen wird. Wenn die Möglichkeit besteht, dass der Laser mit Strom versorgt wird, dann leuchtet die Laserverriegelungsanzeige auf dem Sondenrumpf.

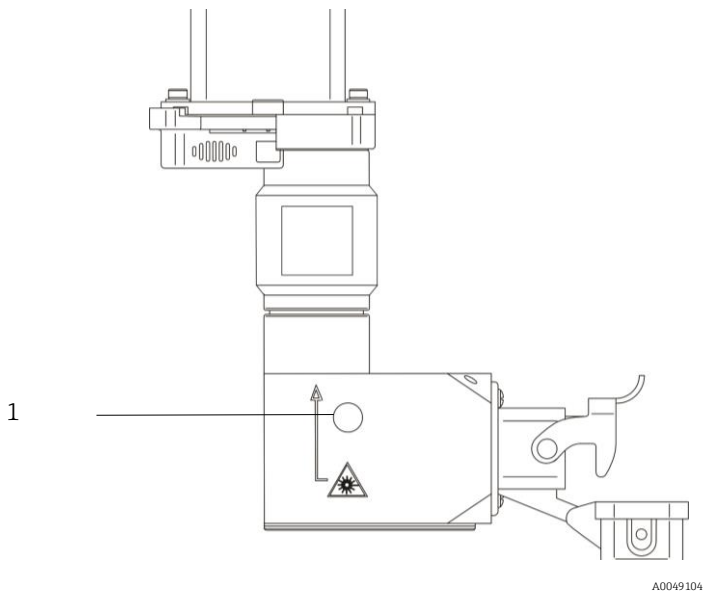


Abbildung 2. Position der Laserverriegelungsanzeige (1)

3 Produktbeschreibung

3.1 Rxn-46-Sonde

Die Raman-Spektroskopiesonde Rxn-46 mit Kaiser-Raman-Technologie ist eine angepasste Version der standardmäßigen Endress+Hauser Rxn-45-Bioprozesssonde. Sie wurde für die BioPAT® Spectro-Plattform von Sartorius optimiert. Durch diese Vereinigung von Plattformen steht eine ideale Schnittstelle für die Entwicklung von Prozessen mit hohem Durchsatz durch kommerzielle Single-Use-Fertigung zur Verfügung. Durch die Integration der Raman-Spektroskopie von Endress+Hauser in die multiparallelen Ambr®-Bioreaktoren sind Quality-by-Design (QbD)-Methoden möglich, die sich auf alle Größen von Biostat STR® Single-Use-Bioreaktoren skalieren lassen.

Die gleiche Rxn-46-Sondenbauf orm wird für die Ambr® 15-, Ambr® 250- und Biostat STR®-Bioreaktoren verwendet. Durch diese Kombination ist eine berührungslose Raman-Erfassung möglich, sodass keine Reinigung, Sterilisation oder häufige Sondenwartung erforderlich sind. Indem sie schnelle, zuverlässige und genaue Messungen der wichtigsten Prozessvariablen vom Labor bis zum Prozess bereitstellt, ermöglicht die Rxn-46-Sonde Bioprocessing-Unternehmen ein vereinfachtes Skalieren von der Entwicklung bis hin zu cGMP Produktion unter Einhaltung strenger Qualitätsstandards.


Die Rxn-46-Sonde ist kompatibel mit den folgenden Raman Rxn-Analysatoren von Endress+Hauser, die mit einer Wellenlänge von 785 nm arbeiten:

- Ambr®: einkanaliger Raman Rxn2-Analysator
- Biostat STR®: ein- oder vierkanalige Analysatoren Raman Rxn2 oder Rxn4

3.2 Hardware und Zubehör

3.2.1 Standard-Hardware und Zubehör

- Standard-Hardware und Zubehör für die Rxn-46-Sonde umfassen u. a.:
- Rxn-46-Sonde
- Kalibrier- und Verifizierungskit für die Rxn-46-Sonde

Die Rxn-46-Sonde wird über ein separat zu erwerbendes LWL-Kabel an den Raman Rxn-Analysator angeschlossen. Nähere Informationen zu den Optionen für LWL-Kabel siehe Sonden- und LWL-Anschluss → .

3.2.2 Zusätzliche Anforderungen für Ambr® 15 oder Ambr® 250

Für die Montage der Rxn-46-Sonde mit Ambr® 15 oder Ambr® 250 sind folgende Zusatzkomponenten und kompatiblen Analysatoren erforderlich:

- Lichtschutz für die Verwendung mit der Ambr®-Plattform (bei Endress+Hauser erhältlich)
- Einkanaliger Raman Rxn2-Analysator als Benchtop-Gerät mit integrierter Raman RunTime 6.2.2+ Software
- Touchscreen-Starter-Kit für Benchtop-Analysatoren

3.2.3 Zusätzliche Anforderungen für Biostat STR®

Für die Montage der Rxn-46-Sonde mit Biostat STR® sind folgende Zusatzkomponenten und kompatiblen Analysatoren erforderlich:

- Biostat STR® Flanschhalterung, Beutelanschluss und Schienenhalterung (bei Sartorius erhältlich)
- Ein- oder vierkanaliger Raman-Analysator Rxn2 oder Rxn4 mit integrierter Raman RunTime 6.2.2+ Software
- Entsprechende SIMCA-QPp predictor-Lizenz für die Anzahl der betriebsfähigen Analysatorkanäle
- Touchscreen-Starter-Kit

Nicht integrierte Raman Rxn-Analysatoren können zusätzliche Hardware und Software-Updates erfordern, um mit der Rxn-46-Sonde kompatibel zu sein.

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme

1. Auf unbeschädigte Verpackung achten. Beschädigungen an der Verpackung dem Lieferanten mitteilen. Beschädigte Verpackung bis zur Klärung aufbewahren.
2. Sicherstellen, dass der Inhalt unbeschädigt ist. Beschädigungen am Lieferinhalt dem Lieferanten mitteilen. Beschädigte Ware bis zur Klärung aufbewahren.
3. Lieferung auf Vollständigkeit prüfen. Lieferpapiere und Bestellung vergleichen.
4. Für Lagerung und Transport Produkt stoßsicher und gegen Feuchtigkeit geschützt verpacken. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz. Zulässige Umgebungsbedingungen unbedingt einhalten.

Bei Rückfragen an den Lieferanten oder das zuständige Vertriebsbüro wenden.

HINWEIS

Bei unsachgemäßer Verpackung kann die Sonde während des Transports beschädigt werden.

4.2 Produktidentifizierung

4.2.1 Typenschild

Die Sonde/Messstelle ist mindestens mit folgenden Informationen beschriftet:

- Endress+Hauser Logo
- Produktidentifizierung (z. B. Rxn-46)
- Seriennummer

Wo es die Größe erlaubt, sind auch folgende Informationen enthalten:

- Erweiterter Bestellcode
- Herstellerangaben
- Wesentliche funktionale Aspekte der Sonde (z. B. Material, Wellenlänge, Schärfentiefe)
- Sicherheitshinweise und Zertifizierungsinformationen, wenn zutreffend

Angaben auf dem Typenschild/Etikett mit der Bestellung vergleichen.

4.2.2 Herstelleradresse

Endress+Hauser
371 Parkland Plaza
Ann Arbor, MI 48103 USA

4.3 **Lieferumfang**

Im Lieferumfang enthalten:

- Rxn-46-Sonde
- Handbuch *Raman-Spektroskopiesonde Rxn-46 Betriebsanleitung*
- Rxn-46-Sonde Zertifikat über Produktleistung
- Lokale Konformitätserklärungen, wenn zutreffend
- Zubehör für die Rxn-46-Sonde, wenn zutreffend
- Werkstoffzertifikate, wenn zutreffend
- Kalibrier- und Verifizierungskit für die Rxn-46-Sonde

Bei Rückfragen an den zuständigen Lieferanten oder das lokale Vertriebsbüro wenden.

5 Sonden- und LWL-Anschluss

Die Rxn-46-Sonde wird über eine der folgenden Komponenten an den Raman Rxn-Analysator angeschlossen:


- **Ambr®:** EO-zu-EO-Faserkabel (elektrooptisch)
- **Biostat STR®:** EO-zu-EO-Faserkabel oder Faserkanal (FC)-zu-EO-Lichtwellenleiterkonverter für nicht integrierte Systeme

Das Faserkabel wird separat verkauft und ist in Inkrementen von 5 m (16,4 ft.) bis zu einer Gesamtlänge von 200 m (656,2 ft) erhältlich, wobei die Länge durch die Anwendung beschränkt wird.

Nähere Informationen zum Anschluss des Analysators siehe Betriebsanleitung zum entsprechenden Raman Rxn-Analysator.

5.1 Elektrooptisches Faserkabel

Das EO-zu-EO-Faserkabel verbindet die Rxn-46-Sonde mit dem integrierten Analysator über einen einzelnen, robusten Steckverbinder, der den Anregungs- und Erfassungslichtwellenleiter sowie eine elektrische Laserverriegelung enthält.

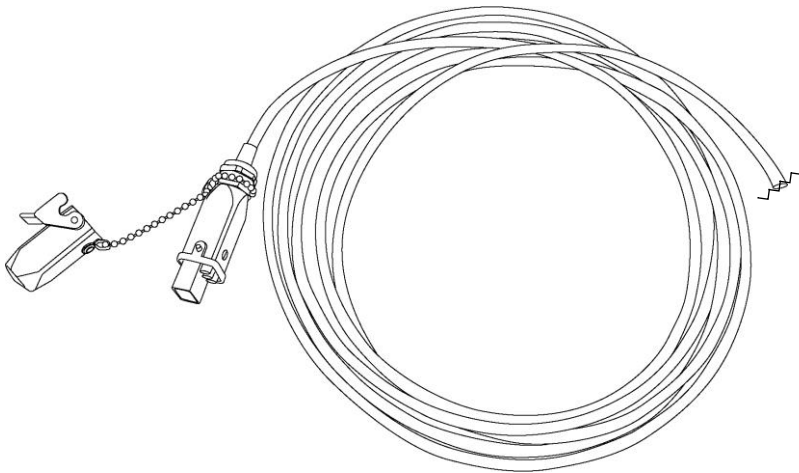

A00489938


Abbildung 3. EO-Faserkabel mit Steckverbinder für Analysator

5.2 Faserkabelbaugruppe

Die FC-Kabelbaugruppe verbindet die Rxn-46-Sonde über folgende Anschlüsse mit dem nicht integrierten Analysator:

- Elektrischer Verriegelungsschalter
- Gelbe (YE) Anregungsfaser für Laserausgang
- Rote (RD) Erfassungsfaser für Eingang zum Spektrografen

Ein FC-zu-EO-Faserkonverter verbindet das FC-Kabel mit der Rxn-46-Sonde.

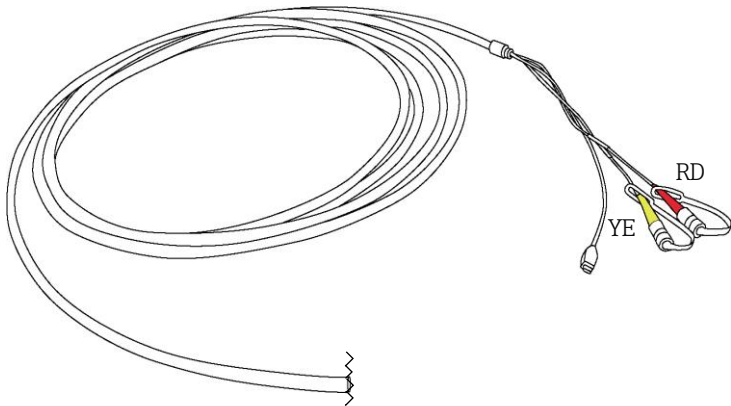

A0048939

Abbildung 4. FC-Kabelbaugruppe mit Steckverbinder für Analysator


5.3 Handhabung des LWL-Kabels

Die nachfolgenden Schritte befolgen, wenn es notwendig sein sollte, das LWL-Kabel abzuziehen und wieder anzuschließen.

HINWEIS

Die LWL-Kabel für den Anschluss der Rxn-46-Sonde an das Ambr[®]-System sollten, nachdem sie einmal montiert und vom Sartorius Service überprüft wurden, NICHT mehr abgezogen werden.

1. Wenn die Rxn-46-Sonde derzeit an einen Raman Rxn-Analysator angeschlossen ist, vor Montage der Sonde den Laser ausschalten (OFF) oder die Spannungsversorgung zum Analysator ausschalten (OFF).
2. LWL-Kabel von der Rxn-46-Sonde abziehen.
 - Anschlussclip lösen.
 - Den EO-Prozessanschluss am grauen Teil fassen und mit der anderen Hand gerade nach unten ziehen, um das LWL-Kabel abzuziehen.
3. Das LWL-Kabel wieder an der Rxn-46-Sonde anschließen.
 - Die gefederte Kappe auf dem Faseranschluss an der Basis der Rxn-46-Sonde öffnen.
 - Prozessanschluss in die Basis der Sonde einführen und hineindrücken, bis er fest sitzt.
 - Anschlussclip wieder einrasten lassen.
4. Wenn Analysator und Sonde einsatzbereit sind, den Laser und den Analysator einschalten (ON).
5. Nach einer Minute verifizieren, dass die Laserverriegelungsanzeige leuchtet.

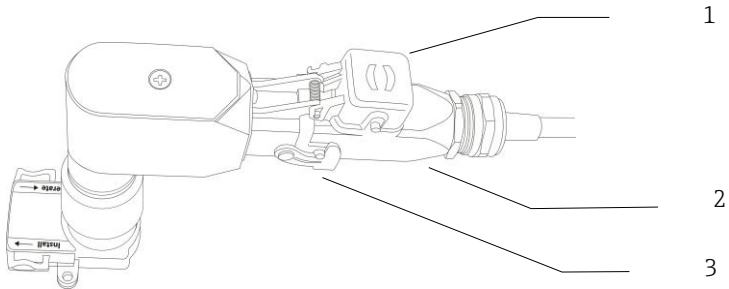

A0049105



Abbildung 5. Anschluss des LWL-Kabels

Pos.	Beschreibung
1	Gefederte Kappe für Faseranschluss
2	Prozessanschluss
3	Anschlussclip

6 Montage

Die Rxn-46-Sonde kann nur mit Komponenten verbunden werden, die mit dem BioPAT® Spectro-System von Sartorius kompatibel sind.

Während der Montage sind Standardsicherheitsvorkehrungen für Laserprodukte der Klasse 3B zum Schutz von Augen und Haut (gemäß EN 60825/IEC 60825-14) einzuhalten. Zusätzlich sind folgende Hinweise zu beachten:

 WARNUNG	<p>Die für Laserprodukte geltenden Standardvorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wenn die Sonden nicht in einer Probenkammer montiert sind, sollten sie immer mit Kappen abgedeckt, von Personen weg und auf ein diffuses Ziel gerichtet werden.
 VORSICHT	<p>Wenn Streulicht in eine nicht verwendete Sonde eindringen kann, dann beeinträchtigt dies die von einer verwendeten Sonde erfassten Daten und kann zu einem Fehlschlagen der Kalibrierung oder Messabweichungen führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nicht verwendete Sonden sind IMMER mit Kappen abzudecken, um zu verhindern, dass Streulicht in die Sonde gelangt.
HINWEIS	<p>Bei Montage der Sonde <i>in situ</i> muss der Benutzer sicherstellen, dass eine Zugentlastung am Montageort vorhanden ist, die die Spezifikationen für den Faserbiegeradius erfüllt.</p>


6.1 Kompatibilität der Analytoren

Die Rxn-46-Sonde ist kompatibel mit den unten aufgeführten Raman Rxn-Analysatoren von Endress+Hauser, die mit einer Wellenlänge von 785 nm arbeiten.

- Ambr® 15 und Ambr® 250: Raman Rxn2-Analysator, einkanalig; Benchtop
- Biostat STR®: Raman Rxn2- oder Rxn4-Analysatoren, bis zu vier Kanäle, Benchtop oder mobil auf Rollwagen (Raman Rxn2), im Rack oder in einem NEMA 4x Gehäuse (Raman Rxn4) montiert

6.2 Anschluss an das Ambr®-Analysemodul

Sartorius ist für die Montage der Rxn-46-Sonde mit Ambr®, inklusiver aller Hardware- und Softwareverbindungen, verantwortlich. Endress+Hauser kann keinen Support bei der Erstmontage, dem Abziehen oder Wiederanschließen von Rxn-46-Sonden an Ambr® bereitstellen. Die Verbindung ist als permanente Verbindung gedacht. Bei allen Fragen und Problemen rund um Montage und Wartung für Ambr®-Instanzen von BioPAT Spectro® Sartorius kontaktieren.

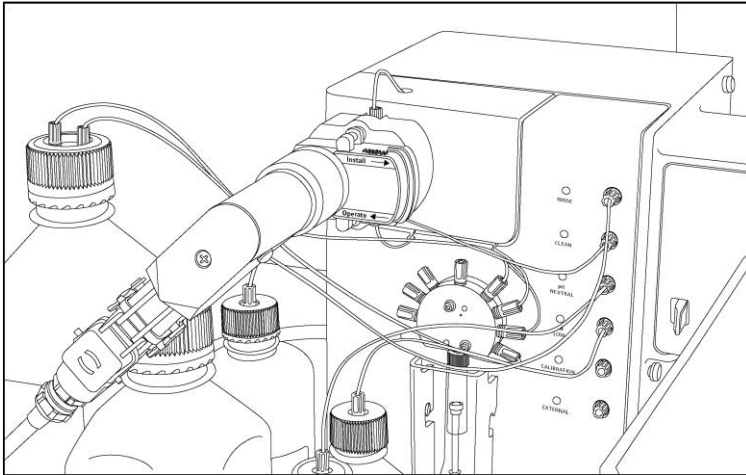

A0049106

Abbildung 6. Schnittstelle der Rxn-46-Sonde zu Ambr® 15 und Ambr® 250

6.3 Anschluss an Biostat STR® Einweg-Bioreaktoren

Für den Anschluss an Biostat STR® Einweg-Bioreaktoren kann Endress+Hauser Beratung zu Sondereinsatz und -wartung bereitstellen. Allerdings sollte Sartorius immer der erste Ansprechpartner sein, wenn es um die Erstmontage der Rxn-46-Sonde mit Biostat STR® für BioPAT® Spectro und späteren technischen Service geht.


6.4 Anschluss an den Biostat STR® Single-Use-Port

Der Anschluss an Biostat STR® Einwegbeutel kann vom Benutzer selbst vorgenommen werden, sollte allerdings bei der Erstmontage unter Anleitung von Sartorius erfolgen. Siehe Betriebsanleitung zum Sartorius BioPAT® Spectro, Dokument-Nr. 1000104283.

7 Inbetriebnahme

Die Rxn-46-Sonde ist bei Auslieferung für den Anschluss an den Raman Rxn-Analysator vorbereitet. Es ist keine zusätzliche Ausrichtung oder Justierung der Sonde erforderlich. Nachfolgende Anweisungen befolgen, um die Sonde in Betrieb zu nehmen.

7.1 Annahme der Sonde

Die zur Warenannahme im Kapitel Warenannahme →  beschriebenen Schritte durchführen.

7.2 Sondenkalibrierung und -verifizierung

Zur Montage der Rxn-46-Sonde mit Ambr® 15 oder Ambr® 250 führen die Endress+Hauser Servicemitarbeiter die Erstkalibrierung des Analysators und der Sonde sowie die Sondenverifizierung durch, bevor der Analysator und die Sonde für den Anschluss an das Ambr®-Analysemodul und -Software an Sartorius übergeben werden.

Die Betriebsanleitungen zum Raman Rxn-Analysator stehen im Download-Bereich der Endress+Hauser Website zur Verfügung: <https://endress.com/downloads>.

Kalibrier- und Verifizierungsanweisungen stehen im [Raman Rxn-46 Kalibrier- und Verifizierungskit](#) zur Verfügung.


8 Betrieb

8.1 Rxn-46-Sonde

Die Rxn-46-Sonde von Endress+Hauser ist eine angepasste Version der standardmäßigen Rxn-45-Bioprozesssonde von Endress+Hauser und wurde für die BioPAT® Spectro-Plattform von Sartorius optimiert.

Die Rxn46-Sonde ist kompatibel mit den Raman Rxn-Analysatoren von Endress+Hauser, die mit einer Wellenlänge von 785 nm arbeiten und nachfolgend aufgelistet sind:

- **Ambr®**: einkanaliger Raman Rxn2-Analysator
- **Biostat STR®**: ein- oder vierkanalige Analysatoren Raman Rxn2 oder Rxn4

Nähere Informationen siehe *Integration in die Ambr®-Software* und *Kompatibilität mit Biostat STR®* → .

8.2 Integration in die Ambr®-Software

Der integrierte, einkanalige Raman Rxn2-Analysator von Endress+Hauser ist mit Ambr® 15 und Ambr® 250 zur Raman-Modellerzeugung und zur Raman-Überwachung während der Entwicklung von Zellkulturprozessen mit hohem Durchsatz kompatibel. Die beiden Systeme arbeiten wie folgt zusammen:

- Steuerungselemente der Software für den einkanaligen, integrierten Raman Rxn2-Analysator sind in die Ambr®-Software integriert.
- Ambr®-Konfigurationen nutzen die gesamte Zeit über eine Rxn-46-Sonde, um wiederholt Spektren aus jedem Ambr®15- oder Ambr® 250-Behälter zu erfassen.
- Die Ambr®-Software steuert die Erfassung der Raman-Spektraldaten und konsolidiert und speichert alle Daten.
- Die Daten von integrierten At-line-Analysegeräten können automatisch mit den Spektraldaten abgeglichen werden; ebenso können Offline-Daten manuell während des Durchlaufs hinzugefügt werden.
- Nach dem Durchlauf kann eine konsolidierte und kontextualisierte Datendatei aus der Ambr®-Software exportiert werden, die für die Modellerzeugung in SIMCA® bereitsteht.

8.3 Kompatibilität mit Biostat STR®

Endress+Hauser Raman Rxn2- und Rxn4-Analysatoren (ein- oder vierkanalig) mit 785nm-Wellenlänge sind für den Einsatz mit Biostat STR® erhältlich. Diese Systeme arbeiten wie folgt zusammen:

- Die Rxn-46-Sonde wird an den Single-Use-Port von BioPAT® Spectro angeschlossen. Die Ports sind einsatzbereit und vollständig qualifiziert.
- Der Anschluss der Sonde an den Port gestaltet sich schnell und einfach.
- Die Raman-Erfassung erfordert keine zusätzliche Lichtabschirmung.
- Die in den Analysator integrierte Raman RunTime-Software startet die Datenerfassung von den Biostat STR® Einweg-Bioreaktoren von 50 Litern bis zu 2000 Litern.

9 Diagnose und Störungsbehebung

Bei der Behebung von Problemen mit der Rxn-46-Sonde nachfolgende Tabelle beachten. Wenn die Sonde beschädigt ist, vor der Störungsbehebung den Laser ausschalten. Bei Bedarf den zuständigen Servicevertreter für Unterstützung kontaktieren.

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	
1	Beträchtliche Reduzierung des Signals oder des Signalrauschabstands (Signal-to-Noise Ratio, SNR)	Sondenschieber nicht sicher in Position Operate (Betrieb).	Schieber auf Install und dann zurück auf Operate schieben.
2	Vollständiger Signalverlust, während der Laser eingeschaltet ist und die Laserverriegelungsanzeige leuchtet	Gebrochene Faser ohne Bruch des Verriegelungsdrahts	Sicherstellen, dass alle Faserverbindungen gesichert sind. Zustand der Faser verifizieren und den zuständigen Servicevertreter für einen Austausch kontaktieren.
	Gebrochene, aber intakte Faser	Zustand der Faser verifizieren und den zuständigen Servicevertreter für einen Austausch kontaktieren.	
3	Laserverriegelungsanzeige auf der Sonde leuchtet nicht	Beschädigte Faserbaugruppe	Nach Anzeichen für einen Faserbruch suchen. Den zuständigen Servicevertreter für einen Austausch kontaktieren.
		EO-Steckverbinder des Faserkabels nicht gesichert/ingerastet	Sicherstellen, dass der EO-Steckverbinder korrekt an der Probe und am Analysator angeschlossen und eingerastet ist (wenn zutreffend).
		Abgesetzter Verriegelungssteckverbinder getrennt	Sicherstellen, dass der abgesetzte Drehriegel-Verriegelungsstecker auf der Rückseite des Analysators (neben dem EO-Fasersteckverbinder) angeschlossen ist.
4	Verringerte Laserleistung oder Erfassungseffizienz	Verschmutzte Faserverbindung	Faserenden an der Sonde vorsichtig reinigen. Für eine Anleitung zur Reinigung und Inbetriebnahme einer neuen Sonde siehe entsprechende Betriebsanleitung zum Raman Rxn-Analysator.
5	Laserverriegelung auf dem Analysator führt zu einem Abschalten des Lasers	Laserverriegelung aktiviert	Alle angeschlossenen LWL-Kabelkanäle auf Faserbruch überprüfen und sicherstellen, dass die abgesetzten Verriegelungssteckverbinder auf jedem Kanal angebracht sind.
6	Andere ungeklärte negative Leistung der Sonde	Sondenschieber bewegt sich nicht ordnungsgemäß zwischen den Positionen Install und Operate	Den zuständigen Servicevertreter kontaktieren, um das beschädigte Produkt zurückzusenden.
		Physische Beschädigung der Sonde	

www.addresses.endress.com
