

Informazioni tecniche

Liquiline CM442/CM444/CM448

Trasmittitore digitale multiparametro con un massimo di otto canali di misura basato su tecnologia Memosens digitale



Per il monitoraggio e il controllo dei processi nell'industria e nel settore ambientale

Applicazione

- Acque potabili e reflue
- Centrali elettriche
- Industria chimica
- Altre applicazioni industriali

Vantaggi

- Grande flessibilità:
 - Possibilità di collegare fino a 8 sensori Memosens
 - Le funzioni del pacchetto matematica calcolano nuovi valori misurati
 - Bus di campo digitali (HART, PROFIBUS, Modbus, EtherNet/IP, PROFINET) e web server integrato

- Possibilità di selezionare una funzione di pulizia, un controllore e un relè di allarme
- Uscite e ingressi digitali o analogici in opzione
- Massima sicurezza di processo grazie al concetto operativo unificato per tutti i dispositivi della piattaforma Liquiline, i campionatori e gli analizzatori
- Messa in servizio rapida grazie a:
 - Memosens: sensori tarati in laboratorio e "hot plug-and-play"
 - Trasmittitori Liquiline preconfigurati
 - Estensione e adattamento semplici

[Continua dalla pagina del titolo]

- Gestione delle scorte minime:
 - Concetto modulare multiplatforma (ad es. moduli identici indipendentemente dai parametri)
 - L'integrazione in FieldCare e W@M consente una gestione delle risorse efficace e semplificata

Indice

Funzionamento e struttura del sistema	5	Alimentazione esterna	29
Sistema di misura	5	Funzione PFM	29
Esempio di applicazione	6	Tensione ausiliaria	29
Dati costruttivi	7	Tensione di prova	29
Assegnazione di slot e porte	7	Specifiche cavi	29
Ordine dei moduli	7	Uscite in corrente, attive	29
Regola di base per espansioni hardware	8	Campo	29
Determinare lo stato alla consegna dell'hardware	8	Caratteristica del segnale	29
Schema dei morsetti	8	Specifiche elettriche	29
Configurazione del dispositivo utilizzando l'esempio di un CM442- **M1A1F0*	10	Specifiche cavi	29
Schema a blocchi del circuito per CM442	11	Uscite a relè	30
Configurazione del dispositivo utilizzando l'esempio di un CM444- **M42A1FA*	12	Specifiche elettriche	30
Schema a blocchi del circuito per CM444R	14	Specifiche cavi	30
Configurazione del dispositivo utilizzando l'esempio di un CM448- **26A1*	16	Dati specifici del protocollo	30
Schema a blocchi del circuito per CM448	18	HART	30
Comunicazione ed elaborazione dei dati	20	PROFIBUS DP	31
Garanzia di funzionamento	20	Modbus RS485	31
Affidabilità	20	Modbus TCP	31
Semplicità di manutenzione	22	EtherNet/IP	32
Sicurezza	25	PROFINET	33
Ingresso	26	Web server	34
Variabili misurate	26	Alimentazione	34
Campi di misura	26	Tensione di alimentazione	34
Tipi di ingresso	26	Potenza assorbita	34
Segnale di ingresso	26	Fusibile	34
Specifiche del cavo	26	Protezione alle sovratensioni	34
Ingressi digitali, passivi	27	Ingressi cavo	35
Specifiche elettriche	27	Specifica	36
Campo	27	Collegamento elettrico	36
Corrente di ingresso nominale	27	Collegamento dei moduli opzionali	38
Funzione PFM	27	Messa a terra di protezione	40
Tensione di prova	27	Collegamento del sensore	41
Specifiche cavi	27	Caratteristiche prestazionali	44
Ingresso in corrente, passivo	27	Tempo di risposta	44
Campo	27	Temperatura di riferimento	44
Caratteristica del segnale	27	Errore di misura per ingressi sensore	44
Resistenza interna	27	Errore di misura per ingressi e uscite in corrente	44
Tensione di prova	27	Tolleranza di frequenza per ingressi e uscite digitali	44
Uscita	27	Risoluzione di ingressi e uscite in corrente	44
Segnale di uscita	27	Ripetibilità	44
Segnale in caso di allarme	29	Montaggio	44
Carico	29	Requisiti di montaggio	44
Linearizzazione/comportamento di trasmissione	29	Installazione	45
Uscite digitali, passive	29	Ambiente	47
Specifiche elettriche	29	Temperatura ambiente	47
		Temperatura di immagazzinamento	48
		Umidità relativa	48
		Grado di protezione	48
		Resistenza alle vibrazioni	48
		Compatibilità elettromagnetica	49

Sicurezza elettrica	49
Grado inquinamento	49
Compensazione della pressione con riferimento all'ambiente	49
Costruzione meccanica	49
Dimensioni	49
Peso	49
Materiali	50
Operabilità	50
separato	50
Concetto operativo	50
Operatività locale	51
Funzionalità a distanza	51
Pacchetti di lingue	51
Certificati e approvazioni	52
Informazioni per l'ordine	52
Pagina del prodotto	52
Configuratore prodotto	52
Fornitura	52
Accessori	52
Accessori specifici del dispositivo	53
Accessori relativi alle comunicazioni	58
Accessori specifici per l'assistenza	58
Componenti di sistema	60
Altri accessori	60

Funzionamento e struttura del sistema


Sistema di misura

La panoramica illustra alcuni esempi dei sistemi di misura. Per condizioni specifiche dell'applicazione, è possibile ordinare altri sensori e armature (www.endress.com/products).

Punto di misura

Il sistema di misura completo comprende:

- Trasmettitore Liquiline
- Sensore con tecnologia Memosens
- Armature adatte ai sensori utilizzati
- Fermo della palina o guida (opzionale)
- Tettuccio di protezione dalle intemperie (opzionale)



A0012411

1 Sistema di misura (ad es. dispositivo a due canali)

- 1 Liquiline
- 2 Tettuccio di protezione dalle intemperie CY101 (in opzione)
- 3, 5 Sensore con cavo CYK10 o cavo fisso
- 4 Cavo di alimentazione (fornito dal cliente)


Nitrati e SAC

Nitrati in acque reflue

- Sensore CAS51D-**A2 con cavo fisso
- Armatura a immersione Dipfit CYA112
- Supporto CYH112

SAC in uscita dal trattamento di acque reflue


- Sensore CAS51D-**2C2 con cavo fisso
- Armatura a immersione Dipfit CYA112
- Supporto CYH112



Disinfezione

Cloro libero disponibile (e pH) in acqua potabile

- Sensore CCS51D
- Sensore Memosens CPS11E
- Cavo di misura CYK10
- Armatura a deflusso CYA27




Valore di pH o redox

Misura del pH in acqua potabile

- Armatura retrattile Cleanfit CPA871
- Sensore Memosens CPS11E
- Cavo di misura CYK10

Potenziale redox in acqua potabile

- Armatura a immersione Dipfit CYA112
- Sensore Memosens CPS12E
- Cavo di misura CYK10




Conducibilità

Misura di conducibilità induttiva nel trattamento delle acque reflue

- Sensore Indumax CLS50D
- Cavo fisso del sensore

Misura di conducibilità conduttiva nell'acqua di raffreddamento dell'impianto di produzione di energia


- Sensore Memosens CLS15E
- Cavo di misura CYK10



Ossigeno

Ossigeno nelle vasche di aerazione

- Armatura a immersione Dipfit CYA112
- Supporto CYH112
- Sensore
 - COS61D (ottico) con cavo fisso
 - COS51E (amperometrico), cavo CYK10




Torbidità e interfase

Torbidità in acque industriali

- Sensore Turbimax CUS51D con cavo fisso
- Armatura Flowfit CUA250
- Testa per pulizia spray CUR3 (opzionale)

Interfase nel chiarificatore primario


- Sensore Turbimax CUS71D
- Armatura CYA112
- Supporto CYH112



Elettrodi ionoselettivi

Misura di ammonio e nitrati nella vasca di aerazione

- Sensore CAS40D con cavo fisso
- Supporto CYH112




i Per l'installazione all'esterno, utilizzare sempre il tettuccio (v. "Accessori") per proteggere il trasmettitore dalle intemperie.

Esempio di applicazione

Punto di misura in uscita dall'impianto di trattamento acque reflue (canale aperto)

- Trasmettitore CM444-AAM44A0FF con:
 - 4 x Memosens, Modbus TCP, 4 x relè per pulizia/valore limite, 2 x ingresso in corrente analogico
- pH e temperatura con CPS11E, rif. 1 (www.endress.com/cps11e)
- Torbidità con CUS51D, rif. 2 (www.endress.com/cus51d)
- Nitrati con CAS51D, rif. 3 (www.endress.com/cas51d)
- Coefficiente di assorbimento spettrale con CAS51D, rif. 4 (www.endress.com/cas51d)
- Portata misurata esternamente mediante ingresso in corrente
- Supporto armatura CYH112 con armature CYA112 (www.endress.com/cyh112)





2 Punto di misura in uscita dall'impianto di trattamento acque reflue

Conservazione dei dati

- Archiviazione di tutti i valori misurati, compresi quelli da unità esterne, in una memoria non volatile (registro dati)
- Interrogazione dei dati onsite mediante menu di misura definito dall'utente e visualizzazione del registro dati in curve grafiche
- Trasmissione dei dati via Ethernet, interfaccia CDI Service o scheda SD e memorizzazione in un database a prova di manomissione (Field Data Manager)
- Esportazione dei dati su file CSV (per Microsoft Excel)

Dati costruttivi

Assegnazione di slot e porte



3 Assegnazione di slot e porta dei moduli hardware

Outlet 1	OK
CH1: 1:1 pH Glass ATC 6.95 pH	Port Slot
CH2: 1:2 TU/TS 500.0 g/l	
CH3: 5:1 SAC 500.0 1/m	
CH4: 5:2 Cond i ATC 2.62 mS/cm	
CH5: 6:1 Chlorine 28.33 mg/l	
CH6: 6:2 Redox ± 51 mV	
CH7: 7:1 Oxygen (am... 32.86 mg/l	
CH8: 7:2 Cond c ATC 131.1 pS/cm	
MENU CAL DIAG HOLD	

4 Assegnazione di slot e porta sul display

- Gli ingressi sono assegnati ai canali di misura in base all'ordine ascendente degli slot e delle porte. Esempio qui a fianco: "CH1: 1:1 pH vetro" significa: Il canale 1 (CH1) è assegnato allo slot 1 (modulo base) : porta 1 (ingresso 1), sensore di pH in vetro
- Uscite e relè sono denominati in base alla relativa funzione, ad es. "uscita in corrente", e visualizzati con i numeri di slot e porte in ordine crescente

Ordine dei moduli

Il dispositivo è fornito con dei moduli elettronici, che dipendono dalla versione ordinata e che sono assegnati a una sequenza specifica in ordine crescente agli slot 0...7. Se non è presente un modulo particolare, vale automaticamente quanto segue:

- Modulo di base (sempre presente) occupa sempre gli slot 0 e 1
- Modulo 485DP o 485MB del bus di campo
- Modulo di ingresso Memosens 2DS (DS = sensore digitale)
- Modulo di estensione per ingressi e uscite digitali DIO (DIO = ingresso e uscita digitali)
- Modulo dell'ingresso in corrente 2AI (AI = ingresso analogico)
- Moduli di uscita in corrente 4AO o 2AO (AO = uscita analogica)
- Moduli relè AOR, 4R o 2R (AOR = uscita analogica + relè, R = relè)

Con modulo di comunicazione sensori a sicurezza intrinseca 2DS Ex-i:

- CM442/CM442R: sempre nello slot 2
- CM444/CM444R: sempre nello slot 7 (a due canali) e nello slot 6 (a quattro canali)
- CM448/CM448: slot 7, 6, 5



I moduli con 4 porte devono essere connessi prima dei moduli del medesimo tipo ma con 2 porte.

Regola di base per espansioni hardware**Considerare quanto segue se si espande il dispositivo:**

- È possibile aggiornare solo con 1 modulo da 4 AO (uscite analogiche)
- Possono essere utilizzati massimo due moduli "DIO".

Determinare lo stato alla consegna dell'hardware

Per determinare lo stato alla consegna del dispositivo Liquiline, si deve conoscere il tipo e il numero di moduli forniti con il dispositivo ordinato.

- **Modulo base**
Un modulo di base in tutte le versioni. Occupa sempre gli slot 0 e 1.
- **Modulo del bus di campo**
Opzionale ed è possibile un solo modulo del bus di campo.
- **Moduli di ingresso**
 - Devono essere assegnati univocamente al numero di ingressi opzionali ordinati.
 - **Esempi:**
2 ingressi in corrente = modulo 2AI
4 ingressi Memosens = 2 ingressi con modulo base + modulo 2DS con altri 2 ingressi
- **Uscite in corrente e relè**
Sono possibili diverse combinazioni dei moduli.
La seguente tabella serve per determinare i moduli del dispositivo in base al tipo e al numero di uscite.

Uscite in corrente	Relè		
	0	2	4
2	-	1 x 2R	1 x 4R
4	1 x 2AO	1 x AOR	1 x 2AO + 1 x 4R
6	1 x 4AO	1 x 4AO + 1 x 2R	1 x 4AO + 1 x 4R
8	1 x 4AO + 1 x 2AO	1 x 4AO + 1 x 2AO + 1 x 2R	1 x 4AO + 1 x 2AO + 1 x 4R

- ▶ Sommare il numero di moduli e ordinarli in base alla sequenza specificata → 7.
- ↳ In questo modo si ottiene l'assegnazione degli slot per il dispositivo.

Schema dei morsetti


Il nome univoco del morsetto deriva da:

Slot n. : porta n. : morsetto

Esempio, contatto NA di un relè

Dispositivo con 4 ingressi per sensori digitali, 4 uscite in corrente e 4 relè


- Modulo base BASE2-E (comprende 2 ingressi sensore, 2 uscite in corrente)
- Modulo 2DS (2 ingressi sensore)
- Modulo 2AO (2 uscite in corrente)
- Modulo 4R (4 relè)



A0039621


5 Schema dei morsetti utilizzando l'esempio del contatto NA (morsetto 41) di un relè

Configurazione del dispositivo utilizzando l'esempio di un CM442-
**M1A1F0*



Dispositivo di base ordinato (esempio)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice d'ordine CM442-**M1A1F0* ▪ Funzionalità: 1 Memosens, 2 uscite in corrente senza HART
Opzioni di espansione senza moduli aggiuntivi	<p>Attivazione con codice di attivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secondo ingresso Memosens (71114663) ▪ HART (71128428) ▪ EtherNet/IP + web server (71449914) ▪ Modbus TCP + web server (71449915) ▪ PROFINET + web server (71449901) ▪ Web server (71449918)
Opzioni di espansione mediante un modulo di espansione nello slot 2 vuoto	<p>PROFIBUS DP con modulo 485DP o Modbus RS485 con modulo 485MB:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PROFIBUS DP Modulo 485DP (71575177) ▪ Modbus RS485 Modulo 485MB (71575178) <p> Se in un secondo tempo si aggiunge un modulo 485DP o 485MB, vengono disabilitate tutte le uscite in corrente esistenti.</p> <p>Ingressi, uscite e relè aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo 2AI (71135639): 2 ingressi in corrente ▪ Modulo 2AO (71135632): 2 uscite in corrente ▪ Modulo AOR (71111053): 2 uscite in corrente, 2 relè ▪ Modulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relè ▪ Modulo DIO (71135638): 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali
Espansione del dispositivo al modello CM444 o CM448	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kit di espansione 71470973 (100...230 V c.a.) o 71470975 (24 V c.c.) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentatore e backplane di estensione ▪ Modulo base Modulo base (ingressi Memosens come dispositivo base) ▪ 6 slot per moduli di estensione ▪ Opzioni di estensione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Secondo ingresso Memosens (71114663), moduli aggiuntivi come per CM442 ▪ Fino a 8 canali di misura utilizzando un idoneo numero di moduli di ingresso Memosens 2DS (71135631)
Regola di base per le estensioni	<p>Il totale di tutti gli ingressi e le uscite in corrente non deve superare 8.</p>
Restrizioni se si utilizzano sensori CUS71D per la misura di interfase	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CM442: Può essere collegato solo un sensore CUS71D. Il secondo ingresso Memosens non può essere utilizzato. ▪ Per l'estensione al modello CM444: È possibile ogni combinazione del sensore CUS71D o di altri sensori. Possono essere utilizzati tutti gli ingressi Memosens (4 max). ▪ Un'estensione al modello CM448 non è consigliata, perché il numero massimo di ingressi Memosens rimane limitato a 4.
Configuratore prodotto	<p>www.endress.com/cm442</p>

Schema a blocchi del circuito per CM442




A0039427

6 Schema funzionale per CM442

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Uscite in corrente 1:1, + HART (in opzione) | 6 | Alimentazione |
| 2 | Uscite in corrente (2 in opzione) | 7 | Interfaccia service |
| 3 | 2 ingressi Memosens input (1 in opzione) | 8 | Alimentazione, sensori con cavo fisso |
| 4 | PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (in opzione) | 9 | Relè di allarme |
| 5 | 2 ingressi in corrente (in opzione) | 10 | 2 o 4 relè (in opzione) |
| | | 11 | 2 ingressi e uscite digitali (in opzione) |

Schema a blocchi del circuito per CM442 con modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i




A0046460

7 Schema a blocchi del circuito per CM442 con modulo di comunicazione sensori a sicurezza intrinseca 2DS Ex-i

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Uscita in corrente 1:1, + HART (in opzione) | 5 | Alimentazione |
| 2 | Uscite in corrente (2 in opzione) | 6 | Interfaccia service |
| 3 | 2 ingressi Memosens BASE2 (disabilitati) | 7 | Alimentazione, sensori con cavo fisso BASE2 (disabilitata) |
| 4 | 2 ingressi Memosens 2DS Ex-i per sensori Memosens a sicurezza intrinseca | 8 | Alimentazione, sensori con cavo fisso |


Configurazione del dispositivo utilizzando l'esempio di un CM444-
**M42A1FA*



A0050485

Dispositivo di base ordinato (esempio)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice d'ordine CM444-**M42A1FA* ▪ Funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 x Memosens (2 su modulo BASE2-E + 2 su un modulo di estensione 2DS) ▪ Comunicazione PROFIBUS (modulo 485DP) ▪ Web server (modulo BASE2-E) ▪ 2 uscite in corrente senza HART (su modulo BASE2-E) ▪ 2 ingressi in corrente (modulo 2AI) <p>3 slot di questo esempio sono ancora vuoti. In altre versioni possono rimanere vuoti più o meno slot.</p>
Opzioni di espansione senza moduli addizionali	Nessuna
Opzioni di modifica senza moduli addizionali	<p>Aggiornamento mediante rimozione del modulo 485DP e inserimento del codice di attivazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modbus TCP + web server (71449915) ▪ EtherNet/IP + web server (71449914) ▪ PROFINET + web server (71449901) ▪ HART (71128428) ▪ Web server (71449918)
Opzioni di modifica con sostituzione di moduli esistenti	<p>Modificare il tipo di comunicazione sostituendo il modulo 485DP con il modulo 485MB. Questa modifica disabilita il tipo di comunicazione utilizzato in precedenza!</p> <p>Modulo 485MB: Modbus RS485 + web server (codice d'ordine. 71575178)</p>
Opzioni di estensione utilizzando moduli di estensione negli slot vuoti 5-7	<p>Per l'esempio trattato è possibile solo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relè ▪ Modulo DIO (71135638): 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali <p>Con un'estensione a 8 canali di misura: Modulo 2DS (71135631): 2 ingressi Memosens</p> <p>Ingressi, uscite e relè addizionali se si toglie il modulo 485DP del bus di campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo 2AO (71135632): 2 uscite in corrente ▪ Modulo AOR (71111053): 2 uscite in corrente, 2 relè ▪ Modulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relè ▪ Modulo DIO (71135638): 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali <p> Se viene rimosso il modulo 485DP e utilizzato un bus di campo Ethernet attraverso il modulo BASE2-E, è possibile utilizzare fino ad altre 6 uscite in corrente. Con il modulo 485DP sono disponibili solo due uscite in corrente.</p>
Regola di base per le estensioni	Il totale di tutti gli ingressi e le uscite in corrente non deve superare 8.
Restrizioni se si utilizzano sensori CUS71D per la misura di interfase	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nel caso di CM444, è possibile ogni combinazione di sensori Memosens (4 max). ▪ Un'estensione al modello CM448 non è consigliata, perché il numero massimo di ingressi Memosens quando si utilizza CUS71D rimane limitato a 4.
Configuratore prodotto	www.endress.com/cm444

Schema a blocchi del circuito per CM444R




A0039431

8 Schema funzionale per CM444

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Uscita in corrente 1:1, + HART (ambidue in opzione) | 6 | Alimentazione |
| 2 | Max. 7 uscite in corrente (in opzione) | 7 | Interfaccia service |
| 3 | Ingressi Memosens (2 standard + 2 in opzione) | 8 | Alimentazione, sensori con cavo fisso |
| 4 | PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (in opzione) | 9 | Relè di allarme |
| 5 | 2 ingressi in corrente (in opzione) | 10 | 2 o 4 relè (in opzione) |
| | | 11 | 2 ingressi e uscite digitali (in opzione) |

Schema a blocchi del circuito per CM444 con modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i




A0046471

9 Schema a blocchi del circuito per CM444 con modulo di comunicazione sensori a sicurezza intrinseca 2DS Ex-i

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Uscita in corrente 1:1, + HART (in opzione) | 5 | Alimentazione |
| 2 | Uscite in corrente (2 in opzione) | 6 | Interfaccia service |
| 3 | 2 ingressi Memosens BASE2 (disabilitati) | 7 | Alimentazione, sensori con cavo fisso BASE2 (disabilitata) |
| 4 | 2 ingressi Memosens 2DS Ex-i per sensori Memosens a sicurezza intrinseca | 8 | Alimentazione, sensori con cavo fisso |


Configurazione del
dispositivo utilizzando
l'esempio di un CM448-
**26A1*

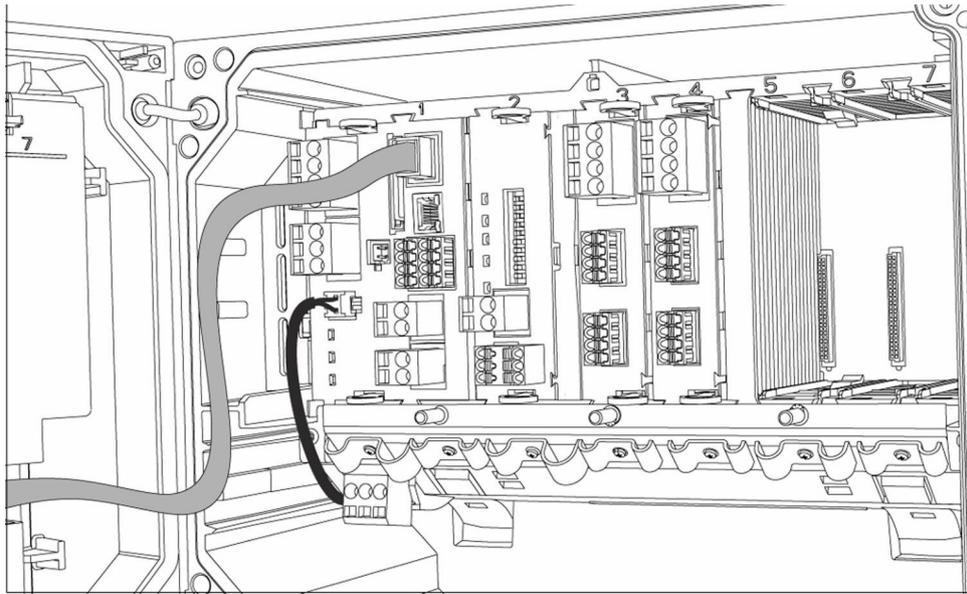

A0050483

Dispositivo di base ordinato (esempio)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice d'ordine CM448-**26A1* ▪ Funzionalità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 x Memosens (2 su modulo BASE2-E + 2 su due moduli di estensione 2DS) ▪ Comunicazione PROFIBUS (modulo 485DP) ▪ Web server (modulo BASE2-E) <p>3 slot di questo esempio sono ancora vuoti. In altre versioni possono rimanere vuoti più o meno slot.</p>
Opzioni di espansione senza moduli addizionali	<p>Codice di attivazione per l'utilizzo delle uscite in corrente del modulo base: 2 uscite in corrente (71140891)</p>
Opzioni di modifica senza moduli addizionali	<p>Aggiornamento mediante rimozione del modulo 485DP e inserimento del codice di attivazione per la comunicazione attraverso il modulo BASE2:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modbus TCP + web server (71449915) ▪ EtherNet/IP + web server (71449914) ▪ PROFINET + web server (71449901) ▪ HART (71128428) ▪ Web server (71449918)
Opzioni di modifica con sostituzione di moduli esistenti	<p>Modificare il tipo di comunicazione sostituendo il modulo 485DP con il modulo 485MB. Questa modifica disabilita il tipo di comunicazione utilizzato in precedenza! Modulo 485MB: Modbus RS485 + web server (codice d'ordine. 71575178)</p>
Opzioni di estensione utilizzando moduli di estensione negli slot vuoti 5-7	<p>Con un'estensione a 8 canali di misura: Modulo 2DS (71135631): 2 ingressi Memosens</p> <p>Ingressi, uscite e relè addizionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo 2AO (71135632): 2 uscite in corrente ▪ Modulo 2AI (71135639): 2 ingressi in corrente ▪ Modulo AOR (71111053): 2 uscite in corrente, 2 relè ▪ Modulo 2R (71125375) o 4R (71125376): 2 o 4 relè ▪ Modulo DIO (71135638): 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali <p> Se viene rimosso il modulo 485DP e utilizzato un bus di campo Ethernet, è possibile utilizzare fino ad altre 6 uscite in corrente. Con il modulo 485DP sono disponibili solo due uscite in corrente.</p>
Regola di base per le estensioni	<p>Il totale di tutti gli ingressi e le uscite in corrente non deve superare 8.</p>
Restrizioni se si utilizzano sensori CUS71D per la misura di interfase	<p>il numero massimo di ingressi Memosens utilizzabili è limitato 4! In questo caso, è possibile qualsiasi combinazione del sensore CUS71D e di altri sensori Memosens.</p>
Configuratore prodotto	<p>www.endress.com/cm448</p>

Schema a blocchi del circuito
per CM448




A0039429

10 Schema funzionale per CM448

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Uscita in corrente 1:1, + HART (ambidue in opzione) | 7 | Interfaccia service |
| 2 | Max. 7 uscite in corrente (in opzione) | 8 | Alimentazione, sensori con cavo fisso |
| 3 | Max. 8 ingressi Memosens input (di cui 2 in opzione) | 9 | Relè di allarme |
| 4 | PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet (in opzione) | 10 | 2 o 4 relè (in opzione) |
| 5 | 2 ingressi in corrente (in opzione) | 11 | 2 ingressi e uscite digitali (in opzione) |
| 6 | Alimentazione | | |

Schema a blocchi del circuito per CM448 con modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i



11 Schema a blocchi del circuito per CM448 con modulo di comunicazione sensori a sicurezza intrinseca 2DS Ex-i

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Uscita in corrente 1:1, + HART (in opzione) | 5 | Alimentazione |
| 2 | Uscite in corrente (2 in opzione) | 6 | Interfaccia service |
| 3 | 2 ingressi Memosens BASE2 (disabilitati) | 7 | Alimentazione, sensori con cavo fisso BASE2 (disabilitata) |
| 4 | 2 ingressi Memosens 2DS Ex-i per sensori Memosens a sicurezza intrinseca | 8 | Alimentazione, sensori con cavo fisso |

Comunicazione ed elaborazione dei dati

Protocolli di comunicazione:

Sistemi con bus di campo

- HART
- PROFIBUS DP (Profilo 3.02)
- Modbus TCP o RS485
- PROFINET
- EtherNet/IP

 Può essere attivo un solo tipo di comunicazione attraverso bus di campo. L'ultimo codice di attivazione inserito determina quale bus è utilizzato.

I driver del dispositivo consentono di eseguire una configurazione di base e di visualizzare valori misurati e informazioni di diagnostica mediante bus di campo. La configurazione completa del dispositivo non è possibile mediante bus di campo.

Modulo di espansione 485DP/485MB uscite in corrente

Per i protocolli di comunicazione PROFIBUS DP e Modbus RS485:

- CM442
Le uscite in corrente non possono essere utilizzate in parallelo. Installando il modulo 485DP/485MB, sono disattivate tutte le uscite in corrente presenti. PROFIBUS DP e Modbus RS485 non sono protocolli consentiti in abbinamento con il modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i.

- CM444/CM448

Possono essere utilizzate in parallelo massimo 2 uscite in corrente.

Funzionalità Ethernet mediante modulo Base2 e uscite in corrente

- CM442

Possono essere utilizzate in parallelo massimo 2 uscite in corrente.

- CM444 e CM448

Possono essere utilizzate in parallelo massimo 6 uscite in corrente.

Terminazione del bus sul dispositivo

- Mediante interruttore slide switch sul modulo 485DP/485MB
- Visualizzata mediante il LED "T" sul modulo 485DP/485MB del bus

Garanzia di funzionamento

Affidabilità

Memosens

Con Memosens, il punto di misura è più sicuro e affidabile:

- Isolamento galvanico ottimale grazie alla trasmissione del segnale digitale senza contatto
- Assenza di corrosione
- Completamente a tenuta stagna
- Il sensore può essere tarato in laboratorio migliorando quindi la disponibilità del punto di misura nel processo
- Elettronica a sicurezza intrinseca che consente un funzionamento senza problemi in area pericolosa.
- Manutenzione predittiva grazie alla registrazione dei dati nel sensore, ad esempio:
 - Ore di funzionamento totali
 - Ore di funzionamento con valori misurati ai limiti del campo di misura
 - Ore di funzionamento con alte temperature
 - Numero di cicli di sterilizzazioni con vapore
 - Stato sensore

Diagnostica Heartbeat

- Schermata di diagnostica Heartbeat e indicatori grafici per le condizioni del dispositivo e del sensore, con timer per manutenzione o taratura (dipende dal sensore)
- Informazioni di stato Heartbeat sulle condizioni del dispositivo e del sensore
 - ☺: condizioni del sensore/dispositivo o timer di manutenzione > 20%; non sono richiesti interventi
 - ☹: condizioni del sensore/dispositivo o timer di manutenzione > 5 ≤ 20%, manutenzione non ancora urgente ma da pianificare
 - ☹: condizioni del sensore/dispositivo o timer di manutenzione < 5%, la manutenzione è consigliata
- Le condizioni Heartbeat del sensore sono un'elaborazione dei risultati della taratura e delle funzioni diagnostiche del sensore.

Uno smiley triste potrebbe essere dovuto al risultato della taratura, allo stato del valore misurato o al superamento della soglia di ore operative. Queste soglie possono essere configurate nel sensore in modo da adattare la diagnostica Heartbeat all'applicazione.

Heartbeat e categoria NAMUR

Lo stato Heartbeat indica la condizione del sensore o del dispositivo mentre le categorie NAMUR (F, C, M, S) valutano l'affidabilità del valore misurato. Le due condizioni possono essere correlate, ma non è indispensabile.

- **Esempio 1**
 - Il numero di cicli di pulizia residui per il sensore raggiunge il 20% del numero massimo definito. Il simbolo Heartbeat si modifica da ☺ a ☹. Il valore misurato è ancora affidabile per cui il segnale di stato NAMUR non si modifica.
 - Se viene superato il numero massimo di cicli di pulizia, il simbolo Heartbeat si modifica da ☹ a ☹. Mentre il valore misurato può essere ancora affidabile, il segnale di stato NAMUR si modifica in M (richiesta manutenzione).
- **Esempio 2**

Il sensore si rompe. Lo stato Heartbeat si modifica immediatamente da ☺ a ☹ e anche il segnale di stato NAMUR si modifica immediatamente in F (guasto).

Heartbeat Monitoring

I dati del sensore sono trasmessi dai sensori Memosens mediante i protocolli dei bus di campo EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, HART, Modbus RTU e Modbus TCP. Questi dati possono essere utilizzati, ad esempio, per la manutenzione predittiva.

Esempi comprendono:

- Ore di funzionamento totali
- Ore di funzionamento con valori misurati ai limiti del campo di misura
- Ore di funzionamento con alte temperature
- Numero di cicli di sterilizzazioni con vapore
- Identificazione del sensore
- Informazioni sulla taratura

 Per maggiori informazioni sulla "Comunicazione EtherNet/IP", consultare le pagine dei prodotti in Internet (→ SD01293C).

 Per maggiori informazioni sulla "Comunicazione Modbus", accedere alle pagine dei prodotti in Internet (→ SD01189C).

 Per maggiori informazioni sulla "Comunicazione PROFINET", accedere alle pagine dei prodotti in Internet (→ SD02490C).

 Per maggiori informazioni sulla "Comunicazione PROFIBUS", consultare le pagine dei prodotti in Internet (→ SD01188C).

 Maggiori informazioni sulla comunicazione HART sono fornite sulle pagine dei prodotti in Internet (→ SD01187C).

Heartbeat Verification

Heartbeat Verification consente di verificare il corretto funzionamento del misuratore senza interrompere il processo. Questa verifica può essere documentata in qualsiasi momento.

Sistema controllo sensore (SCS = Sensor Check System)

Il Sistema controllo sensore (SCS) esegue il monitoraggio dell'alta impedenza del vetro di pH. Un allarme è generato se non è raggiunto un valore di impedenza minimo o è superata l'impedenza massima.

- La rottura del vetro è la causa principale di una caduta dei valori di alta impedenza
- I motivi che portano a un aumento dei valori di impedenza includono:
 - Sensore secco
 - Membrana di pH in vetro danneggiata



Per SCS, i valori soglia superiori e inferiori possono essere abilitati o disabilitati indipendentemente uno dall'altro.

Sistema di controllo del processo (PCS)

Il sistema di controllo del processo (PCS) verifica la stagnazione del segnale. Se il segnale di misura non si modifica per un periodo specifico (diversi valori misurati), si attiva un allarme.

Le cause principali della stagnazione dei valori misurati sono:

- Sensore contaminato o sensore fuori dal fluido
- Sensore difettoso
- Errore di processo (ad es. attraverso il sistema di controllo)

Funzioni di automonitoraggio

Gli ingressi in corrente sono disattivati nel caso di sovracorrente e riattivati quando la sovracorrente si arresta. Sono monitorate le tensioni della scheda ed è misurata anche la sua temperatura.

USP ed EP

Le funzioni di soglia per acqua farmaceutica secondo le specifiche USP ed EP sono implementate nel pacchetto software per le misure di conducibilità:

- "Acqua per iniettabili" (WFI) secondo USP <645> ed EP
- "Acqua a elevata purezza" (HPW) secondo EP
- "Acqua purificata" (PW) secondo EP

Per le funzioni di soglia USP/EP, sono misurati i valori di conducibilità senza compensazione e la temperatura. I valori misurati sono confrontati con le tabelle definite negli standard. Al superamento del valore limite viene attivato un allarme. Si può anche configurare un allarme di preavviso per segnalare stati operativi non corretti prima che si verifichino.

Chemoclean Plus


Controllo di sequenza liberamente programmabile

- ad es. per la pulizia automatica dei sensori in armature retrattili, per risultati di misura affidabili in processi ad alto rischio di contaminazione
- Attivazione temporizzata separata di 4 uscite, ad es. relè
- Avvio, arresto o sospensione di attività mediante ingresso digitale o segnali del bus di campo, ad es. da interruttori di soglia

Semplicità di manutenzione**Progettazione modulare**


La struttura modulare consente di adattare facilmente il trasmettitore alle specifiche:

- Moduli di estensione installati in un secondo tempo per un campo di funzioni nuovo/esteso, ad es. uscite in corrente, relè e comunicazione digitale
- Aggiornamento a massimo otto canali di misura
- In opzione: connettore M12 per collegare qualsiasi tipo di sensore Memosens
- In opzione: connettore CDI per accesso all'interfaccia service dall'esterno (senza svitare il coperchio della custodia)

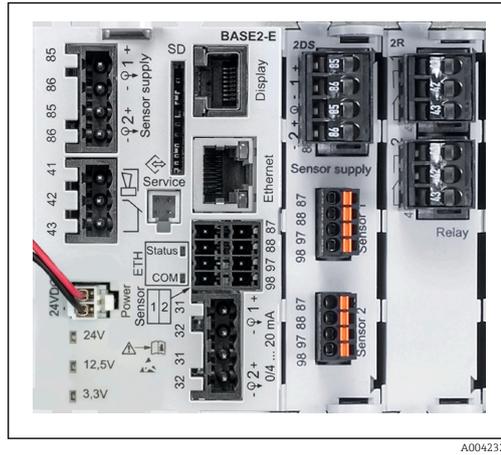

A0042325

12 CM444: esempio




A0042346

13 Modulo di estensione

Funzione memoria dati

- Tempo di scansione regolabile: da 1 a 3600 s (1 h)
- Registri dati:
 - 8 registri dati max.
 - 150.000 inserimenti per registro
 - Display grafico (curve grafiche) o elenco numerico
- Registro delle tarature: max. 75 voci
- Registro della versione hardware:
 - Configurazione e modifiche hardware
 - 125 inserimenti max.
- Registro della versione:
 - ad es. aggiornamenti software
 - 50 inserimenti max.
- Registro operativo: max. 250 voci
- Registro di diagnostica: max. 250 voci



A0015032

14 Registro dati: display grafico

i I registri rimangono invariati anche dopo un aggiornamento software.

Scheda SD

Il supporto di memoria intercambiabile consente:

- Rapidi e semplici aggiornamenti ed estensioni del software
- Archiviazione dei dati presenti nella memoria interna del dispositivo (ad es. registri)
- Trasferimento di configurazioni complete a un dispositivo con la medesima configurazione (funzione di backup)
- Trasferimento di configurazioni senza TAG e indirizzo del bus a dispositivi con la medesima configurazione (funzione di copia)
- Salvataggio di screenshot a scopo di documentazione

Endress+Hauser offre tra gli accessori schede SD approvate per uso industriale. Queste schede di memoria offrono la massima sicurezza e integrità dei dati.

È possibile utilizzare anche altre schede SD di qualità industriale, da 1 a 32 GB e con un peso massimo di 5 g. Tuttavia Endress+Hauser non può assumersi alcuna responsabilità della sicurezza dati fornita da questa scheda.

Segnali esterni per controllo del dispositivo e attivazione di dispositivi esterni

Le opzioni hardware, ad es. modulo "DIO" con 2 ingressi digitali e 2 uscite digitali o il modulo 485DP/485MB del bus di campo, consentono:

- mediante un segnale di ingresso digitale
 - commutazione del campo di misura per la conducibilità (è necessario un codice di espansione, v. accessori)
 - commutazione tra diverse serie di dati di taratura nel caso di sensori ottici
 - hold esterno
 - attivazione di un intervallo di pulizia
 - attivazione e disattivazione di un controllore PID, ad es. mediante l'interruttore di prossimità dell'armatura CCA250
 - uso dell'ingresso come "ingresso analogico" per la modulazione della frequenza di impulsi (PFM)
- mediante un segnale di uscita digitale
 - la trasmissione statica (simile a un relè) di stati diagnostici, stati dell'interruttore della soglia di livello, ecc.
 - la trasmissione dinamica (simile a "un'uscita analogica" senza usura) di segnali PFM, ad es. per controllare le pompe dosatrici.

FieldCare e Field Data Manager

FieldCare


Software per configurazione e gestione delle risorse basato su tecnologia FDT/DTM

- Configurazione completa dei dispositivi connessi mediante FXA291 e Interfaccia service
- Accesso a una serie di parametri configurativi e dati identificativi, di misura e diagnostica, se connesso mediante modem HART
- I registri possono essere scaricati in formato CSV o binario per il software "Field Data Manager"

Field Data Manager

Software di visualizzazione e database per dati di misura, taratura e configurazione

- Database SQL protetto da manipolazioni
- Funzioni per importare, salvare e stampare i registri
- Curve grafiche per visualizzare i valori misurati



15 Field Data Manager: curve grafiche

A0016009

Valori di processo virtuali (funzioni matematiche)

Oltre ai valori di processo "reali", trasmessi da sensori fisici o ingressi analogici collegati, si possono calcolare anche un massimo di 8 valori di processo "virtuali" utilizzando le funzioni matematiche.

I valori di processo "virtuali" possono essere:

- Trasmessi mediante un'uscita in corrente o un bus di campo
- Usati come variabile controllata
- Assegnati come variabili misurate per un contatto di soglia
- Usati come variabile misurata per attivare la pulizia
- Visualizzati nei menu di misura definiti dall'utente

Sono disponibili le seguenti funzioni matematiche:

- Calcolo del pH da due valori di conducibilità secondo VGB 405 RL, ad es. acqua di alimentazione della caldaia
- Differenza tra due valori misurati di origine diversa, ad es. per il monitoraggio della membrana
- Conducibilità differenziale, ad es. per monitorare l'efficienza degli scambiatori ionici
- Conducibilità in assenza di gas, ad es. per controllare i processi negli impianti di produzione di energia
- Ridondanza per il monitoraggio di due o tre sensori ridondanti
- Calcolo del potenziale di ossidoriduzione rH dai valori misurati da un sensore di pH e un sensore di redox
- Calcolo della capacità residua di uno scambiatore di cationi
- Calcolo della concentrazione di cloro combinato. Questo calcolo comprende la sottrazione della concentrazione di cloro libero dalla concentrazione di cloro totale. Ciò richiede sia un sensore per cloro libero CCS51E, sia un sensore per cloro totale CCS53E.
- Editor di formula

Tabelle di concentrazione

Alla consegna, nel dispositivo sono memorizzate delle tabelle che servono per convertire le misure di conducibilità induttiva in valori di concentrazione di alcune sostanze. Sono possibili anche 4 tabelle definite dall'utente.

Sono disponibili le seguenti tabelle di concentrazione impostate in fabbrica:

NaOH	0...15%	0...100 °C (32...212 °F)
NaOH	25...50%	2...80 °C (36...176 °F)
HCl	0...20%	0...65 °C (32...149 °F)
HNO ₃	0...30%	2...80 °C (36...176 °F)
H ₂ SO ₄	0,5...27% e 35...85%	0...100 °C (32...212 °F)
H ₂ SO ₄	93...100%	10...115 °C (50...239 °F)
H ₃ PO ₄	0...40%	2...80 °C (36...176 °F)
NaCl	0...26%	2...80 °C (36...176 °F)

Sicurezza

Orologio in tempo reale

Il dispositivo è dotato di un orologio in tempo reale, alimentato da batteria a bottone nel caso di mancanza di rete.

Questo garantisce la correttezza di data e ora sul dispositivo quando si riavvia e della marcatura oraria nei registri.

Sicurezza dati

Tutte le impostazioni, i registri, ecc. sono archiviati in una memoria non volatile per garantire la conservazione dei dati se si interrompe l'alimentazione.

Commutazione del campo di misura per la conducibilità

- Può servire nei processi CIP, ad es. per un monitoraggio sicuro della separazione di fase
- Commutazione tra 4 serie di parametri complete:
 - Modalità operativa per conducibilità
 - Tabelle di concentrazione
 - Compensazione della temperatura
 - Campo del segnale di uscita
 - Commutazione del valore soglia
- Mediante ingressi digitali o bus di campo

Compensazione del valore misurato per ossigeno e conducibilità

- Compensazione di pressione o temperatura
- Segnali di ingresso da sensori esterni mediante ingresso in corrente o bus di campo
- Segnali da sensori di temperatura collegati

Protezione mediante password

Accesso protetto da password

- Per funzionalità a distanza mediante web server
- Per controllo locale

Sicurezza di processo

Due controllori PID indipendenti

- Controllo monolaterale o bilaterale
- Contatti di soglia
- 4 programmi di pulizia, che possono essere impostati in modo indipendente

Sicurezza IT

La garanzia è valida solo se il prodotto è installato e impiegato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

Ingresso

Variabili misurate

→ In base al tipo di sensore utilizzato (vedere documentazione di dettaglio)

Campi di misura

→ In base al tipo di sensore utilizzato (vedere documentazione di dettaglio)

Tipi di ingresso

- Ingressi sensore digitali, per sensori con protocollo Memosens
- Ingressi in corrente analogici (opzionali)
- Ingressi digitali (opzionali)
- Ingressi sensore digitali per sensori a sicurezza intrinseca con protocollo Memosens e approvazione Ex (in opzione)

Segnale di ingresso

In base alla versione:

- Senza modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i: max. 8 segnali binari del sensore
- Con modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i: max. 6 segnali binari del sensore
- 2 x 0/4...20 mA (opzionali), passivi, isolati elettricamente tra loro e dagli ingressi sensore
- 0...30 V

Specifiche del cavo**Tipo di cavo**

- Senza modulo di comunicazione del sensore 2DS Ex-i: cavo dati Memosens CYK10 o cavo fisso del sensore, ognuno con terminali liberi o connettore circolare M12 (opzionale)
- Con modulo di comunicazione del sensore 2DS Ex-i: cavo dati Memosens CYK10 o cavo fisso del sensore, ognuno con terminali liberi

 Solo i cavi dati Memosens CYK10 con adeguata approvazione possono essere collegati agli ingressi sensore digitali a sicurezza intrinseca del modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i.

Lunghezza del cavo

100 m (330 ft) max.

Ingressi digitali, passivi

Specifiche elettriche

- Potenza meccanica (passiva)
- Isolamento galvanico

Campo

- High: 11 ... 30 V DC
- Low: 0 ... 5 V DC

Corrente di ingresso nominale max. 8 mA

Funzione PFM Larghezza impulso minima: 500 μ s (1 kHz)

Tensione di prova 500 V

Specifiche cavi Max. 2,5 mm² (14 AWG)

Ingresso in corrente, passivo

Campo > 0...20 mA

Caratteristica del segnale Lineare

Resistenza interna Non lineare

Tensione di prova 500 V

Uscita

Segnale di uscita

In base alla versione:

- 2 x 0/4...20 mA, attive, isolate galvanicamente tra loro e dai circuiti del sensore
- 4 x 0/4...20 mA, attive, isolate galvanicamente tra loro e dai circuiti del sensore
- 6 x 0/4...20 mA, attive, isolate galvanicamente tra loro e dai circuiti del sensore
- 8 x 0/4...20 mA, attive, isolate galvanicamente tra loro e dai circuiti del sensore
- Comunicazione HART opzionale (solo mediante uscita in corrente 1:1)

HART	
Codifica segnale	FSK \pm 0,5 mA sopra il segnale in corrente
Velocità di trasmissione dati	1200 baud
Isolamento galvanico	Sì
Carico (resistore di comunicazione)	250 Ω

PROFIBUS DP/RS485	
Codifica segnale	EIA/TIA-485, PROFIBUS DP secondo IEC 61158
Velocità di trasmissione dati	9,6 kBd, 19,2 kBd, 45,45 kBd, 93,75 kBd, 187,5 kBd, 500 kBd, 1,5 MBd, 6 MBd, 12 MBd
Isolamento galvanico	Sì
Connettori	Morsetto a molla (1,5 mm max.), collegato internamente nel connettore (funzione T), M12 opzionale
Terminazione del bus	Interruttore slide switch interno con visualizzazione LED

Modbus RS485	
Codifica segnale	EIA/TIA-485
Velocità di trasmissione dati	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200 baud
Isolamento galvanico	Sì
Connettori	Morsetto a molla (1,5 mm max.), collegato internamente nel connettore (funzione T), M12 opzionale
Terminazione del bus	Interruttore slide switch interno con visualizzazione LED

Ethernet e Modbus TCP	
Codifica segnale	IEEE 802.3 (Ethernet)
Velocità di trasmissione dati	10/100 MBd
Isolamento galvanico	Sì
Connessione	RJ45, M12 opzionale
Indirizzo IP	DHCP (predefinito) o configurato tramite menu

EtherNet/IP	
Codifica segnale	IEEE 802.3 (Ethernet)
Velocità di trasmissione dati	10/100 MBd
Isolamento galvanico	Sì
Connessione	RJ45, M12 opzionale (codificato D)
Indirizzo IP	DHCP (predefinito) o configurato tramite menu

PROFINET	
Codifica segnale	IEEE 802.3 (Ethernet)
Velocità di trasmissione dati	100 MBd
Isolamento galvanico	Sì
Connessione	RJ45, M12 opzionale (codificato D)
Nome della stazione	Tramite protocollo DCP usando lo strumento di configurazione (ad es. Siemens PRONETA)
Indirizzo IP	Tramite protocollo DCP usando lo strumento di configurazione (ad es. Siemens PRONETA)

Segnale in caso di allarme	Regolabile, secondo la normativa NAMUR NE 43 <ul style="list-style-type: none"> ■ Nel campo di misura 0...20 mA (HART non è disponibile con questo campo di misura): Corrente di errore 0...23 mA ■ Nel campo di misura 4...20 mA: Corrente di errore 2,4...23 mA ■ Impostazione di fabbrica per corrente di errore, per ambedue i campi di misura: 21,5 mA
Carico	max. 500 Ω
Linearizzazione/ comportamento di trasmissione	Lineare

Uscite digitali, passive

Specifiche elettriche	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passiva ■ Open collector, max. 30 V, 15 mA ■ Caduta di tensione massima 3 V
Alimentazione esterna	In caso di alimentazione di tensione ausiliaria in loco e ingresso digitale in loco: Tensione ausiliaria minima raccomandata = 3 V + V_{IHmin} (V_{IHmin} = tensione d'ingresso minima richiesta (tensione d'ingresso di alto livello))
Funzione PFM	Larghezza impulso minima: 500 μs (1 kHz)
Tensione ausiliaria	Specifiche elettriche <ul style="list-style-type: none"> ■ Isolata galvanicamente ■ Senza regolazione, 24 V c.c. ■ Max. 50 mA (per modulo DIO)
Tensione di prova	500 V
Specifiche cavi	Max. 2,5 mm ² (14 AWG)

Uscite in corrente, attive

Campo	0...23 mA 2,4...23 mA per la comunicazione HART
Caratteristica del segnale	Lineare
Specifiche elettriche	Tensione di uscita 24 V max. Tensione di prova 500 V
Specifiche cavi	Tipo di cavo Consigliato: cavo schermato Specifiche del cavo Max. 2,5 mm ² (14 AWG)

Uscite a relè

Specifiche elettriche

Tipi di relè

- 1 contatto di commutazione unipolare (relè di allarme)
- 2 o 4 contatti di commutazione unipolari (opzionali con i moduli di espansione)

Carico massimo

- Relè di allarme: 0,5 A
- Tutti gli altri relè: 2,0 A

Capacità di commutazione del relè

Modulo base (Relè di allarme)

Tensione di commutazione	Carico (max.)	Cicli di commutazione (min.)
230 V c.a., $\cos\Phi = 0,8 \dots 1$	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
115 V C.A., $\cos\Phi = 0,8 \dots 1$	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650.000
24 V c.c., L/R = 0...1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000

Moduli di espansione

Tensione di commutazione	Carico (max.)	Cicli di commutazione (min.)
230 V c.a., $\cos\Phi = 0,8 \dots 1$	0,1 A	700.000
	0,5 A	450.000
	2 A	120.000
115 V C.A., $\cos\Phi = 0,8 \dots 1$	0,1 A	1.000.000
	0,5 A	650.000
	2 A	170.000
24 V c.c., L/R = 0...1 ms	0,1 A	500.000
	0,5 A	350.000
	2 A	150.000

Specifiche cavi

Max. 2,5 mm² (14 AWG)

Dati specifici del protocollo

HART

ID produttore	11 _h
Tipo dispositivo	155D _h
Revisione del dispositivo	001 _h
Versione HART	7.2
File descrittivi del dispositivo (DD/DTM)	www.endress.com/hart Device Integration Manager (DIM)
Variabili del dispositivo	16 variabili del dispositivo definibili dall'utente e 16 predefinite; variabili dinamiche PV, SV, TV, QV
Caratteristiche supportate	PDM DD, AMS DD, DTM, Field Xpert DD

PROFIBUS DP	ID del produttore	11 _h
	Tipo di dispositivo	155D _h
	Versione profilo	3.02
	File di database del dispositivo (file GSD)	www.endress.com/profibus Device Integration Manager (DIM)
	Variabili in uscita	16 blocchi AI, 8 blocchi DI
	Variabili in ingresso	4 blocchi AO, 8 blocchi DO
	Caratteristiche supportate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 connessione MSCY0 (comunicazione ciclica, dal master classe 1 allo slave) ▪ 1 connessione MSAC1 (comunicazione aciclica, dal master classe 1 allo slave) ▪ 2 connessioni MSAC2 (comunicazione aciclica, dal master classe 2 allo slave) ▪ Blocco del dispositivo: il dispositivo può essere protetto utilizzando un blocco hardware o software. ▪ Indirizzamento mediante microinterruttori DIL o software ▪ GSD, PDM DD, DTM

Modbus RS485	Protocollo	RTU/ASCII
	Codici operativi	03, 04, 06, 08, 16, 23
	Supporto trasmissione per codici di funzione	06, 16, 23
	Dati in uscita	16 valori misurati (valore, unità ingegneristica, stato), 8 valori digitali (valore, stato)
	Dati in ingresso	4 setpoint (valore, unità ingegneristica, stato), 8 valori digitali (valore, stato), informazioni diagnostiche
	Caratteristiche supportate	L'indirizzo può essere configurato mediante interruttore o software

Modbus TCP	Porta TCP	502
	Connessioni TCP	3
	Protocollo	TCP
	Codici operativi	03, 04, 06, 08, 16, 23
	Supporto trasmissione per codici di funzione	06, 16, 23
	Dati in uscita	16 valori misurati (valore, unità ingegneristica, stato), 8 valori digitali (valore, stato)
	Dati in ingresso	4 setpoint (valore, unità ingegneristica, stato), 8 valori digitali (valore, stato), informazioni diagnostiche
	Caratteristiche supportate	L'indirizzo può essere configurato mediante DHCP o software

EtherNet/IP

Protocollo	EtherNet/IP	
ODVA certification	Si	
Profilo del dispositivo	Dispositivo generico (tipo di prodotto: 0x2B)	
ID del produttore	0x049E _h	
ID del tipo di dispositivo	0x109C _h	
Polarità	Auto-MIDI-X	
Connessioni	CIP	12
	I/O	6
	Messaggio esplicito	6
	Multicast	3 consumatori
RPI min.	100 ms (predefinito)	
RPI max.	10000 ms	
Integrazione di sistema	EtherNet/IP	EDS
	Rockwell	Add-on-Profile Livello 3, Faceplate per Factory Talk SE
Dati IO	Ingresso (T → O)	Stato del dispositivo e messaggio diagnostico con la massima priorità Valori misurati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 AI (ingresso analogico) + stato + unità ingegneristica ▪ 8 DI (ingresso discreto) + stato
	Uscita (O → T)	Valori di attuazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 AO (uscita analogica) + stato + unità ingegneristica ▪ 8 DO (uscita discreta) + stato

PROFINET	Protocollo	"Application layer protocol for decentral device periphery and distributed automation", versione PNIO 2.34
	Tipo di comunicazione	100 MBit/s
	Classe di conformità	Classe di conformità B
	Classe Netload	Classe Netload Classe II
	Velocità di trasmissione	Automatica 100 Mbps con rilevamento full-duplex
	Tempi del ciclo	Da 32 ms
	Profilo del dispositivo	Identificativo interfaccia applicazione 0xF600 Dispositivo generico
	Interfaccia PROFINET	1 porta, Realtime Classe 1 (RT_CLASS_1)
	ID del produttore	0x11 _h
	ID del tipo di dispositivo	0x859C D _h
	File descrittivi del dispositivo (GSD)	Informazioni e file disponibili all'indirizzo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com Sulla pagina prodotto del dispositivo: Documents/Software → Device drivers ▪ www.profibus.com Sul sito web in Products/Product Finder
	Polarità	Polarità automatica per la correzione automatica di coppie incrociate TxD e RxD
	Connessioni supportate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x AR (AR controllore I/O) ▪ 1 x AR (AR dispositivo supervisore I/O) ▪ 1 x ingresso CR (Communication Relation) ▪ 1 x uscita CR (Communication Relation) ▪ 1 x allarme CR (Communication Relation)
	Opzioni di configurazione per il misuratore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Web browser ▪ Software specifico del produttore (FieldCarem DeviceCare) ▪ File dispositivo master (GSD), può essere letto tramite il web server integrato del misuratore
	Configurazione del nome del dispositivo	Protocollo DCP
Funzioni supportate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificazione e manutenzione Identificazione semplice del dispositivo tramite: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema di controllo del processo ▪ Targhetta ▪ Stato del valore misurato Le variabili di processo vengono comunicate con lo stato di un valore misurato ▪ Funzione lampeggiante (FLASH_ONCE) tramite il display on-site per semplificare l'identificazione e l'assegnazione di un dispositivo ▪ Funzionamento del dispositivo tramite tool operativi (ad es. FieldCare, DeviceCare) 	
Integrazione di sistema	Per informazioni sull'integrazione del sistema, vedere le Istruzioni di funzionamento <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trasmissione ciclica dei dati ▪ Presentazione e descrizione dei moduli ▪ Codifica di stato ▪ Configurazione dell'avviamento ▪ Impostazione di fabbrica 	

Web server

Il web server consente l'accesso completo alla configurazione del dispositivo, ai valori misurati, ai messaggi diagnostici, ai registri e ai dati di assistenza tramite router standard WiFi/WLAN/LAN/GSM o 3G con indirizzo IP definito dall'utente.

Porta TCP	80
Funzioni supportate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configurazione del dispositivo a distanza(1 sessione) ▪ Salvataggio/ripristino della configurazione del dispositivo (mediante scheda SD) ▪ Esportazione dei registri(formati file: CSV, FDM) ▪ Accesso al web server mediante DTM o Internet Explorer ▪ Login ▪ Il web server può essere disattivato

Alimentazione

Tensione di alimentazione**CM442**

In base alla versione:

- 100 ... 230 V c.a., 50/60 Hz

Fluttuazione max. consentita per la tensione di alimentazione della rete: $\pm 15\%$ della tensione nominale

- 24 V c.a./c.c., 50/60 Hz

Fluttuazione max. consentita per la tensione di alimentazione della rete: $+20/-15\%$ della tensione nominale

CM444 e CM448

In base alla versione,:

- 100 ... 230 V c.a., 50/60 Hz

Fluttuazione max. consentita per la tensione di alimentazione della rete: $\pm 15\%$ della tensione nominale

- 24 V c.c.

Fluttuazione max. consentita per la tensione di alimentazione della rete: $+20/-15\%$ della tensione nominale

AVVISO**Il dispositivo non è dotato di interruttore di alimentazione.**

- ▶ Prevedere un interruttore di protezione sul luogo di installazione, in prossimità del dispositivo.
- ▶ L'interruttore di protezione deve essere un commutatore o un interruttore di alimentazione e deve essere etichettato come interruttore di protezione del dispositivo.
- ▶ Nel punto di ingresso, l'alimentazione deve essere isolata dai cavi che portano tensioni pericolose mediante un isolamento doppio o rinforzato nel caso di dispositivi con tensione di alimentazione di 24 V.

Potenza assorbita**CM442**

In base alla tensione di alimentazione

- 100...230 V c.a. e 24 V c.a.:

55 VA max.

- 24 V c.c.:

22 W max.

CM444 e CM448

In base alla tensione di alimentazione

- 100...230 V c.a.:

Max. 73 VA

- 24 V c.c.:

Max. 68 W

Fusibile


Fusibile non sostituibile

Protezione alle sovratensioni


Protezione integrata da sovratensioni/fulmini secondo EN 61326-1/-2
Categorie di protezione 1 e 3

Ingressi cavo

Ingressi cavo per trasmettitori per area sicura

Identificazione dell'ingresso cavo sulla base della custodia	Raccordo filettato adatto																
B, C, H, I, 1-8	M16x1,5 mm/NPT3/8"/G3/8																
A, D, F, G	M20x1,5 mm/NPT1/2"/G1/2																
E	-																
±	M12x1,5 mm																
 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0018025</p>	<p>Assegnazione consigliata</p> <table border="0"> <tr> <td>1-8</td> <td>Sensori 1-8</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Alimentazione</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Utilizzo senza restrizioni</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>RS485 Out o M12 Ethernet</td> </tr> <tr> <td>D,F,G</td> <td>Ingressi e uscite in corrente, relè</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>RS485 In o M12 DP/RS485</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Utilizzo senza restrizioni</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Non utilizzare</td> </tr> </table>	1-8	Sensori 1-8	A	Alimentazione	B	Utilizzo senza restrizioni	C	RS485 Out o M12 Ethernet	D,F,G	Ingressi e uscite in corrente, relè	H	RS485 In o M12 DP/RS485	I	Utilizzo senza restrizioni	E	Non utilizzare
	1-8	Sensori 1-8															
A	Alimentazione																
B	Utilizzo senza restrizioni																
C	RS485 Out o M12 Ethernet																
D,F,G	Ingressi e uscite in corrente, relè																
H	RS485 In o M12 DP/RS485																
I	Utilizzo senza restrizioni																
E	Non utilizzare																

Ingressi cavo per trasmettitori con modulo di comunicazione sensori tipo 2DS Ex-i per area pericolosa

Identificazione dell'ingresso cavo sulla base della custodia	Raccordo filettato adatto														
B, C, H, I, 1-8	M16x1,5 mm/NPT3/8"/G3/8														
A, D, F, G	M20x1,5 mm/NPT1/2"/G1/2														
E	-														
±	M12x1,5 mm														
 <p style="text-align: right; font-size: small;">A0045661</p>	<p>Assegnazione consigliata</p> <table border="0"> <tr> <td>1/2/3 5/6/7</td> <td>Non utilizzare</td> </tr> <tr> <td>4/8 B/F/G/I</td> <td>Sensori a sicurezza intrinseca</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Alimentazione</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>RS485 Out o M12 Ethernet</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Ingressi e uscite in corrente, relè</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>RS485 In o M12 DP/RS485</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Non utilizzare</td> </tr> </table>	1/2/3 5/6/7	Non utilizzare	4/8 B/F/G/I	Sensori a sicurezza intrinseca	A	Alimentazione	C	RS485 Out o M12 Ethernet	D	Ingressi e uscite in corrente, relè	H	RS485 In o M12 DP/RS485	E	Non utilizzare
	1/2/3 5/6/7	Non utilizzare													
4/8 B/F/G/I	Sensori a sicurezza intrinseca														
A	Alimentazione														
C	RS485 Out o M12 Ethernet														
D	Ingressi e uscite in corrente, relè														
H	RS485 In o M12 DP/RS485														
E	Non utilizzare														
<p>16 A: area sicura, B: area pericolosa</p>															

i I cavi per area sicura e per area pericolosa non devono incrociarsi nella custodia. Selezionare un ingresso cavo adatto per la connessione.



Specifica

Pressacavo	Diametro del cavo consentito
M16x1,5 mm	4...8 mm (0.16...0.32")
M12x1,5 mm	2...5 mm (0.08...0.20")
M20x1,5 mm	6...12 mm (0.24...0.48")
NPT3/8"	4...8 mm (0.16...0.32")
G3/8	4...8 mm (0.16...0.32")
NPT1/2"	6...12 mm (0.24...0.48")
G1/2	7...12 mm (0.28...0.48")

 I pressacavi montati in fabbrica sono serrati con coppia di 2 Nm.

Collegamento elettrico

Modulo di base



 17 Modulo di base BASE2-H o -L (dispositivo a due canali)


- 1 Alimentazione per sensori digitali con cavo fisso e protocollo Memosens
- 2 Slot per scheda SD
- 3 Slot per cavo del display ¹⁾
- 4 Interfaccia Ethernet
- 5 Connessioni per 2 sensori Memosens
- 6 Uscite in corrente
- 7 Connessione dell'alimentazione
- 8 Interfaccia service
- 9 Connessione del relè di allarme

 18 Modulo di base BASE2-E (dispositivo a quattro e otto canali)


- 1 Alimentazione per sensori digitali con cavo fisso e protocollo Memosens
- 2 Slot per scheda SD
- 3 Slot per cavo del display ¹⁾
- 4 Interfaccia Ethernet
- 5 Connessioni per 2 sensori Memosens
- 6 Uscite in corrente
- 7 Ingresso per cavo di alimentazione interno ¹⁾
- 8 LED
- 9 Interfaccia service
- 10 Connessione del relè di allarme

¹⁾ Connessione interna del dispositivo. Non scollegare il connettore!

Collegamento della tensione di alimentazione per CM442



A0039627



A0039625


19 Collegamento dell'alimentazione utilizzando l'esempio di BASE2-H o -L

20 Schema elettrico completo utilizzando l'esempio di BASE2-H o -L


H Alimentatore 100...230 V c.a.

L Alimentatore 24 V c.a. o 24 V c.c.

Collegamento della tensione di alimentazione per CM444 e CM448



A0039626



A0039624

21 Collegamento dell'alimentazione utilizzando l'esempio di BASE2-E

22 Schema elettrico completo utilizzando l'esempio di BASE2-E e dell'alimentatore di espansione (B)

A Cavo di alimentazione interno

B Alimentatore

Collegamento dei moduli opzionali

Acquistando i moduli di espansione è possibile aggiungere delle funzioni al dispositivo.











AVVISO









Combinazioni hardware non accettabili (a causa di conflitti nell'alimentazione)





Misure non corrette o guasto completo del punto di misura a causa di accumulo di calore o sovraccarico

- ▶ Verificare se l'estensione pianificata per il controllore fa parte di una combinazione hardware consentita (Configuratore all'indirizzo www.endress.com/CM442 o .../CM444 o .../CM448).
- ▶ Considerare che per l'espansione del trasmettitore CM442 a quello CM444 o CM448, si devono espandere anche alimentatore e backplane. In questo caso si deve utilizzare anche il modulo di base BASE-E.
- ▶ Considerare sempre che il totale di tutti gli ingressi e le uscite in corrente non deve superare 8.
- ▶ Verificare che non siano utilizzati più di 2 moduli "DIO". Più di due moduli "DIO" non sono consentiti.
- ▶ Contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale per qualsiasi dubbio.

Panoramica di tutti i moduli disponibili

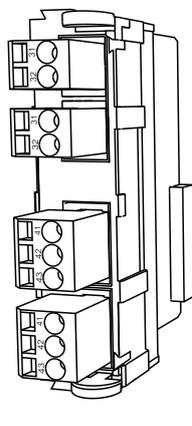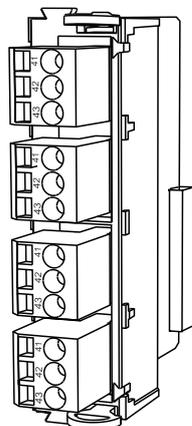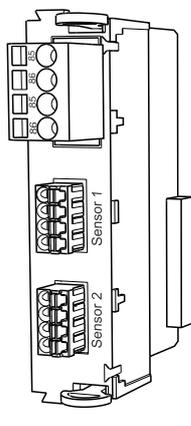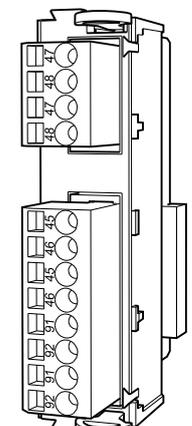
Nome del modulo				
AOR	2R	4R	2DS	DIO
 A0025110	 A0025111	 A0025113	 A0025113	 A0025114
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 uscite analogiche 0/4...20 mA ▪ 2 relè ▪ Codice d'ordine 71111053 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 relè ▪ Codice d'ordine 71125375 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 relè ▪ Codice d'ordine 71125376 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ingressi sensore digitali ▪ 2 sistemi di alimentazione per sensori digitali ▪ Codice d'ordine 71135631 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ingressi digitali ▪ 2 uscite digitali per tensione ausiliare ▪ Codice d'ordine 71135638
 A0033234	 A0033235	 A0025125	 A0025128	 A0025129

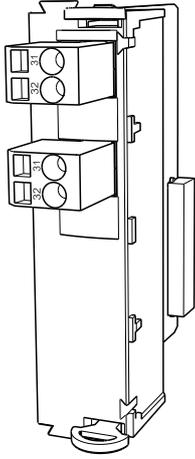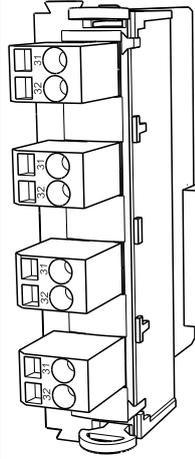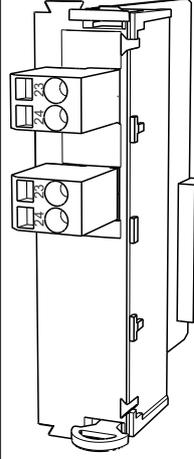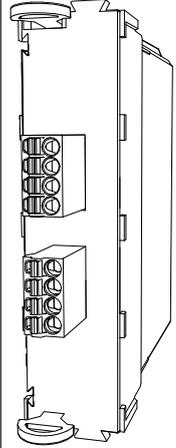Nome del modulo			
2AO	4AO	2AI	2DS Ex-i
 <p style="text-align: right;">A0025132</p>	 <p style="text-align: right;">A0025133</p>	 <p style="text-align: right;">A0025135</p>	 <p style="text-align: right;">A0046513</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 uscite analogiche 0/4...20 mA ▪ Codice d'ordine 71135632 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 uscite analogiche 0/4...20 mA ▪ Codice d'ordine 71135633 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ingressi analogici 0/4...20 mA ▪ Codice d'ordine 71135639 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 ingressi digitali a sicurezza intrinseca per sensori Memosens con approvazione Ex ▪ Gli ingressi sul modulo BASE2 sono disabilitati ▪ Il modulo 2DS EX-i è fornito nello slot destro del dispositivo ▪ Codice d'ordine 71477718
 <p style="text-align: right;">A0025137</p>	 <p style="text-align: right;">A0025138</p>	 <p style="text-align: right;">A0025139</p>	 <p style="text-align: right;">A0046512</p>

Nome del modulo	
485DP	485MB
	
<small>A0050399</small>	<small>A0050401</small>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Alimentazione a 5 V per terminazione PROFIBUS DP ■ RS485 (PROFIBUS DP) ■ Codice d'ordine 71575177 	<ul style="list-style-type: none"> ■ RS485 (Modbus RS485) ■ Codice d'ordine 71575178
	
<small>A0050400</small>	<small>A0050402</small>

i **PROFIBUS DP (modulo 485DP)**
 I contatti 95, 96 e 99 sono ponticellati nel connettore. In questo modo la comunicazione PROFIBUS non si interrompe se si scollega il connettore.

Messa a terra di protezione



A0048299

23 Guida di posizionamento del cavo e funzione associata

- | | |
|--|---|
| 1 Guida di posizionamento del cavo | 3 Clamp del cavo (fissaggio e messa a terra dei cavi del sensore) |
| 2 Bullone filettato (conduttore di terra, punto di messa a terra centrale) | |

Collegamento del sensore

Tipi di sensori con protocollo Memosens per area sicura

Sensori con protocollo Memosens

Tipi di sensore	Cavo del sensore	Sensori
Sensori digitali senza alimentatore interno addizionale	Con connessione a innesto e trasmissione induttiva del segnale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensori di pH ▪ Sensori di redox ▪ Sensori combinati ▪ Sensori di ossigeno (amperometrici e ottici) ▪ Sensori di conducibilità in base al principio di misura conduttivo ▪ Sensori di cloro (disinfezione)
	Cavo fisso	Sensori di conducibilità in base al principio di misura induttivo
Sensori digitali con alimentatore interno addizionale	Cavo fisso	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensori di torbidità ▪ Sensori per la misura di interfase ▪ Sensori di misura del coefficiente di assorbimento spettrale (SAC) ▪ Sensori di nitrati ▪ Sensori ottici per la misura di ossigeno ▪ Sensori ione selettivi


Se si collegano sensori CUS71D, valgono le seguenti regole:

- R
 - È possibile solo un sensore CUS71D; non è consentito un sensore addizionale.
 - Il secondo ingresso del sensore, inoltre, non può essere utilizzato per un altro tipo di sensore.
- Nessuna restrizione. Possono essere utilizzati tutti gli ingressi sensore in base alle specifiche.
- CM448
 - Se è collegato un sensore CUS71D, il numero di ingressi sensore utilizzabile è limitato a 4 max.
 - Questi 4 ingressi possono essere utilizzati tutti per sensori CUS71D.
 - È possibile qualsiasi combinazione del sensore CUS71D con altri sensori, ma il numero totale di sensori connessi non può essere superiore a 4.


Tipi di connessione

- Collegamento diretto del cavo del sensore ai morsetti a connettore del , modulo base-L, -H o -E (→  24 ff.)
- In opzione: connettore del cavo del sensore collegato all'ingresso M12 del sensore sul lato inferiore del dispositivo
Con questo tipo di connessione, il dispositivo fornito è già cablato in fabbrica (→  27).

Cavo del sensore collegato direttamente




A0039629



A0039622

24 privi di tensione di alimentazione addizionale

25 con tensione di alimentazione addizionale





A0033206

26 Sensori con e senza tensione di alimentazione addizionale sul modulo sensore 2DS

i Nel caso di un dispositivo a canale singolo:
Utilizzare l'ingresso Memosens di sinistra sul modulo base!

Connessione **mediante connettore M12**

Solo per connessione in area sicura.



Le versioni del dispositivo con ingresso M12 preinstallato sono già cablate alla consegna.

Considerare quanto segue:

- Il cablaggio interno del dispositivo è sempre il medesimo qualunque sia il tipo di sensore che si vuole collegare all'ingresso M12 ("plug & play").
- I cavi del segnale e dell'alimentazione sono assegnati nella testa del sensore in modo che i cavi di alimentazione RS e GR siano utilizzati (ad es. sensori ottici) o meno (ad es. sensori di pH e redox).

28 Assegnazione M12, in alto: ingresso, in basso: connettore (vista dall'alto in ambedue i casi)

27 Connettore M12 (ad es. sul modulo sensore)

1 Cavo del sensore con connettore M12


- 1 PK (24 V)
- 2 GY (messa a terra 24 V)
- 3 BN (3 V)
- 4 WH (messa a terra 3 V)
- 5 GN (Memosens)
- 6 YE (Memosens)
- 7, NC Non collegato

i Se i sensori a sicurezza intrinseca sono collegati al trasmettitore con il modulo di comunicazione sensori tipo 2DS Ex-i, la connessione a innesto M12 **non** è consentita.

Collegamento di sensori a sicurezza intrinseca al modulo di comunicazione sensori tipo 2DS Ex-i

Cavo del sensore collegato direttamente

- Collegare il cavo del sensore al morsetto a connettore del modulo di comunicazione sensori 2DS Ex-i.



29 Sensori senza tensione di alimentazione addizionale sul modulo di comunicazione sensori tipo 2DS Ex-i


i I sensori a sicurezza intrinseca per l'uso in atmosfere esplosive possono essere collegati solo al modulo di comunicazione sensori tipo 2DS Ex-i. Possono essere collegati solo i sensori accompagnati dai certificati (vedere XA).

Caratteristiche prestazionali

Tempo di risposta	Uscite in corrente $t_{90} = \text{max. } 500 \text{ ms}$ per un aumento da 0 a 20 mA Ingressi in corrente $t_{90} = \text{max. } 330 \text{ ms}$ per un aumento da 0 a 20 mA Ingressi e uscite digitali $t_{90} = \text{max. } 330 \text{ ms}$ per un aumento da low a high
Temperatura di riferimento	25 °C (77 °F)
Errore di misura per ingressi sensore	→ In base al tipo di sensore utilizzato (vedere documentazione di dettaglio)
Errore di misura per ingressi e uscite in corrente	Errori di misura tipici: $< 20 \mu\text{A}$ (con valori corrente $< 4 \text{ mA}$) $< 50 \mu\text{A}$ (con valori corrente 4...20 mA) tutte a 25 °C (77° F) Errore di misura aggiuntiva in base alla temperatura: $< 1,5 \mu\text{A/K}$
Tolleranza di frequenza per ingressi e uscite digitali	$\leq 1\%$
Risoluzione di ingressi e uscite in corrente	$< 5 \mu\text{A}$
Ripetibilità	→ In base al tipo di sensore utilizzato (vedere documentazione di dettaglio)


Montaggio

Requisiti di montaggio **Piastra di montaggio**



30 Piastra di montaggio. Unità ingegneristica: mm (in)

Tettuccio di protezione dalle intemperie




31 Dimensioni in mm (in)

Installazione

Montaggio su palina


i È richiesto un kit di montaggio (opzionale) per installare il dispositivo su tubo, palina o ringhiera (a sezione rettangolare o circolare, area di fissaggio 20...61 mm (0.79...2.40)).



32 Installazione su palina

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tettuccio di protezione dalle intemperie (opzionale) | 5 | Rondelle elastiche e dadi (kit per montaggio su palina) |
| 2 | Piastra di montaggio per palina (kit per montaggio su palina) | 6 | Tubo o guida (a sezione circolare/rettangolare) |
| 3 | Rondelle elastiche e dadi (kit per montaggio su palina) | 7 | Piastra di montaggio |
| 4 | Fascette per tubi (kit per montaggio su palina) | 8 | Aste filettate (kit per montaggio su palina) |

Montaggio su ringhiera




A0012668

33 Sistema di montaggio su ringhiera


- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tettuccio di protezione dalle intemperie (opzionale) | 6 | Tubo o guida (a sezione circolare/rettangolare) |
| 2 | Piastra di montaggio per palina (kit per montaggio su palina) | 7 | Piastra di montaggio |
| 3 | Rondelle elastiche e dadi (kit per montaggio su palina) | 8 | Aste filettate (kit per montaggio su palina) |
| 4 | Fascette per tubi (kit per montaggio su palina) | 9 | Viti (kit per montaggio su palina) |
| 5 | Rondelle elastiche e dadi (kit per montaggio su palina) | | |

Montaggio a parete



A0012686

34 Distanza di installazione in mm (in)



A0027798

35 Montaggio a parete

- | | |
|---|--|
| 1 | Parete |
| 2 | 4 fori da eseguire ¹⁾ |
| 3 | Piastra di montaggio |
| 4 | Viti Ø 6 mm (non comprese nella fornitura) |

¹⁾La dimensione dei fori da eseguire dipende dai tasselli da parete utilizzati. I tasselli da parete e le viti devono essere forniti dall'operatore.

Ambiente

Temperatura ambiente

CM442

- -20...60 °C (-4...140 °F)
- -20...50 °C (-4...122 °F) per i seguenti dispositivi:
 - CM442-BM
 - CM442-IE
 - CM442-CL
 - CM442-UM
 - CM442-CD

CM444

- Generalmente -20...55 °C (-4...131 °F), ad eccezione dei pacchetti indicati al secondo punto dell'elenco
- -20...50 °C (-4...122 °F) per i seguenti pacchetti:
 - CM444-**M40A7FI*****+...
 - CM444-**M40A7FK*****+...
 - CM444-**N40A7FI*****+...
 - CM444-**N40A7FK*****+...
 - CM444-**M4AA5F4*****+...
 - CM444-**M4AA5FF*****+...
 - CM444-**M4AA5FH*****+...
 - CM444-**M4AA5FI*****+...
 - CM444-**M4AA5FK*****+...
 - CM444-**M4AA5FM*****+...
 - CM444-**M4BA5F4*****+...
 - CM444-**M4BA5FF*****+...
 - CM444-**M4BA5FH*****+...
 - CM444-**M4BA5FI*****+...
 - CM444-**M4BA5FK*****+...
 - CM444-**M4BA5FM*****+...
 - CM444-**M4DA5F4*****+...
 - CM444-**M4DA5FF*****+...
 - CM444-**M4DA5FH*****+...
 - CM444-**M4DA5FI*****+...
 - CM444-**M4DA5FK*****+...
 - CM444-**M4DA5FM*****+...
 - CM444-BM
 - CM444-IE
 - CM444-CL
 - CM444-UM
 - CM444-CD

CM448

- Generalmente -20...55 °C (-4...131 °F), ad eccezione dei pacchetti indicati al secondo punto dell'elenco
- -20...50 °C (-4...122 °F) per i seguenti pacchetti:
 - CM448-***6AA*****+...
 - CM448-***8A4*****+...
 - CM448-***8A5*****+...
 - CM448-**28A3*****+...
 - CM448-**38A3*****+...
 - CM448-**48A3*****+...
 - CM448-**58A3*****+...
 - CM448-**68A3*****+...
 - CM448-**26A5*****+...
 - CM448-**36A5*****+...
 - CM448-**46A5*****+...
 - CM448-**56A5*****+...
 - CM448-**66A5*****+...
 - CM448-**22A7*****+...
 - CM448-**32A7*****+...
 - CM448-**42A7*****+...
 - CM448-**52A7*****+...
 - CM448-**62A7*****+...
 - CM448-**A6A5*****+...
 - CM448-**A6A7*****+...
 - CM448-**B6A5*****+...
 - CM448-**B6A7*****+...
 - CM448-**C6A5*****+...
 - CM448-**C6A7*****+...
 - CM448-**D6A5*****+...
 - CM448-**D6A7*****+...
 - CM448-BM
 - CM448-IE
 - CM448-CL
 - CM448-UM
 - CM448-CD

Temperatura di immagazzinamento

-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)

Umidità relativa

10 ... 95 %, in assenza di condensa

Grado di protezione

IP66/67 secondo IEC 60529

Classe di protezione della custodia NEMA Type 4X secondo UL 50E

Resistenza alle vibrazioni

Test ambientali

Test di vibrazione secondo DIN EN 60068-2

Test di vibrazione secondo DIN EN 60654-3

Montaggio su tubo o palina

Campo di frequenza 10...500 Hz (sinusoidale)

Ampiezza 10...57,5 Hz: 0,15 mm
57,5...500 Hz: 2 g¹⁾

Durata della prova 10 cicli di frequenza/ assi spaziali, in 3 direzioni (1 oct./min)

Montaggio a parete

Campo di frequenza 10...150 Hz (sinusoidale)

Ampiezza 10...12,9 Hz: 0,75 mm
12,9...150 Hz: 0,5 g¹⁾


Durata della prova 10 cicli di frequenza/ assi spaziali, in 3 direzioni (1 oct./min)

1) g ... accelerazione dovuta alla gravità (1 g ≈ 9,81 m/s²)

Compatibilità elettromagnetica	Emissione di interferenza e immunità alle interferenze secondo EN 61326-1, classe A per aree industriali
Sicurezza elettrica	IEC 61010-1, apparecchiatura in Classe I Bassa tensione: categoria sovratensioni II Ambiente < 3000 m (<9840 ft) s.l.m.
Grado inquinamento	Il prodotto è adatto per il grado di inquinamento 2.
Compensazione della pressione con riferimento all'ambiente	Il filtro in GORE-TEX è utilizzato come elemento di compensazione della pressione Garantisce la compensazione della pressione rispetto all'ambiente e protezione IP.

Costruzione meccanica

Dimensioni



36 Dimensioni della custodia da campo in mm (in)

A0012396

Peso	Dispositivo completo	2,1 kg ca. (4.63 lbs), in base alla versione
	Modulo singolo	Ca. 0,06 kg (0.13 lb)

Materiali

Base della custodia	PC-FR
Modulo del display	PC-FR
Pellicola del display e tasti funzione	PE
Tenuta della custodia	EPDM
Pannelli laterali del modulo	PC-FR
Custodia modulo 2DS Ex-i	PC-PBT
Copertura modulo	PBT GF30 FR
Guida di posizionamento del cavo	PBT GF30 FR, acciaio inox 1.4301 (AISI304)
Clamp	Acciaio inox 1.4301 (AISI304)
Viti	Acciaio inox 1.4301 (AISI304)
Pressacavi	Poliammide V0 secondo UL94
Elemento di disconnessione	PC-PBT GF30

Operabilità**separato**

Display grafico:

- Risoluzione: 240 x 160 pixel
- Retroilluminazione con funzione di spegnimento
- Sfondo del display rosso nel caso di allarmi per segnalare gli errori agli utenti
- Tecnologia transflessiva del display per ottenere il massimo contrasto, anche in ambienti molto luminosi


Concetto operativo

Il concetto operativo semplice e strutturato di questo dispositivo definisce nuovi standard:

- Operatività intuitiva con navigator e tasti di programmazione
- Veloce configurazione delle opzioni di misura specifiche per l'applicazione
- Configurazione e attività di diagnostica semplificate grazie al display alfanumerico
- Su ogni dispositivo sono disponibili tutte le lingue ordinabili




37 Funzionamento semplificato



38 Menu alfanumerico

Operatività locale




A0011764

39 Descrizione del funzionamento

- 1 Display (con sfondo rosso in caso di allarme)
- 2 Navigator (movimento rotazionale a passi/shuttle e funzione press/hold)
- 3 Tasti funzione (la funzione dipende dal menu)

Funzionalità a distanza

Mediante HART (ad es. con modem HART e FieldCare)



A0039620

40 Mediante modem HART

- 1 Modulo del dispositivo Base2 L, H o E: uscita in corrente 1 con HART
- 2 Modem HART per connessione al PC, ad es. Commubox FXA191 (RS232) o FXA195 ¹⁾ (USB)
- 3 Terminale portatile HART

¹⁾ Interruttore in posizione "on" (sostituisce il resistore)

Pacchetti di lingue

La lingua selezionata nella codifica del prodotto è la lingua operativa preimpostata in fabbrica. Tutte le altre lingue possono essere selezionate nel menu.

- Inglese (US)
- Tedesco
- Cinese (semplificato, Cina)
- Ceco
- Olandese
- Francese
- Italiano
- Giapponese
- Polacco
- Portoghese
- Russo
- Spagnolo
- Svedese
- Turco

- Ungherese
- Croato
- Vietnamita

La disponibilità di altre lingue può essere verificata mediante la codifica del prodotto all'indirizzo www.it.endress.com/cm442 o .../cm444 o .../cm448.

Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo www.endress.com sulla pagina del relativo prodotto:

1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
2. Aprire la pagina del prodotto.
3. Selezionare **Downloads**.

Informazioni per l'ordine

Pagina del prodotto

www.endress.com/cm442

www.endress.com/cm444

www.endress.com/cm448

Configuratore prodotto

1. **Configurare:** fare clic su questo pulsante nella pagina del prodotto.
 2. Selezionare **Extended selection**.
 - ↳ Il configuratore si apre in una finestra separata.
 3. Configurare il dispositivo in base alle esigenze selezionando l'opzione desiderata per ogni caratteristica.
 - ↳ In questo modo, sarà possibile generare un codice d'ordine valido e completo per il dispositivo.
 4. **Accettare:** aggiungere il prodotto configurato al carrello.
-  Per molti prodotti, è possibile scaricare anche i disegni CAD o 2D della versione del prodotto selezionato.
5. **CAD:** aprire questa scheda.
 - ↳ È visualizzata la finestra dei disegni. Si possono selezionare diverse visualizzazioni. Possono essere scaricate in formati selezionabili.

Fornitura

La fornitura comprende:

- 1 controllore multiparametro nella versione ordinata
- 1 piastra di montaggio
- 1 etichetta con lo schema di cablaggio (fissata in fabbrica all'interno del modulo del display)
- 1 copia cartacea delle Istruzioni di funzionamento brevi nella lingua ordinata
- Elemento di disconnessione (preinstallato nella versione area pericolosa tipo 2DS Ex-i)
- Istruzioni di sicurezza per area pericolosa (per versione per area pericolosa tipo 2DS Ex-i)

Accessori

Di seguito sono descritti gli accessori principali, disponibili alla data di pubblicazione di questa documentazione.

Gli accessori elencati sono tecnicamente compatibili con il prodotto nelle istruzioni.

1. Sono possibili limitazioni dell'abbinamento del prodotto con specifiche applicazioni. Verificare la conformità del punto di misura all'applicazione. Questo è responsabilità dell'operatore del punto di misura.

2. Prestare attenzione alle informazioni nelle istruzioni per tutti i prodotti, in particolare ai dati tecnici.
3. Per quelli non presenti in questo elenco, contattare l'ufficio commerciale o l'assistenza Endress +Hauser locale.

Accessori specifici del dispositivo

Tettuccio di protezione dalle intemperie

CYY101

- Tettuccio di protezione dalle intemperie per trasmettitore da campo
- Indispensabile per l'installazione in campo
- Materiale: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Codice d'ordine CYY101-A

Kit di montaggio su palina

Kit di montaggio su palina per CM44x

- Serve per fissare la custodia da campo a paline e tubi orizzontali e verticali
- Codice d'ordine 71096920

Cavi di misura

Cavo dati Memosens CYK10

- Per sensori digitali con tecnologia Memosens
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cyk10



Informazioni tecniche TI00118C

Cavo dati Memosens CYK11

- Cavo di estensione per sensori digitali con protocollo Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.it.endress.com/cyk11



Informazioni tecniche TI00118C

Sensori

Elettrodi in vetro

Memosens CPS11E

- Sensore di pH per applicazioni standard nei settori dell'ingegneria di processo e ambientale
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps11e



Informazioni tecniche TI01493C

Memosens CPS41E

- Sensore di pH per tecnologia di processo
- Con diaframma in ceramica ed elettrolita KCl liquido
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto www.endress.com/cps41e



Informazioni tecniche TI01495C

Memosens CPS71E

- Sensore di pH per applicazioni di processo chimiche
- Con trappola ionica per riferimento resistente alla contaminazione
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps71e



Informazioni tecniche TI01496C

Memosens CPS91E

- Sensore di pH per fluidi fortemente inquinati
- Con diaframma a giunzione
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps91e



Informazioni tecniche TI01497C

Memosens CPS31E

- Sensore di pH per applicazioni standard in acqua potabile e acqua di piscina
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps31e



Informazioni tecniche TI01574C

Memosens CPS61E

- Sensore di pH per bioreattori nell'industria farmaceutica e alimentare
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore di prodotto sulla pagina del dispositivo: www.endress.com/cps61e



Informazioni tecniche TI01566C

Memosens CPF81E

- Sensore di pH per l'industria mineraria e il trattamento delle acque potabili e reflue industriali
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cpf81e



Informazioni tecniche TI01594C

*Elettrodi di pH smaltati***Ceramax CPS341D**

- Elettrodo di pH con parte sensibile in enamel
- Rispetta i massimi requisiti per accuratezza di misura, pressione, temperatura, sterilità e durata
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps341d



Informazioni tecniche TI00468C

*Sensori di redox***Memosens CPS12E**

- Sensore di redox per applicazioni standard nei settori dell'ingegneria di processo e ambientale
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps12e



Informazioni tecniche TI01494C

Memosens CPS42E

- Sensore di redox per tecnologia di processo
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps42e



Informazioni tecniche TI01575C

Memosens CPS72E

- Sensore di redox per applicazioni di processo chimiche
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps72e



Informazioni tecniche TI01576C

Memosens CPF82E

- Sensore di redox per l'industria mineraria e il trattamento delle acque potabili e reflue industriali
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cpf82e



Informazioni tecniche TI01595C

Memosens CPS92E

- Sensore di redox per l'impiego in fluidi molto inquinati
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps92e



Informazioni tecniche TI01577C

Memosens CPS62E

- Sensore di redox per applicazioni igieniche e sterili
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps62e

 Informazioni tecniche TI01604C

Sensori di pH ISFET

Memosens CPS47E

- Sensore ISFET per la misura del pH
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps47e

 Informazioni tecniche TI01616C

Memosens CPS77E

- Sensore ISFET per la misura di pH sterilizzabile e adatto all'autoclave
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del dispositivo: www.endress.com/cps77e

 Informazioni tecniche TI01396

Memosens CPS97E

- Sensore ISFET per la misura del pH
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cps97e

 Informazioni tecniche TI01618C

Sensori pH/ORP combinati

Memosens CPS16E

- Sensore di pH/redox per applicazioni standard nei settori della tecnologia di processo e dell'ingegneria ambientale
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore di prodotto sulla pagina del dispositivo: www.endress.com/cps16e

 Informazioni tecniche TI01600C

Memosens CPS76E

- Sensore di pH/redox per tecnologia di processo
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore di prodotto sulla pagina del dispositivo: www.endress.com/cps76e

 Informazioni tecniche TI01601C

Memosens CPS96E

- Sensore di pH/redox per fluidi fortemente inquinati e solidi sospesi
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore di prodotto sulla pagina del dispositivo: www.endress.com/cps96e

 Informazioni tecniche TI01602C

Sensori di conducibilità in base al principio di misura induttivo

Indumax CLS50D

- Sensore di conducibilità induttivo ad alta durabilità
- Per applicazioni standard e in area pericolosa
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cls50d

 Informazioni tecniche TI00182C

Indumax H CLS54D

- Sensore induttivo di conducibilità
- Con costruzione igienica certificata per alimentari, bevande, prodotti farmaceutici e biotecnologie
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cls54d



Informazioni tecniche TI00508C

*Sensori di conducibilità in base al principio di misura conduttivo***Memosens CLS15E**

- Sensore digitale di conducibilità per misure in acqua pura e ultrapura
- Misura conduttiva
- Con Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cls15e



Informazioni tecniche TI01526C

Memosens CLS16E

- Sensore digitale di conducibilità per misure in acqua pura e ultrapura
- Misura conduttiva
- Con Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cls16e



Informazioni tecniche TI01527C

Memosens CLS21E

- Sensori di conducibilità digitali per fluidi con conducibilità media o alta
- Misura conduttiva
- Con Memosens 2.0
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cls21e



Informazioni tecniche TI01528C

Memosens CLS82E

- Sensore di conducibilità igienico
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore di prodotto sulla pagina del dispositivo: www.endress.com/cls82e



Informazioni tecniche TI01529C

*Sensori di ossigeno***Memosens COS22E**

- Sensore di ossigeno amperometrico con stabilità di misura elevata dopo ripetuti cicli di sterilizzazione
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cos22e



Informazioni tecniche TI01619C

Memosens COS51E

- Sensore di ossigeno amperometrico per acqua, acque reflue e utility
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cos51e



Informazioni tecniche TI01620C

Oxymax COS61D

- Sensore ottico di ossigeno per misure in acque potabili e industriali
- Principio di misura: fluorescenza
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cos61d



Informazioni tecniche TI00387C

Memosens COS81E

- Sensore di ossigeno ottico igienico con la massima stabilità di misura su più cicli di sterilizzazione
- Digitale con tecnologia Memosens 2.0
- Configuratore di prodotto online sulla pagina del dispositivo: www.endress.com/cos81e

 Informazioni tecniche TI01558C

Sensori di disinfezione

Memosens CCS51D

- Sensore per la misura del cloro libero disponibile
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/ccs51d

 Informazioni tecniche TI01423C

Sensori ionoselettivi

ISEmax CAS40D

- Sensori ione selettivi
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cas40d

 Informazioni tecniche TI00491C

Sensori di torbidità

Turbimax CUS51D

- Per le misure nefelometriche di torbidità e solidi sospesi in acque reflue
- Metodo a luce diffusa, a 4 lobi di emissione
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cus51d

 Informazioni tecniche TI00461C

Turbimax CUS52D

- Sensore Memosens igienico per misura di torbidità in acqua potabile, di processo e di servizio
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cus52d

 Informazioni tecniche TI01136C

Sensori di SAC e nitrati

Viomax CAS51D

- Misura di SAC e nitrati in acque potabili e reflue
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cas51d

 Informazioni tecniche TI00459C

Misura di interfase

Turbimax CUS71D

- Sensore a immersione per misura di interfase
- Sensore di interfase a ultrasuoni
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cus71d

 Informazioni tecniche TI00490C

Sensori spettrometro

Memosens Wave CAS80E

- Misura di diversi parametri in fluidi liquidi
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore online sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cas80e

 Informazioni tecniche TI01522C

*Sensore fluorescenza***Memosens CFS51**

- Sensore di misura della fluorescenza
- Con tecnologia Memosens
- Configuratore prodotto sulla pagina del prodotto: www.endress.com/cfs51



Informazioni tecniche TI01630C

Accessori relativi alle comunicazioni**Device Care SFE100**

- Configurazione dei dispositivi Endress+Hauser
- Installazione rapida e semplice, aggiornamento online delle applicazioni, connessione ai dispositivi con un solo clic
- Identificazione automatica dell'hardware e aggiornamento del catalogo dei driver
- Configurazione del dispositivo con DTM



Informazioni tecniche Device Care SFE100, TI01134S

CommuboxFXA195

Comunicazione HART a sicurezza intrinseca con FieldCare mediante la porta USB



Informazioni tecniche TI00404F

CommuboxFXA291

Collega l'interfaccia CDI Service dei misuratori con la porta USB del PC o laptop



Informazioni tecniche TI00405C

Adattatore SWA70 wireless HART

- Connessione wireless del dispositivo
- Di semplice integrazione, offre protezione dei dati e sicurezza di trasmissione, utilizzabile in parallelo con altre reti wireless, complessità di cablaggio minima



Informazioni tecniche TI00061S

Software Field Data Manager MS20/21

- Software per PC, per la gestione centrale dei dati
- Visualizzazione della serie di misure e degli eventi del registro
- Database SQL per l'archiviazione sicura dei dati

FieldCare SFE500

- Strumento universale per la configurazione e la gestione dei dispositivi da campo
- Fornito con una libreria completa di DTM (Device Type Manager) certificati per il funzionamento dei dispositivi da campo Endress+Hauser
- Ordine in base alla codifica del prodotto
- www.it.endress.com/sfe500

Memobase Plus CYZ71D

- Software per PC per semplificare la taratura in laboratorio
- Visualizzazione e documentazione della gestione del sensore
- Tarature del sensore archiviate nel database
- Configuratore on-line sulla pagina del prodotto: www.it.endress.com/cyz71d



Informazioni tecniche TI00502C

Accessori specifici per l'assistenza**Funzionalità aggiuntive***Moduli di estensione hardware***Kit, modulo di espansione AOR**

- 2 relè, 2 uscite analogiche 0/4...20 mA
- Codice d'ordine 71111053

Kit, modulo di espansione 2R

- 2 relè
- Codice d'ordine 71125375

Kit, modulo di espansione 4R

- 4 relè
- Codice d'ordine 71125376

Kit, modulo di espansione 2AO

- 2 uscite analogiche 0/4...20 mA
- Codice d'ordine 71135632

Kit, modulo di espansione 4AO

- 4 uscite analogiche 0/4...20 mA
- Codice d'ordine 71135633

Kit, modulo di espansione 2DS

- 2 sensori digitali, Memosens
- Codice d'ordine 71135631

Kit per modulo di espansione 2DS Ex-i

- 2 sensori digitali, Memosens, approvazione Ex
- Codice d'ordine 71477718

Kit, modulo di espansione 2AI

- 2 ingressi analogici 0/4...20 mA
- Codice d'ordine 71135639

Kit, modulo di espansione DIO

- 2 ingressi digitali
- 2 uscite digitali
- Tensione di alimentazione ausiliaria per l'uscita digitale
- Codice d'ordine 71135638

Kit di aggiornamento, modulo di espansione 485

- Modulo di espansione 485DP
- PROFIBUS DP
- Codice d'ordine 71575177

Kit di aggiornamento, modulo di espansione 485MB

- Modulo di espansione 485MB
- Modbus RS485
- Codice d'ordine 71575178

Kit CM442: kit di aggiornamento a CM444/CM448

- Alimentatore di espansione 100...230 V c.a. e backplane di espansione
- Modulo di base BASE2-E
- Quando si ordina il kit, indicare il numero di serie del dispositivo.
- Codice d'ordine: 71470973

Kit CM442: kit di aggiornamento a CM444/CM448

- Alimentatore di espansione 24 V c.c. e backplane di espansione
- Modulo di base BASE2-E
- Quando si ordina il kit, indicare il numero di serie del dispositivo.
- Codice d'ordine: 71470975

Firmware e codici di attivazione

Scheda SD con firmware Liquiline

- Industrial Flash Drive, 1 GB
- Codice d'ordine 71127100



Quando si ordina il codice di attivazione, si deve indicare il numero di serie del dispositivo.

Kit CM442: codice di attivazione per il secondo ingresso digitale del sensore

Codice d'ordine 71114663

Codice di attivazione per il controllo remoto

- Richiede un ingresso in corrente o la comunicazione del bus di campo
- Codice d'ordine: 71211288

Codice di attivazione per la commutazione del campo di misura

- Richiede ingressi digitali o comunicazione di bus di campo
- Codice d'ordine: 71211289

Codice di attivazione per ChemocleanPlus

- Richiede relè o uscite digitali oppure comunicazione del bus di campo e ingressi digitali opzionali
- Codice d'ordine: 71239104

Codice di attivazione per verifica e monitoraggio Heartbeat

Codice d'ordine: 71367524

Codice di attivazione per pacchetto matematico

- Editor di formula
- Codice d'ordine: 71367541

Codice di attivazione per Ethernet/IP e web server

Codice d'ordine XPC0018

Codice di attivazione per Modbus TCP e web server

Codice d'ordine XPC0020

Codice di attivazione per web server per BASE2

Codice d'ordine XPC0021

Codice di attivazione per PROFINET e web server Base2

Codice d'ordine XPC0022

Codice di attivazione per HART

Codice d'ordine XPC0023

Codice di attivazione per Profibus DP per modulo 485

Codice d'ordine XPC0024

Codice di attivazione per modulo 485 Modbus RS485

Codice d'ordine XPC0025

Codice di attivazione per ingressi/uscite Liquiline

Codice d'ordine XPC0026

Codice di attivazione per funzioni aggiuntive

Codice d'ordine XPC0027

Componenti di sistema**RIA14, RIA16**

- Indicatore da campo per l'integrazione nei circuiti 4-20 mA
- RIA14 in custodia metallica antideflagrante



Informazioni tecniche TI00143R e TI00144R

RIA15

- Unità di visualizzazione per il processo digitale per l'integrazione nei circuiti 4-20 mA
- Montaggio a fronte quadro
- Con comunicazione HART opzionale



Informazioni tecniche TI01043K

Altri accessori**Scheda SD**

- Industrial Flash Drive, 1 GB
- Codice d'ordine: 71110815

Pressacavi**Kit CM44x: pressacavo M**

- Set, 6 pezzi
- Codice d'ordine: 71101768

Kit CM44x: pressacavo NPT

- Set, 6 pezzi
- Codice d'ordine: 71101770

Kit CM44x: pressacavo G

- Set, 6 pezzi
- Codice d'ordine: 71101771

Kit CM44x: tappo cieco per pressacavo

- Set, 6 pezzi
- Codice d'ordine: 71104942

Ingresso incorporato M12 e giunzione del cavo con nastro in Velcro**Kit CM442/CM444/CM448/CSF48: ingresso M12 incorporato per sensori digitali**

- Già intestato
- Codice d'ordine 71107456

Kit CM442/CM444/CM448/CSF48: ingresso M12 incorporato per PROFIBUS DP/Modbus RS485

- Codifica B, già intestato
- Codice d'ordine 71140892

Kit CM442/CM444/CM448/CSF48: ingresso M12 incorporato per Ethernet

- Codifica D, già intestato
- Codice d'ordine 71140893

Kit: ingresso CDI esterno, completo

- Kit di ammodernamento per interfaccia CDI Service, con cavi di collegamento già intestati
- Codice d'ordine: 51517507

Giunzione del cavo con nastro in velcro

- 4 pezzi, per il cavo del sensore
- Codice d'ordine 71092051



www.addresses.endress.com
