


Documentation spéciale

Micropilot NMR81/84

Manuel de sécurité fonctionnelle

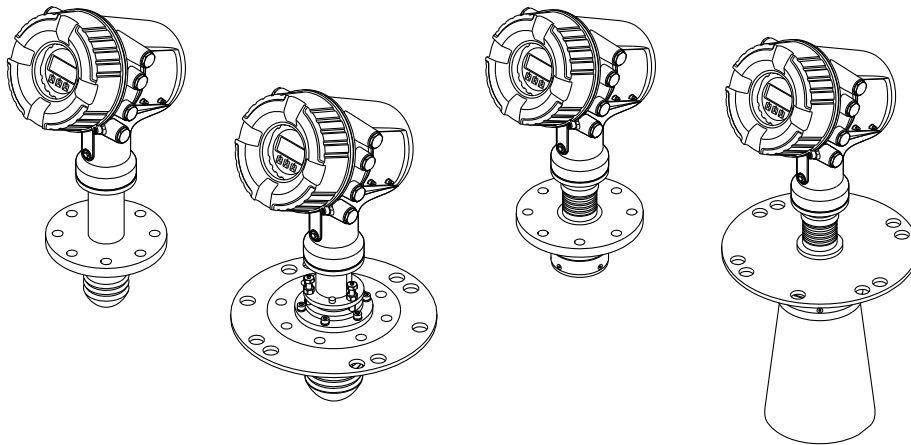

Radar à émission libre pour liquides avec signal de sortie 4...20 mA et sortie tout ou rien

Sommaire

Déclaration de conformité	3
Autres valeurs caractéristiques importantes pour la sécurité	5
Durée de vie utile des composants électriques	5
Informations relatives au document	6
Fonction du document	6
Utilisation du document	6
Symboles utilisés	6
Documentation d'appareil complémentaire	7
Types d'appareils autorisés	8
Marquage SIL sur la plaque signalétique	9
Fonction de sécurité	9
Définition de la fonction de sécurité	9
Signal de sécurité	9
Restrictions concernant l'utilisation dans des applications de sécurité	10
Utilisation dans des systèmes de protection	12
Comportement de l'appareil pendant le fonctionnement ...	12
Configuration des paramètres pour les applications de sécurité	13
Test de fonctionnement périodique	19
Cycle de vie	26
Exigences imposées au personnel	26
Montage	26
Mise en service	26
Fonctionnement	26
Maintenance	26
Réparation	27
Modification	27
Annexe	28
Structure du système de mesure	28
Test de fonctionnement périodique	30
Compléments d'informations	30

Déclaration de conformité

SIL_00142_01.16

Endress+Hauser 
People for Process Automation

Declaration of Conformity

Functional Safety according to IEC 61508:2010
Supplement 1 / NE130 Form B.1

Endress+Hauser GmbH+Co. KG, Hauptstraße 1, 79689 Maulburg

declares as manufacturer, that the following level radar device

Micropilot NMR81/84

is suitable for the use in safety-instrumented systems up to SIL2 according to IEC 61508:2010.

In safety instrumented systems according IEC 61508 and IEC 61511, the instructions of the Safety Manual have to be followed.

Maulburg, 30-November-2016
Endress+Hauser GmbH+Co. KG

i. v.


Dr. Arno Götz
Dept. Manager Product Safety
Research & Development

i. v.


Thorsten Springmann
Dept. Manager Continuous
Level Measurement
Research & Development

1/2

A0032634

SIL_00142_01.16



General			
Device designation and permissible types	Level radar, Micropilot NMR8x - *****+LA		
Order code selection	x = 1,4		
Safety-related output signal ^{a) b)}	^{a)} 4...20 mA	^{b)} relay contact	
Fault current ^{a)} Fault ^{b)}	^{a)} ≤ 3,6 mA ; ≥ 21 mA	^{b)} open contact	
Process variable/function	Level measurement, Current in measurement		
Safety function(s)	MIN, MAX, Range		
Device type acc. to IEC 61508-2	<input type="checkbox"/> Type A	<input checked="" type="checkbox"/> Type B	
Operating mode	<input checked="" type="checkbox"/> Low Demand Mode	<input checked="" type="checkbox"/> High Demand Mode	<input type="checkbox"/> Continuous Mode
Valid hardware version	As of manufacturing date after Nov.28,2016		
Valid software version	As of version 01.02.ZZ		
Safety manual	SD01891G		
Type of evaluation (check only <u>one</u> box)	<input checked="" type="checkbox"/> Complete HW/SW evaluation parallel to development incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 <input type="checkbox"/> Evaluation of "Proven-in-use" performance for HW/SW incl. FMEDA and change request acc. to IEC 61508-2, 3 <input type="checkbox"/> Evaluation of HW/SW field data to verify „prior use“ acc. to IEC 61511 <input type="checkbox"/> Evaluation by FMEDA acc. to IEC 61508-2 for devices w/o software		
Evaluation through / certificate no.	Micropilot NMR81/84 Assessment report SIL2 (22.11.2016)		
Test documents	Development documents	Test reports	Data sheets
SIL - Integrity			
Systematic safety integrity		<input checked="" type="checkbox"/> SIL 2 capable	<input type="checkbox"/> SIL 3 capable
Hardware safety integrity	Single channel use (HFT = 0)	<input checked="" type="checkbox"/> SIL 2 capable	<input type="checkbox"/> SIL 3 capable
	Multi channel use (HFT ≥ 1)	<input checked="" type="checkbox"/> SIL 2 capable	<input type="checkbox"/> SIL 3 capable
FMEDA			
Safety function	MIN, MAX, Range		
λ_{OU} ^{1),2)}	196 FIT		
λ_{DO} ^{1),2)}	7930 FIT		
λ_{SU} ^{1),2)}	3880 FIT		
λ_{SD} ^{1),2)}	47 FIT		
λ_{total} ^{1),2)}	12055 FIT		
SFF (Safe Failure Fraction)	98 %		
PFD _{avg} (T ₁ = 1 year) ²⁾ (single channel architecture)	9,24 · 10 ⁻⁴		
PFD _{avg} (T ₁ = 2 years) ²⁾ (single channel architecture)	1,78 · 10 ⁻³		
PFH	1,96 · 10 ⁻⁷ h ⁻¹		
PTC ³⁾	depending on the proof test, see safety manual		
MTBF ⁴⁾	25 years		
Diagnostic test interval ⁵⁾	60 min		
Fault reaction time ⁶⁾	60 s		
Declaration			
<input checked="" type="checkbox"/>	Our internal company quality management system ensures information on safety-related systematic faults which become evident in the future		

¹⁾ FIT = Failure In Time, number of failures per 10⁹ h
²⁾ Valid for average ambient temperature up to +40 °C (+104 °F)
 For continuous operation at ambient temperature close to +60 °C (+140 °F), a factor of 2.1 should be applied
³⁾ PTC = Proof Test Coverage
⁴⁾ MTBF (Mean Time Between Failures) is the predicted elapsed time between inherent failures of a system during operation in accordance to Siemens SN29500. Considered are failures of the electronics with functional relevance.
⁵⁾ All diagnostic functions are performed at least once within the diagnostic test interval
⁶⁾ Maximum time between error recognition and error response

Autres valeurs caractéristiques importantes pour la sécurité

Caractéristiques selon IEC 61508	Valeur
Fonction de sécurité	MIN, MAX, gamme
SIL	SIL 2 (architecture monovoie 1oo1),
HFT	0
Type d'appareil	B
Mode de fonctionnement	Mode demande faible, mode demande élevée
SFF	98 %
MTTR	8 h
Intervalle de temps recommandé pour le test de fonctionnement périodique T_1	3 ans
λ_{sd}	47 FIT
λ_{su}	3 880 FIT
λ_{dd}	7 930 FIT
λ_{du}	196 FIT
$\lambda_{tot}^{1)}$	12 055 FIT
PF _{avg} pour $T_1 = 1 \text{ an}^{2)}$	$9,24 \times 10^{-4}$
PF _{avg} pour $T_1 = 2 \text{ ans}^{2)}$	$1,78 \times 10^{-3}$
PFH	$1,96 \times 10^{-7} \text{ h}^{-1}$
MTBF ¹⁾	25 ans
Intervalle de test de diagnostic ³⁾	60 min
Temps de réaction sur défaut ⁴⁾	60 s
2. Temps de réaction du système ⁵⁾	En "mode Expert" : Configurable par l'utilisateur

- 1) Selon Siemens SN29500. Cette valeur tient compte des types de défaillances concernant la fonction des composants électroniques.
- 2) Valable pour température ambiante jusqu'à +40 °C (+104 °F). En mode de fonctionnement continu, si la température moyenne se situe aux alentours de +50 °C (+122 °F), un facteur de 1,3 devrait être pris en compte.
- 3) Pendant ce temps, toutes les fonctions de diagnostic sont exécutées au moins une fois.
- 4) Temps entre la détection du défaut et la réponse au défaut.
- 5) Temps de réponse à un échelon selon DIN EN 61298-2 : 49 s

Durée de vie utile des composants électriques

Les taux de défaillance établis des composants électriques s'appliquent au sein de la durée de vie utile selon IEC 61508-2:2010 section 7.4.9.5, note 3. Conformément à la norme DIN EN 61508-2:2011 section 7.4.9.5, note nationale N3, des mesures appropriées prises par le fabricant et l'utilisateur peuvent prolonger la durée de vie utile.

Informations relatives au document

Fonction du document

Le document fait partie du manuel de mise en service et sert de référence pour les paramètres et notes spécifiques à l'application.



- Informations générales relatives à la sécurité fonctionnelle : SIL
- Les informations générales concernant SIL sont disponibles :
dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser :
www.fr.endress.com/SIL

Utilisation du document

Informations relatives à la structure du document



Pour la disposition des paramètres selon le menu **Operation**, le menu **Setup**, le menu **Diagnostics**, avec une brève description, voir le manuel de mise en service de l'appareil

Symboles utilisés

Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
	DANGER ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
	AVERTISSEMENT ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
	ATTENTION ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne.
	AVIS ! Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

Symboles pour certains types d'information

Symbole	Signification
 <small>A0011193</small>	Conseil Signale des informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation
	Renvoi à la page
	Renvoi au schéma
1, 2, 3...	Série d'étapes

Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3,...	Repères
1, 2, 3...	Série d'étapes
A, B, C, ...	Vues

Documentation d'appareil
complémentaire

Documentation	Commentaire
Information technique : <ul style="list-style-type: none"> ▪ TI01252G/00 (NMR81) ▪ TI01253G/00 (NMR84) 	La documentation est disponible sur Internet : → www.fr.endress.com
Manuel de mise en service <ul style="list-style-type: none"> ▪ BA01450G/00 (NMR81) ▪ BA01453G/00 (NMR84) 	La documentation est disponible sur Internet : → www.fr.endress.com
Instructions condensées (HART) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KA01194G/00 (NMR81) ▪ KA01197G/00 (NMR84) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le document est fourni avec l'appareil. ▪ La documentation est disponible sur Internet : → www.fr.endress.com
Les Conseils de sécurité dépendent de l'option "Agrément" sélectionnée.	Des Conseils de sécurité supplémentaires (XA, ZE) sont fournis avec la version d'appareil certifiée. Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour les Conseils de sécurité pertinents.




Ce manuel de sécurité supplémentaire s'applique en plus du manuel de mise en service, de l'Information technique et des Conseils de sécurité ATEX. La documentation d'appareil complémentaire doit être observée pendant l'installation, la mise en service et le fonctionnement. Les exigences spécifiques à la fonction de protection sont décrites dans le présent manuel de sécurité.

- Version firmware valide : à partir de 01.02.zz (→ plaque signalétique de l'appareil)
- Version hardware valide (électronique) : à partir de la date de production 23.11.2016 (→ plaque signalétique de l'appareil)

Marquage SIL sur la plaque signalétique



Les appareils certifiés SIL sont marqués avec le symbole suivant sur la plaque signalétique : 

Fonction de sécurité

Définition de la fonction de sécurité

Les fonctions de sécurité de l'appareil sont les suivantes :

Fonction de sécurité 1 (mesure de niveau)

- Surveillance du seuil maximum du niveau (sécurité antidébordement)
- Surveillance du seuil minimum du niveau (protection contre la marche à vide)
- Surveillance d'une gamme de niveau

Les fonctions de sécurité comprennent la mesure du niveau d'un liquide.

Fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant)

Surveillance de l'entrée courant

La fonction de sécurité comprend la mesure du courant d'un appareil connecté.

Signal de sécurité

Numérique

Le signal de sécurité de l'appareil est le contact de relais fermé de la sortie numérique. Toutes les mesures de sécurité se réfèrent exclusivement à ce signal.

La valeur de niveau (fonction de sécurité 1 : mesure de niveau) ou le courant de l'entrée analogique (fonction de sécurité 2 : mesure de l'entrée courant) sont convertis correctement en une valeur de sortie numérique. Le contact de relais est fermé dans la gamme de validité et ouvert en dehors de cette gamme.

Le signal de sortie de sécurité est transmis à une unité logique aval, par ex. un automate programmable ou un transmetteur de signaux de seuil, où il est surveillé par rapport aux événements suivants :

- Dépassement par excès et/ou par défaut d'une limite de niveau spécifique.
- Occurrence d'une erreur, par ex. contact ouvert (interruption du câble de liaison signal).



En cas de défaut, il faut s'assurer que l'équipement sous contrôle atteint ou conserve un état sûr.

Analogique

Le signal de sécurité de l'appareil est le signal de la sortie analogique 4...20 mA. Toutes les mesures de sécurité se réfèrent exclusivement à ce signal.

L'appareil peut également communiquer via HART à des fins d'information et contient toutes les fonctions HART avec les informations d'appareil additionnelles.

Le signal de sortie de sécurité est transmis à une unité logique aval, par ex. un automate programmable ou un transmetteur de signaux de seuil, où il est surveillé par rapport aux événements suivants :

- Dépassement par excès et/ou par défaut d'une limite de niveau spécifique.
- L'occurrence d'un défaut, par ex. courant de défaut ($\leq 3,6$ mA, $\geq 21,0$ mA), interruption ou court-circuit du câble de signal).




En cas de défaut, il faut s'assurer que l'équipement sous contrôle atteint ou conserve un état sûr.

Restrictions concernant l'utilisation dans des applications de sécurité

- Le système de mesure doit être utilisé correctement pour l'application spécifique, en tenant compte des propriétés du produit et des conditions ambiantes. Il convient de suivre scrupuleusement les instructions du manuel de mise en service concernant les situations critiques du process et les conditions de montage. Les limites spécifiques à l'application doivent être observées.
- Informations sur le signal de sécurité, (→ 9).
- Les spécifications figurant dans le manuel de mise en service ne doivent pas être dépassées, (→ 7).
- Les restrictions suivantes s'appliquent à une utilisation de sécurité :
 - Les interférences électromagnétiques puissantes se manifestant sous forme d'impulsions sur la ligne peuvent provoquer des écarts $\geq \pm 2\%$ transitoires (< 1 s) du signal de sortie. Pour cette raison, un filtrage avec une constante de temps de ≥ 1 s devrait être appliqué dans l'unité logique aval.
 - La plage d'erreur est spécifique à l'appareil et est définie selon les modes FMEDA (modes de défaillance, effets et analyse de diagnostics) à la livraison. Cela englobe tous les facteurs d'influence décrits dans l'information technique (par ex. non-linéarité, non-reproductibilité, hystérésis, dérive du zéro, dérive de température, perturbations électromagnétiques). Selon IEC / EN 61508, les défaillances liées à la sécurité sont classées dans différentes catégories, voir la table suivante. La table montre les implications pour le signal de sécurité de la sortie analogique et pour l'incertitude de mesure.

Défaut lié à la sécurité	Explication	Implications pour le signal de sortie de sécurité	Implications pour l'incertitude de mesure (Position, voir figure → 11)
Pas de défaut de l'appareil	"Safe" : Pas de défaut	None	1 Est dans la spécification (voir TI, BA...)
λ_{SD}	"Safe detected" : défaillance non dangereuse pouvant être détectée	Entraîne la signalisation du mode failsafe par le signal de sortie (voir, → 12)	3 Pas d'implications
λ_{SU}	"Safe undetected" : défaillance non dangereuse ne pouvant pas être détectée	Est dans la plage d'erreur définie	2 Peut être au-delà de la spécification
λ_{DD}	"Dangerous detected" : défaillance dangereuse pouvant être détectée (Diagnostic au sein de l'appareil)	Entraîne la signalisation du mode failsafe par le signal de sortie (voir, → 12)	3 Pas d'implications
λ_{DU}	"Dangerous undetected" : défaillance dangereuse ne pouvant pas être détectée	Peut être en dehors de la plage d'erreur définie	4 Peut être en dehors de la plage d'erreur définie

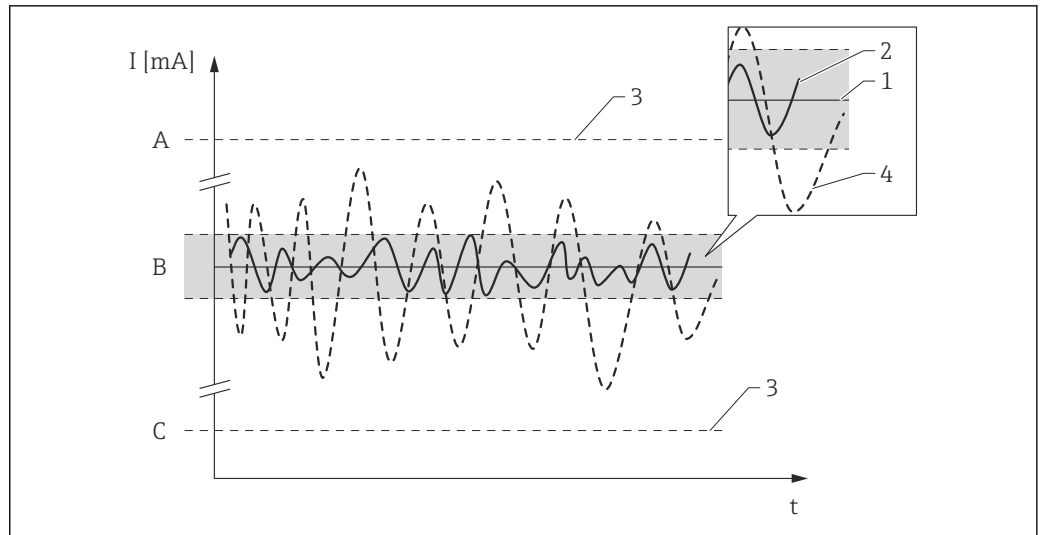

A0025264

- A Alarme haute ≥ 21 mA
- B Plage d'erreur ± 2 %
- C Alarme basse $\leq 3,6$ mA

Défaillances dangereuses non détectées dans ce scénario

Un défaut dangereux non détecté est considéré comme un signal de sortie incorrect qui s'écarte de la valeur réelle de plus de 2 %, mais qui est toujours dans la gamme de 4...20 mA ou le contact de relais reste fermé.

Utilisation dans des systèmes de protection

Comportement de l'appareil pendant le fonctionnement

Numérique

Comportement de l'appareil à la mise sous tension

Lorsqu'il est mis sous tension, l'appareil passe par une phase de diagnostic durant environ 30 secondes. Le contact de relais est ouvert au cours de cette période. Pendant la phase de diagnostic, aucune communication n'est possible via l'interface de service (CDI) ou via un protocole (HART, V1, Modbus).

Comportement de l'appareil en mode demande fonction de sécurité

L'appareil affiche une valeur de sortie numérique correspondant au seuil devant être surveillé. Le contact de relais est fermé dans la gamme de validité et ouvert en dehors de cette gamme. Cela doit être surveillé et traité en conséquence par une unité logique connectée.

Comportement de l'appareil en présence d'alarmes et d'avertissements

Le contact de relais est toujours ouvert en cas d'alarme ou d'avertissement. Cela doit être surveillé et faire l'objet d'un traitement ultérieur dans une unité logique connectée.

Messages d'alarme et d'avertissement

Des informations additionnelles sont fournies par les messages d'alarme et d'avertissement sous forme de codes d'erreur et de messages en texte clair associés.

La table suivante montre la corrélation entre le code d'erreur et la sortie du contact de relais :

Code d'erreur ¹⁾	Contact de relais (type de message)	Remarque
Fxxx	Ouvert	xxx = nombre à trois chiffres
Mxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Cxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Sxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres

1) Les codes d'erreur sont indiqués dans le manuel de mise en service.

Analogique

Comportement de l'appareil à la mise sous tension

Lorsqu'il est mis sous tension, l'appareil passe par une phase de diagnostic durant environ 30 secondes. La sortie courant est réglée au courant de défaut $\leq 3,6$ mA pendant cette période.

Pendant la phase de diagnostic, aucune communication n'est possible via l'interface de service (CDI) ou via un protocole (HART, V1, Modbus).

Comportement de l'appareil en mode demande fonction de sécurité

L'appareil délivre une valeur de courant correspondant au seuil devant être surveillé. Cette valeur doit être surveillée et faire l'objet d'un traitement ultérieur dans une unité logique connectée.

Comportement de l'appareil en présence d'alarmes et d'avertissements

En cas d'alarme, le courant de sortie peut être réglé à une valeur $\leq 3,6$ mA ou $\geq 21,0$ mA.

Dans certains cas (par ex. coupure de courant, une rupture de câble et des défauts dans la sortie courant elle-même, où le courant de défaut $\geq 21,0$ mA ne peut pas être réglé, des courants de sortie $\leq 3,6$ mA surviennent indépendamment du courant de défaut configuré.

Dans certains autres cas (par ex. court-circuit du câblage), des courants de sortie $\geq 21,0$ mA surviennent indépendamment du courant de défaut configuré.

Pour la surveillance d'alarme, l'unité logique en aval doit être capable de reconnaître les courants de défaut du niveau supérieur pour le signal de défaut ($\geq 21,0$ mA) et du niveau inférieur pour le signal de défaut ($\leq 3,6$ mA).

Messages d'alarme et d'avertissement

Des informations additionnelles sont fournies par les messages d'alarme et d'avertissement sous forme de codes d'erreur et de messages en texte clair associés.

La table suivante montre la corrélation entre le code d'erreur et la sortie courant :

Code d'erreur ¹⁾	Sortie courant (type de message)	Remarque
Fxxx	$\geq 21,0$ mA ou $\leq 3,6$ mA	xxx = nombre à trois chiffres
Mxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Cxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres
Sxxx	correspond au mode de mesure	xxx = nombre à trois chiffres

1) Les codes d'erreur sont indiqués dans le manuel de mise en service.

Exceptions :

Code d'erreur ¹⁾	Sortie courant (type de message)	Remarque
C484	$\geq 21,0$ mA ou $\leq 3,6$ mA	Simulation mode de défaillance

1) Les codes d'erreur sont indiqués dans le manuel de mise en service.

Configuration des paramètres pour les applications de sécurité

Il est recommandé d'effectuer une réinitialisation avant de régler les paramètres.

Aller à : Setup → Advanced setup → Administration

Device reset = To factory defaults

Ceci remet tous les paramètres aux valeurs définies.

Étalonnage du point de mesure - fonction de sécurité 1 (mesure de niveau)

L'étalonnage du point de mesure est décrit dans le manuel de mise en service → 7.

Indiquer le type de configuration a) ou b) à utiliser. Les deux configurations peuvent être utilisées en parallèle ou en combinaison avec la fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant).

- a) Valeur de niveau (source) (1) -> signal de sécurité : sortie analogique (2)
- b) Valeur de niveau (source) (1) -> signal de sécurité : sortie numérique (3)

Valeur de niveau (source) (1)

Veiller à ce que l'application soit correctement configurée.

Aller à : Setup → Advanced setup → Application → Tank configuration → Level

Réglage

Tank reference height doit être réglé correctement.

Sortie analogique (2)

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Analog I/O B1-3 ou Analog I/O C1-3).

Aller à : Setup → Advanced setup → Input/output → Analog I/O

Réglage

- **Operating mode = 4..20mA output** ou **HART slave +4..20mA output**
- **Analog input source = Tank level**
- **0 % value** doit être réglé correctement.
- **100 % value** doit être réglé correctement.
- **Used for SIL/WHG = Enabled**

Sortie numérique (3)

Sélectionner en premier lieu un bloc d'alarme (Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3 ou Alarme 4) pour les réglages des seuils.

Aller à : Setup → Advanced setup → Application → Alarm → Alarm X

Réglage

- **Alarm mode = On**
- **Alarm value source = Tank level** (selon la source)
- **HH alarm value, H alarm value, L alarm value** et **LL alarm value** doivent être configurés en fonction de l'application de sorte que la gamme de validité se trouve dans les limites HH, H et L, LL.

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Digital A1-2, Digital A3-4, Digital B1-2, Digital B3-4, Digital C1-2, Digital C3-4, Digital D1-2, Digital D3-4).

Aller à : Setup → Advanced setup → Input/output → Digital Xy-z

Réglage

- **Operating mode = Output passive**
- **Digital input source** = bloc alarme sélectionné : **Alarm 1 any, Alarm 2 any, Alarm 3 any** ou **Alarm 4 any**
- **Used for SIL/WHG = Enabled** doit être réglé pour pouvoir utiliser cette sortie numérique comme sortie SIL.

Étalonnage du point de mesure - fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant)

L'étalonnage du point de mesure est décrit dans le manuel de mise en service (→ 7).

Indiquer le type de configuration c) ou d) à utiliser. Les deux configurations peuvent être utilisées en parallèle ou en combinaison avec la fonction de sécurité 1 (mesure de niveau).

- c) Entrée analogique (source) (1) -> signal de sécurité : sortie analogique (2)
- d) Entrée analogique (source) (1) -> signal de sécurité : sortie numérique (3)

Entrée analogique (source) (1)

Veiller à ce que la bonne source soit configurée (Analog I/O B1-3 ou Analog I/O C1-3).

Aller à : Setup → Advanced setup → Input/output → Analog I/O

Réglage

- **Operating mode = 4..20mA input** ou **HART master+4..20mA input**
- **Analog input 0% value** doit être réglé correctement.
- **Analog input 100% value** doit être réglé correctement.

Sortie analogique (2)

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Analog I/O B1-3 ou Analog I/O C1-3).

Aller à : Setup → Advanced setup → Input/output → Analog I/O

Réglage

- **Operating mode = 4..20mA output** ou **HART slave +4..20mA output**
- **Analog input source = AIO B1-3 value mA** ou **AIO C1-3 value mA** (selon la source)
- **0 % value**
- **100 % value**
- **Used for SIL/WHG = Enabled**

Sortie numérique (3)

Sélectionner en premier lieu un bloc d'alarme (Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3 ou Alarme 4) pour les réglages des seuils.

Aller à : Setup → Advanced setup → Application → Alarm → Alarm X

Réglage

- **Alarm mode = On**
- **Alarm value source = AIO B1-3 value mA** ou **AIO C1-3 value mA** (selon la source)
- **HH alarm value, H alarm value, L alarm value** et **LL alarm value** doivent être configurés en fonction de l'application de sorte que la gamme de validité se trouve dans les limites HH, H et L, LL.

Veiller à ce que la bonne sortie soit configurée (Digital A1-2, Digital A3-4, Digital B1-2, Digital B3-4, Digital C1-2, Digital C3-4, Digital D1-2, Digital D3-4).

Aller à : Setup → Advanced setup → Input/output → Digital Xy-z

Réglage

- **Operating mode = Output passive**
- **Digital input source** = bloc alarme sélectionné (**Alarm 1 any, Alarm 2 any, Alarm 3 any** ou **Alarm 4 any**)
- **Used for SIL/WHG = Enabled** doit être réglé pour pouvoir utiliser cette sortie numérique comme sortie SIL.

Méthode de configuration

En utilisant les appareils dans des systèmes de sécurité pour la commande de process, la configuration d'appareil doit répondre à deux exigences :

- Concept de confirmation :
test indépendant, éprouvé, des paramètres de sécurité entrés.
- Concept de verrouillage :
verrouillage de l'appareil une fois la configuration terminée (si requis par les normes IEC 61511-1 §11.6.4 et NE79 §3).


Pour activer le mode SIL, l'appareil doit passer par une séquence de commande, pendant laquelle l'appareil peut être commandé au moyen de l'afficheur de l'appareil ou du système d'Asset Management (par ex. FieldCare) pour lequel l'intégration est disponible.

"Mode Expert"

Il est possible ici de régler librement un grand nombre de paramètres relatifs à la sécurité. Ainsi les applications difficiles peuvent également être mises en service. La vérification des réglages doit toutefois se faire en approchant directement le niveau dans la cuve ou en employant une méthode similaire.






Un réflecteur orientable mécanique peut être utilisé par exemple comme méthode de contrôle en cas de surveillance MAX.

Une description détaillée des étapes de configuration est donnée dans la section suivante.

-  C'est seulement dans le cas d'appareils SIL (caractéristique de commande 590 "Agrément additionnel", option LA "SIL") que la séquence de mise en service SIL est visible sur l'afficheur et dans les outils d'exploitation externes. C'est la raison pour laquelle le verrouillage SIL peut uniquement être activé sur ces appareils.

Verrouillage en "mode Expert"

Pour mettre en service l'appareil, exécuter et documenter les étapes suivantes dans l'ordre indiqué (→  30) :

1. Réaliser la configuration, voir également →  13 : La procédure de configuration et la signification des différents paramètres sont décrites dans le manuel de mise en service (→  7). Respecter les réglages des paramètres dans le tableau suivant (→  17).
2. Aller à : Diagnostics → Device check
Start device check = Yes (pour plus d'informations, voir manuel de mise en service →  7).
Un test de l'appareil est réalisé. La qualité du signal de mesure est testée et les éventuelles erreurs d'installation sont détectées.
Le message suivant apparaît une fois l'autotest terminé : **Result device check = Installation ok**.
L'autotest a été réussi.
3. Démarrer la séquence de confirmation SIL.
Aller à : Setup → Advanced setup → SIL/WHG confirmation
Set write protection = Entrer le code de verrouillage correspondant (SIL : 7452). Appuyer sur "Next" pour confirmer.
4. Appuyer sur "Next" pour confirmer **Commissioning = Expert mode**. L'appareil contrôle les réglages des paramètres conformément au tableau suivant (→  17) et, le cas échéant, force la commutation des paramètres.
Lorsque le contrôle est terminé, **SIL preparation = Finished** est affiché. La séquence de mise en service peut être poursuivie.
Appuyer sur "Next" pour confirmer.

5. Exécuter le test de fonctionnement : Pour la surveillance MIN et MAX, au moins un niveau/ valeur d'entrée courant inférieur (surveillance MIN) ou supérieur (surveillance MAX) au point de détection doit être approché.
Pour la surveillance de gamme, 5 valeurs de niveau/d'entrée courant couvrant l'ensemble de la gamme de mesure devraient être approchées. Dans ce cadre, vérifier que le signal de sécurité (sortie courant/relais) répond correctement dans chacun des cas.
6. Confirmer que le test de fonctionnement a été réussi :
Confirm function test = Yes.
7. **Set write protection** = Entrer à nouveau le code de verrouillage correspondant (SIL : 7452).
Vérifier l'état de verrouillage une fois le verrouillage SIL effectué.
Aller à : Setup → Advanced setup
Locking status = SIL locked doit être confirmé en sélectionnant "✓".
8. En option, le verrouillage du hardware peut également être activé (via le commutateur DIP marqué "WP" situé sur l'électronique principale).

Autres réglages de paramètres

Les paramètres suivants affectent la fonction de sécurité. Ils peuvent toutefois être configurés librement selon l'application.



Il est recommandé d'inscrire les valeurs configurées !

Paramètre	Nom du paramètre
Setup → Advanced setup → Sensor config	Tube diameter ¹⁾
Mesure de l'entrée courant : Setup → Advanced setup → Input/output → Analog I/O	0 % value
	100 % value

1) Uniquement pour conduite/bypass

Les paramètres suivants affectent la fonction de sécurité et ne sont pas librement configurables en mode Expert. Au lieu de cela, ils sont réglés automatiquement aux valeurs de sécurité mentionnées lors du démarrage de la confirmation SIL :

Paramètre	Présélection
Setup → Advanced setup → Input/output → Digital A1-2 → Contact type	Normally closed
Setup → Advanced setup → Application → Alarm → Alarm X → Error value	All alarms
Setup → Advanced setup → Application → Alarm → Alarm X → Alarm mode	On
Setup → Advanced setup → Safety settings → Output echo lost	Alarm
Setup → Advanced setup → Sensor config → Echo tracking → Evaluation mode	History off
Setup → Advanced setup → Application → Tank calculation → CTSh → CTSh mode	No
Setup → Advanced setup → Application → Tank calculation → HyTD → HyTD mode	No
Diagnostics → Simulation → Current output 2 simulation	Off
Diagnostics → Simulation → Simulation distance on	Off
Expert → Input/output → Analog I/O → Error on event	Any error
Expert → Input/output → Analog I/O → Output out of range	Alarm
Expert → Input/output → Digital A1-2 → Error on event	Any error
Expert → Input/output → Digital A1-2 → Output simulation	Disable
Expert → Sensor → Filter options → Dead time	5 s



Ces paramètres, qui ne sont pas mentionnés, n'influencent pas la fonction de sécurité et peuvent être configurés à toute valeur significative. La visibilité des paramètres mentionnés dans le menu de configuration dépend en partie du rôle utilisateur, des options logicielles commandées et de la configuration des autres paramètres.

Déverrouillage d'un appareil SIL

Lorsque le verrouillage SIL est actif sur un appareil, l'appareil est protégé contre une utilisation non autorisée au moyen d'un code de verrouillage et, en tant qu'option supplémentaire, au moyen d'un interrupteur de protection en écriture du hardware. L'appareil doit être déverrouillé pour pouvoir modifier la configuration à des fins de tests de fonctionnement selon la séquence de test A → 20, la séquence de test B → 22 ou la séquence de test C → 24.

ATTENTION

Le déverrouillage de l'appareil a pour effet de désactiver les fonctions de diagnostic et l'appareil peut ne pas être capable d'exécuter sa fonction de sécurité une fois déverrouillé.

► Par conséquent, des mesures indépendantes doivent être prises pour s'assurer de l'absence de danger pendant que l'appareil est déverrouillé.

Pour le déverrouillage, procéder comme suit :

1. Contrôler la position de l'interrupteur de protection en écriture du hardware (micro-commutateur marqué "WP" sur l'électronique principale) et régler cet interrupteur sur "Off".
2. Sélectionner la séquence "Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG" et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
 - ↳ Le message "Fin de séquence" indique que l'appareil a été déverrouillé avec succès.

Test de fonctionnement périodique

Contrôler la capacité de fonctionnement et la fiabilité des fonctions de sécurité à intervalles appropriés ! L'utilisateur doit déterminer les intervalles de temps.

Les valeurs et les graphiques du chapitre "Caractéristiques supplémentaires relatives à la sécurité" peuvent être utilisés à cet effet (→ 5). Le test doit être réalisé de sorte qu'il vérifie le bon fonctionnement du système de protection en interaction avec tous les composants.

i Dans une architecture monovoie, la valeur $PF_{D_{avg}}$ devant être utilisée dépend du taux de diagnostic de couverture du test de fonctionnement périodique (PTC = Proof Test Coverage – couverture du test de fonctionnement périodique) et de la durée de vie escomptée (LT = Lifetime – durée de vie), comme spécifié dans la formule suivante :

$$PF_{D_{avg}} = \frac{1}{2} \cdot PTC \cdot \lambda_{DU} \cdot T_1 + \lambda_{DD} \cdot MTTR + \frac{1}{2} \cdot (1 - PTC) \cdot \lambda_{DU} \cdot LT$$

A0024244

Pour les tests de fonctionnement périodiques décrits ci-dessous sont spécifiées les couvertures du test de fonctionnement périodique respectives, qui peuvent être utilisées pour le calcul. Les taux de couverture du test de fonctionnement dépendent de la séquence de test spécifique.

Une séquence de test pour le test de fonctionnement doit être sélectionnée dans le tableau suivant pour chaque fonction de sécurité utilisée. Si les deux fonctions de sécurité sont utilisées, deux séquences de test doivent être réalisées pour le test de fonctionnement.

Fonction de sécurité 1 (mesure de niveau)		PTC
	Séquence de test A – Approcher le niveau	99%
	Séquence de test B – Simuler le niveau	74%
Fonction de sécurité 2 (mesure de l'entrée courant)		
	Séquence de test C – Appliquer des courants réels	99%

Vous devez également vérifier que tous les joints de couvercles et entrées de câble sont étanches.

⚠ ATTENTION

Pour garantir la sécurité du process.

- ▶ Pendant le test de fonctionnement périodique, des mesures de surveillance alternatives doivent être prises pour garantir la sécurité du process.
- i** Si l'un des critères de test issu des séquences de test suivantes n'est pas satisfait, l'appareil ne doit plus être utilisé en tant qu'élément d'un système de protection. Le but du test de fonctionnement périodique est de détecter les défauts aléatoires de l'appareil (λ_{du}). L'impact de défauts systématiques sur la fonction de sécurité n'est pas couvert par ce test et doit être évalué séparément. Les défauts systématiques peuvent être occasionnés, par exemple, par les propriétés des matériaux du process, les conditions de fonctionnement, la formation de dépôt ou la corrosion.

Séquence de test A (approcher le niveau)

Préparation

1. La surveillance des seuils et la surveillance de la gamme peuvent également être réalisées lorsque le mode SIL est actif.
2. Si le signal de sécurité "Analogique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1$ mA) à la sortie courant.
3. Si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (testeur de résistance/mesure de résistivité), (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1 \Omega$) à la sortie numérique.
4. Déterminer le réglage de sécurité (surveillance des limites ou de la gamme de niveau).

Procédure pour la surveillance des limites de niveau

1. Contrôler la fonction de sécurité : approcher au moins un niveau immédiatement supérieur (surveillance MAX) ou inférieur (surveillance MIN) au seuil devant être surveillé.
2. Contrôler la fonction de sécurité : lire le courant de sortie (mA)/la valeur ohmique du relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
3. Si (en tant qu'option) la fonction du point de mesure doit être vérifiée immédiatement avant le point de détection : contrôle de la fonction avant le point de détection MIN ou MAX : approche d'un niveau immédiatement inférieur (surveillance MAX) ou supérieur (surveillance MIN) au seuil devant être surveillé. Lire le courant de sortie/la valeur ohmique du relais, l'enregistrer et évaluer sa précision. Ceci ne contrôle pas la fonction de sécurité de l'appareil.
4. Le test a été réussi si les valeurs de courant/valeurs ohmiques du relais déclenchent ou exécutent la fonction requise.


Procédure pour la surveillance de gamme

1. Approcher de cinq niveaux au sein de la gamme devant être surveillée.
2. Pour chaque valeur de niveau, lire le courant de sortie (mA)/la valeur ohmique du relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
3. Le test a été réussi si les valeurs de courant/valeurs ohmiques du relais dans l'étape 2 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Autosurveillance des relais

Il faut réaliser une autosurveillance du relais si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé.

Exemple de désignation des bornes : Si le module Digital IO utilisé pour la fonction de sécurité est installé dans le slot D et les contacts 3 et 4 sont utilisés, Digital D3-4 doit être utilisé à la place de Digital Xy-z dessous.

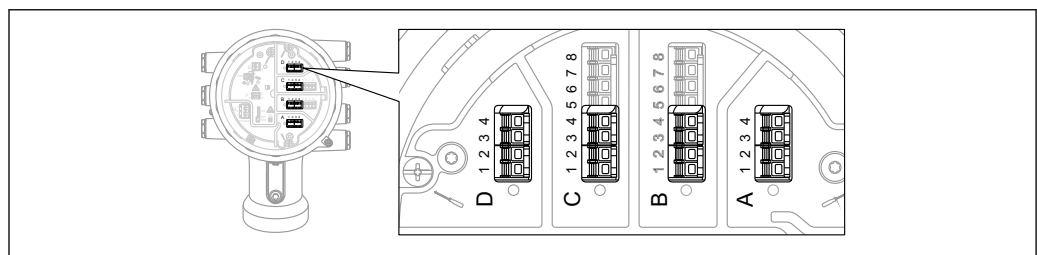



A0032388

1. Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
2. Réaliser un autotest de l'appareil de la façon suivante. Aller à : Setup → Advanced setup
3. Régler : **Input/output = Digital Xy-z**
4. Vérifier que **Contact type = Normally closed** (réglage par défaut SIL).
5. Régler : **Output simulation = Simulating inactive**.
6. Vérifier que le contact est fermé (résistance $< 1 \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
7. Régler : **Output simulation = Fault 1**.

8. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $>1\text{ M}\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
9. Régler : **Output simulation = Simulating inactive.**
10. Vérifier que le contact est fermé (résistance $<1\ \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
11. Régler : **Output simulation = Fault 2.**
12. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $>1\text{ M}\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
13. Régler : **Output simulation = Simulating active.**
14. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $>1\text{ M}\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
15. Régler : **Output simulation = Disable.**


Le test a été réussi si les valeurs ohmiques du relais dans les étapes 5 -14 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Fin de la séquence de test A

 L'appareil a échoué au test de fonctionnement si la valeur de courant/valeur ohmique du relais escomptée à un niveau spécifique dévie de $> \pm 2\%$. Pour la suppression des défauts, se reporter au manuel de mise en service (). →  799 % des défaillances dangereuses indétectées sont détectées à l'aide de ce test (couverture du test de fonctionnement périodique, PTC = 0,99).

 ATTENTION

Une fois la séquence de test A réalisée

- ▶ Le mode SIL doit être réactivé (→  15).

Séquence de test B (simuler le niveau)

Préparation

1. Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
2. Si le signal de sécurité "Analogique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1$ mA) à la sortie courant.
3. Si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (testeur de résistance/mesure de résistivité), (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1$ Ω) à la sortie numérique.
4. Déterminer le réglage de sécurité (surveillance des limites ou de la gamme de niveau).

Procédure pour la surveillance des limites de niveau

1. Aller à : Expert → Sensor → Sensor diagnostics
2. Régler : **Start self check = Yes**. Une fois l'autotest terminé, le message suivant s'affiche : **Result self check = Ok**.
↳ L'autotest a été réussi.
3. Aller à : Diagnostics → Simulation
4. Régler : **Simulation distance on = On**. Simuler un niveau directement inférieur (surveillance MAX) ou directement supérieur (surveillance MIN) au seuil devant être surveillé (**Simulation distance = valeur correspondante**).
5. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
6. Lire l'état du contact de relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
7. Simuler un niveau directement supérieur (surveillance MAX) ou directement inférieur (surveillance MIN) au seuil.
8. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
9. Lire l'état du contact de relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
10. Le test a été réussi si les valeurs de courant et l'état du contact de relais déclenchent la fonction de sécurité dans l'étape 7 uniquement, et non dans l'étape 4.


Procédure pour la surveillance de gamme

1. Aller à : Expert → Sensor → Sensor diagnostics
2. Régler : **Start self check = Yes**. Une fois l'autotest terminé, le résultat suivant s'affiche : **Result self check = Ok**.
↳ L'autotest a été réussi.
3. Simuler cinq niveaux au sein de la gamme devant être surveillée. Voir la procédure pour la surveillance des seuils (niveau), étape 4.
4. Pour chaque valeur de niveau, lire le courant de sortie (mA) et l'état de commutation du relais (Ω), les enregistrer et évaluer leur précision.
5. Le test a été réussi si les valeurs de courant et l'état de commutation du relais dans l'étape 4 se trouvent dans les limites de précision requises.

Autosurveillance des relais

Il faut réaliser une autosurveillance du relais si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé.

Exemple de désignation des bornes : Si le module Digital IO utilisé pour la fonction de sécurité est installé dans le slot D et les contacts 3 et 4 sont utilisés, Digital D3-4 doit être utilisé à la place de Digital Xy-z dessous.

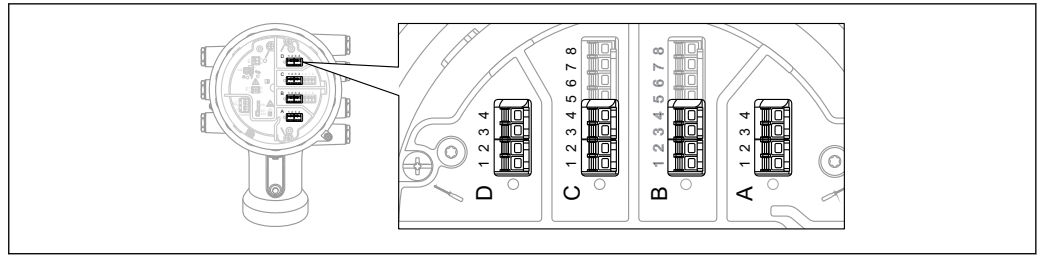

A0032388

1. Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
2. Réaliser un autotest de l'appareil de la façon suivante. Aller à : Setup → Advanced setup
3. Régler : **Input/output = Digital Xy-z**
4. Vérifier que **Contact type = Normally closed** (réglage par défaut SIL).
5. Régler : **Output simulation = Simulating inactive**.
6. Vérifier que le contact est fermé (résistance $< 1 \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
7. Régler : **Output simulation = Fault 1**.
8. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $> 1 M\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
9. Régler : **Output simulation = Simulating inactive**.
10. Vérifier que le contact est fermé (résistance $< 1 \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
11. Régler : **Output simulation = Fault 2**.
12. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $> 1 M\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
13. Régler : **Output simulation = Simulating active**.
14. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $> 1 M\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
15. Régler : **Output simulation = Disable**.

Le test a été réussi si les valeurs ohmiques du relais dans les étapes 5 -14 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Fin de la séquence de test B

- i L'appareil a échoué au test de fonctionnement si la valeur de courant/les valeurs ohmiques du relais escomptées à un niveau spécifique dévient de $> \pm 2 \%$. Pour la suppression des défauts, se reporter au manuel de mise en service (→ 7). 74 % des défaillances dangereuses indétectées sont détectées à l'aide de ce test (couverture du test de fonctionnement périodique, PTC = 0,74).
- Si le groupe de menus "Expert" est sélectionné, une invite pour l'entrée du code d'accès apparaît sur l'affichage. Si un code d'accès a été défini sous Setup → Advanced setup → Administration → Define access code, ce code doit être entré ici. Si aucun code d'accès n'a été défini, l'invite peut être validée en appuyant sur la touche "E".

ATTENTION

Une fois la séquence de test B réalisée

- Le mode SIL doit être réactivé (→ 15).

Séquence de test C (appliquer des courants réels)

Préparation

1. La surveillance des seuils et la surveillance de la gamme peuvent également être réalisées lorsque le mode SIL est actif.
2. Si le signal de sécurité "Analogique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1$ mA) à la sortie courant.
3. Si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé, connecter un appareil de mesure adapté (testeur de résistance/mesure de résistivité), (précision recommandée supérieure à $\pm 0,1 \Omega$) à la sortie numérique.
4. Déterminer le réglage de sécurité (surveillance des limites ou de la gamme de niveau).

Procédure pour la surveillance des seuils (courant)

1. Entrer un courant directement inférieur (surveillance MAX) ou directement supérieur (surveillance MIN) au seuil de courant devant être surveillé (par ex. par simulation sur un appareil connecté).
2. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
3. Lire l'état de commutation du relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
4. Entrer un courant directement supérieur (surveillance MAX) ou directement inférieur (surveillance MIN) au seuil de courant devant être surveillé.
5. Lire le courant de sortie (mA), l'enregistrer et évaluer sa précision.
6. Lire l'état de commutation du relais (Ω), l'enregistrer et évaluer sa précision.
7. Le test a été réussi si le courant et l'état de commutation du relais déclenchent la fonction de sécurité dans les étapes 5 et 6 uniquement, et non dans les étapes 2 et 3.


Procédure pour la surveillance de gamme (courant)

1. Entrer cinq valeurs de courant dans la gamme devant être surveillée (par ex. par simulation sur un appareil connecté).
2. Pour chaque valeur de courant, lire le courant de sortie (mA) et l'état de commutation du relais (Ω), les enregistrer et évaluer leur précision.
3. Le test a été réussi si les valeurs de courant et l'état de commutation du relais dans l'étape 2 se trouvent dans les limites de précision requises.

Autosurveillance des relais

Il faut réaliser une autosurveillance du relais si le signal de sécurité "Numérique" est utilisé.

Exemple de désignation des bornes : Si le module Digital IO utilisé pour la fonction de sécurité est installé dans le slot D et les contacts 3 et 4 sont utilisés, Digital D3-4 doit être utilisé à la place de Digital Xy-z dessous.

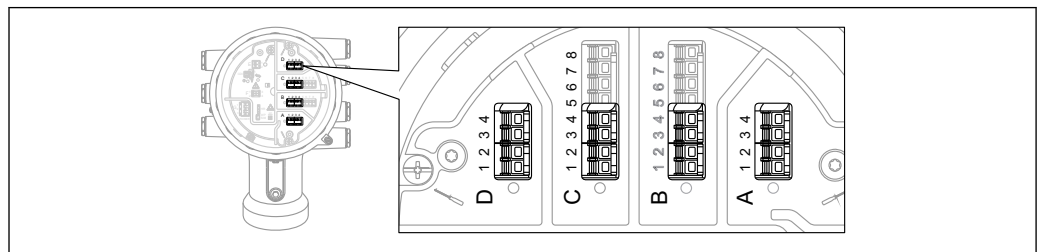



A0032388

1. Désactiver le mode SIL. Aller à : Setup → Advanced setup → Deactivate SIL/WHG et entrer le code de déverrouillage correspondant (SIL : 7452) pour le paramètre **Reset write protection**.
2. Réaliser un autotest de l'appareil de la façon suivante. Aller à : Setup → Advanced setup
3. Régler : **Input/output = Digital Xy-z**
4. Vérifier que **Contact type = Normally closed** (réglage par défaut SIL).
5. Régler : **Output simulation = Simulating inactive**.
6. Vérifier que le contact est fermé (résistance $< 1 \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.

7. Régler : **Output simulation = Fault 1.**
8. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $>1\text{ M}\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
9. Régler : **Output simulation = Simulating inactive.**
10. Vérifier que le contact est fermé (résistance $<1\ \Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
11. Régler : **Output simulation = Fault 2.**
12. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $>1\text{ M}\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
13. Régler : **Output simulation = Simulating active.**
14. Vérifier que le contact est ouvert (résistance $>1\text{ M}\Omega$) entre les contacts Xy et Xz.
15. Régler : **Output simulation = Disable.**


Le test a été réussi si les valeurs ohmiques du relais dans les étapes 5 -14 se trouvent dans le niveau de précision requis.

Fin de la séquence de test C






-  L'appareil a échoué au test de fonctionnement si la valeur de courant/les valeurs ohmiques du relais escomptées à un niveau spécifique dévient de $> \pm 2\%$. Pour la suppression des défauts, se reporter au manuel de mise en service (\rightarrow  7). 99 % des défaillances dangereuses indétectées sont détectées à l'aide de ce test (couverture du test de fonctionnement périodique, PTC = 0,99).
- Si le groupe de menus "Expert" est sélectionné, une invite pour l'entrée du code d'accès apparaît sur l'affichage. Si un code d'accès a été défini sous Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Administration \rightarrow Define access code, ce code doit être entré ici. Si aucun code d'accès n'a été défini, l'invite peut être validée en appuyant sur la touche "E".

 ATTENTION

Une fois la séquence de test C réalisée

- Le mode SIL doit être réactivé (\rightarrow  15).

Cycle de vie

Exigences imposées au personnel	<p>Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic, la réparation et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche ▪ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation ▪ Etre familiarisé avec les réglementations nationales ▪ Avant le début du travail, avoir lu et compris les instructions figurant dans les manuels et la documentation complémentaire, ainsi que les certificats (selon l'application) ▪ Suivre les instructions et respecter les conditions fondamentales <p>Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche ▪ Suivre les instructions du présent manuel
Montage	L'installation de l'appareil est décrite dans le manuel de mise en service correspondant (→  7).
Mise en service	La mise en service de l'appareil est décrite dans le manuel de mise en service correspondant (→  7).
Fonctionnement	La configuration de l'appareil est décrite dans le manuel de mise en service correspondant (→  7).
Maintenance	<p>Veillez vous reporter au manuel de mise en service correspondant pour les informations concernant la maintenance et le réétalonnage, (→  7).</p> <p> Des mesures de surveillance alternatives doivent être prises pour garantir la sécurité du process pendant la configuration, le test de fonctionnement périodique et les opérations de maintenance relatifs à l'appareil.</p>

Réparation

Réparation signifie restauration de l'intégrité fonctionnelle par le remplacement des composants défectueux. Pour cela, il faut utiliser des composants du même type. Nous vous recommandons de documenter la réparation. Il faut, entre autres, consigner le numéro de série de l'appareil, la date de réparation, le type de réparation et le nom de la personne ayant réalisé la réparation.

Les composants suivants peuvent être remplacés par le personnel technique du client si des pièces de rechange d'origine sont utilisées et si les instructions de montage appropriées sont suivies :

Composant	Vérification de l'appareil selon réparation
Module E/S Carte mère Module face avant, étiqueté	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. ■ La suppression des échos parasites doit être réenregistrée. ■ Test de validité ; séquence de test A ou B.
Couvercle, aluminium, hublot en verre Clamp du couvercle Joint torique, boîtier	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. ■ Contrôle de la mesure à un niveau arbitraire.
Boîtier électronique, complet	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. ■ Test de validité ; séquence de test A ou B.
Filtre de boîtier	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées ■ Test de validité ; séquence de test A ou B.
Carte SD avec support	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées. ■ Test de validité ; séquence de test A ou B.
Kit d'affichage Support de l'afficheur, bague de fixation	Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées.
Kit de bornes, enfichables Kit de bornes, à visser	Contrôle visuel afin de vérifier si toutes les pièces sont présentes et correctement montées.

Instructions de montage : voir la zone Téléchargements sous www.fr.endress.com.

Le composant remplacé doit être envoyé à Endress+Hauser pour analyse du défaut si l'appareil a été utilisé dans un système de protection et si une erreur de l'appareil ne peut être exclue. Dans ce cas, il faut systématiquement joindre la "Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination" et cocher la case "Utilisé comme appareil SIL dans des installations de sécurité" lors du retour de l'appareil défectueux. Veuillez vous reporter à la section "Retour" du manuel de mise en service (→ 7).

Modification

Les modifications sont des changements effectués sur des appareils conformes SIL déjà livrés ou montés.


- ▶ Les modifications d'appareils conformes SIL sont généralement effectuées dans le centre de production Endress+Hauser.
- ▶ Les modifications d'appareils conformes SIL effectuées sur site, dans l'usine de l'utilisateur, sont possibles après l'approbation fournie par le centre de production Endress+Hauser. Dans ce cas, les modifications doivent être effectuées et documentées par un technicien de maintenance Endress+Hauser.
- ▶ Les modifications d'appareils SIL effectuées par l'utilisateur sont interdites.

Annexe

Structure du système de mesure

Composants système

Les appareils du système de mesure sont représentés dans le diagramme suivant (exemple) :

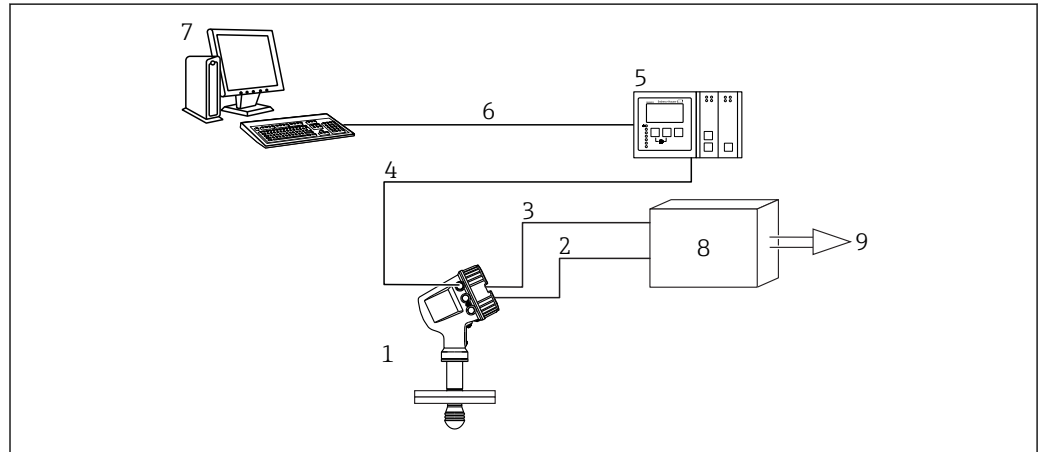

A0032451

- 1 Micropilot NMR81, NMR84
- 2 Ligne 4...20 mA
- 3 Sortie tout ou rien
- 4 Bus de terrain (par ex. Modbus, V1)
- 5 Tankvision Tank Scanner NXA820
- 6 Ethernet
- 7 Ordinateur avec Fieldcare
- 8 Unité logique, p. ex. API, transmetteur de signaux de seuil
- 9 Actionneur

Un signal analogique (4-20 mA) proportionnel au niveau est généré dans le transmetteur. Celui-ci est envoyé à une unité logique aval (par ex. API, transmetteur de signaux de seuil, etc.), où il est surveillé afin de déterminer s'il est inférieur ou supérieur à une valeur limite spécifiée.


Le contact de relais est ouvert si le niveau réglé est dépassé par excès ou par défaut, et si des erreurs sont détectées. Pour la surveillance des défauts, l'unité logique doit reconnaître un contact ouvert. La sortie courant suit le niveau. Si des erreurs sont détectées, un courant de défaut est délivré.

Pour la surveillance des défauts, l'unité logique doit reconnaître à la fois les alarmes hautes ($\geq 21,0$ mA) et les alarmes basses ($\leq 3,6$ mA).

Description de l'utilisation en tant que système de protection

Le Micropilot est un transmetteur utilisant le principe de la mesure du temps de parcours (ToF = Time of Flight). Il mesure la distance entre le point de référence (raccord process de l'appareil de mesure) et la surface du produit. Des signaux haute fréquence sont émis via une antenne. Elles sont réfléchies par la surface du produit, captées par l'unité d'exploitation et converties en information de niveau. Cette méthode est également appelée radar de niveau.

Configuration de mesure typique

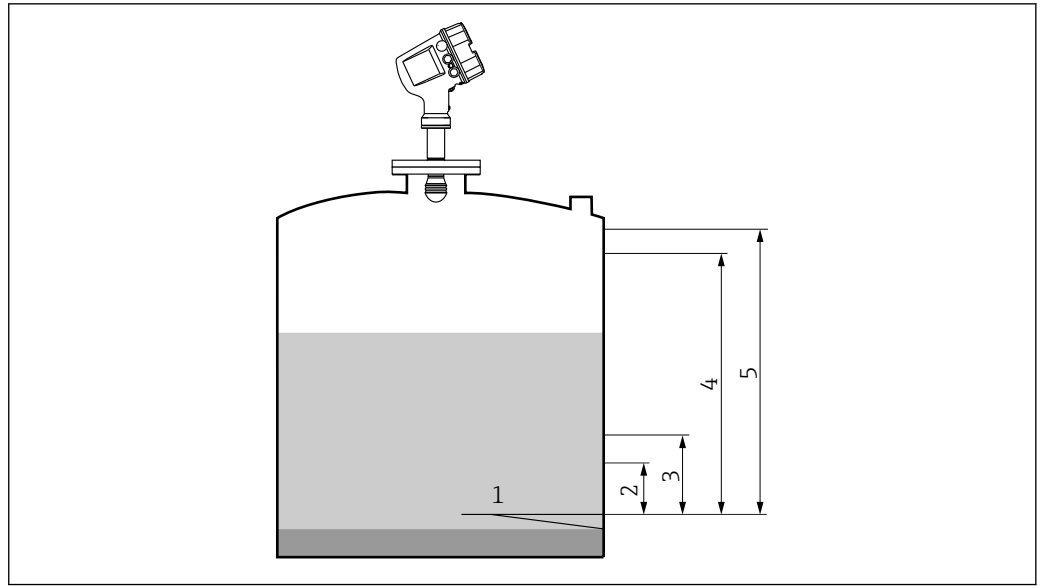

A0032453

- 1 *Plaque de niveau de référence : point de référence de la mesure*
- 2 *4 mA, 0 %*
- 3 *Alarme L ou LL*
- 4 *Alarme H ou HH*
- 5 *20 mA, 100 %*

L'appareil peut être utilisé dans cette configuration au sein de systèmes instrumentés de sécurité pour la surveillance de seuil MIN, de seuil MAX et de gamme.



Une installation correcte est une condition préalable à un fonctionnement sûr de l'appareil.

**Test de fonctionnement
périodique**

Données spécifiques au système	
Société	
Point de mesure / n° TAG	
Installation	
Type appareil / variante de commande	
Numéro de série de l'appareil	
Nom	
Date	
Code d'accès (si individuel pour chaque appareil)	
Code de verrouillage utilisé	SIL <input type="checkbox"/> 7452
Signature	

Paramètres de mise en service spécifiques aux appareils	
Diamètre du tube (mesure de liquide ; tube/bypass)	
Distance du point zéro	
Plage de mesure	

Protocole de test de fonctionnement périodique		
Etape de test	Valeur de consigne	Valeur actuelle
1. Valeur de courant 1		
2. Valeur de courant 2		
3. Valeur de courant 3 (si nécessaire)		
4. Valeur de courant 4 (si nécessaire)		
5. Valeur de courant 5 (si nécessaire)		
Valeur ohmique		

Compléments d'informations

Des informations générales sur la sécurité fonctionnelle (SIL) sont disponibles sous :

www.fr.endress.com/SIL (en français) ou www.endress.com/SIL (en anglais) et dans la brochure Compétence CP01008Z "Sécurité fonctionnelle – SIL - Les systèmes instrumentés de sécurité dans l'industrie des process".



www.addresses.endress.com
